

USER GUIDE

Medit Scan for Clinics (Reveision 15) 2023.04



Table of Contents

Medit Scan > Medit Scan for Clinics

Introduction	4
Medit Scan for Clinics	4
Utilisation prévue	4
Contre-indications	4
Qualification de l'opérateur	4

Medit Scan > Medit Scan for Clinics > Installation

Exigences du système	5
Exigences du système pour Windows	5
Minimum	5
Recommandé	5
Exigences du système pour macOS	5
Minimum	5
Recommandé	5
Installation de Medit Scan for Clinics	6
Installation	6
Mises à jour	7
Mise à jour du logiciel	7
Mise à jour du micrologiciel	7
Connexion du scanner	9
Statut du scanner	9
Statut du hub	9
Gestionnaire de jumelage	10
Changer et scanner	12
Calibrage du scanner	13
Calibrage du scanner intra oral	13
Assistant de calibrage	13

Medit Scan > Medit Scan for Clinics > Commencer

Interface utilisateur	15
Vue d'ensemble	15
Barre de titre	15
Barre d'outils principale	16
Formulaire d'informations	16
Boîte d'information	16
Étapes de numérisation	16
Vue du modèle	16
Informations sur la numérisation	16
Arborescence des données	17
Barre d'outils latérale	17
Barre d'outils de l'étape de numérisation	17
Vue en direct	17
Profondeur de scan	18
Paramètres	20
Préférences du programme	20
Général	20
Interface	20
Affichage des données	21
Assistance à la numérisation	21
Performance de numérisation	21
Post traitement	22
Scanner	22
Actions du bouton Scan	22
Sur batterie	23
Lorsque le scanner est branché	23
Opération de base	24
Contrôle des données 3D	24
Contrôle des données 3D à l'aide des boutons du scanner	24
Contrôle des données 3D à l'aide de la souris	24
Contrôle des données 3D à l'aide de la souris et des touches du clavier	25
Prise en charge de la souris 3D	25
Principes de base de la numérisation	26
Check-list de numérisation	26
Mode entraînement	26
Accéder au Mode entraînement	26
Entraînement à la numérisation	28
Indication pendant la numérisation	29
Flèche intelligente	30
Guide de scan intelligent	31

Medit Scan > Medit Scan for Clinics > Étapes de numérisation

Gestion de l'état	32
Étapes de numérisation	32
Ajouter/Retirer des étapes	32
Enregistrer comme flux de travail par défaut	33
Modification de l'ordre des étapes	35
Pré-op pour Maxillaire/Mandibule	36
Étape pré-op du maxillaire	36
Étape pré-op de la mandibule	36
Outil supplémentaire à l'étape Pré-op	36
Maxillaire/Mandibule	37
Stade maxillaire	37
Stade mandibulaire	37
Outils supplémentaires au stade maxillaire/mandibulaire	37
Maxillaire/Mandibule édenté	38
Étape maxillaire édenté	38
Étape mandibule édentée	38
Outils supplémentaires pour le stade édenté	38
Prothèse Maxillaire/Mandibulaire	39
Étape de prothèse mandibulaire	39
Occlusion	40

Étape d'occlusion	40
Outils supplémentaires pour l'étape Occlusion	40
Multi occlusion	40
Cible d'occlusion pour maxillaire/mandibule	43
Aligner avec le plan occlusal	43
Mouvement mandibulaire	45
Visage	50
Étape visage	50
Outils supplémentaires pour l'étape Visage	50
Données supplémentaires	51
Étape des données supplémentaires	51
Terminer	53
Étape Terminer	53

Medit Scan > Medit Scan for Clinics > Outils et fonctions

Outils de l'étape de numérisation	55
Outils de numérisation de base	55
Scan haute résolution	55
Scan métal	55
Importer les données de numérisation	55
Outils de filtrage	56
Filtrage de scan intelligent	57
Filtrage de couleurs intelligent	57
Couture intelligente	58
Outils avancés	60
Outils de la barre d'outils principale	61
Outils de découpage	61
Découpage polyligne	61
Découpage pinceau	61
Découpage manuel de bruit	62
Découpage de bruit automatique	62
Découpage rapide	62
Outils de fonction	63
Zone de blocage	63
Analyse de contre-dépouille	64
Analyse de contre-dépouille avec Direction automatique	64
Analyse de contre-dépouille avec Direction manuelle	65
Échanger Maxillaire et Mandibule	65
Aperçu du résultat	65
Ligne de marge	66
Nettoyage intelligent des données	68
Rejouer le scan	69
Caméra HD	70
Enregistrer les piliers	71
Guide de teintes intelligent	74
Outils de la barre d'outils latérale	78

Medit Scan > Medit Scan for Clinics > Exemples de cas et de flux de travail

Scan de la prothèse	79
Complet résine	79
Acquérir les données de scan édenté	79
Scan de la prothèse rebasée	80
Copie de complet résine	81
Complet résine sur implant	82
Scan pré-op	83
Comment utiliser le Scan pré-op	83
Comment utiliser le Scan pré-op avec les Outils de découpage	84
Comment supprimer un Scan pré-op reproduit et scanner de nouvelles données	85
Scan d'empreinte	89
Comment acquérir un Scan d'empreinte	89
Comment utiliser le Scan d'empreinte pour les marges	90
Comment utiliser le Scan d'empreinte pour les cas de Faux et moignon	91
Comment utiliser le Scan d'empreinte pour le cas d'Occlusion	92
Correspondance de pilier IA	94
Comment utiliser la Correspondance de pilier IA	94
Attribution de la bibliothèque de piliers	94
Alignement automatique	95
Alignement manuel	96
Couper le pilier manuellement	97
Correspondance scanbody IA	99
Comment utiliser la Correspondance scanbody IA	99
Attribuer la Bibliothèque Scanbody	99
Alignement automatique	100
Alignement manuel	101
Révision de la préparation	105
Comment utiliser Révision de la préparation	105
Paramètres de Révision de la préparation	105
Utilisation des outils de Révision de la préparation	105

Introduction

Medit Scan for Clinics

Medit Scan for Clinics est un logiciel qui fournit une interface de travail conviviale pour enregistrer numériquement les caractéristiques topographiques des dents et des tissus environnants à l'aide du scanner.

Utilisation prévue

Le système est un scanner dentaire 3D utilisé pour enregistrer numériquement les caractéristiques topographiques des dents et des tissus environnants. Le système produit des scans en 3D pour la conception et la fabrication assistées par ordinateur de restaurations dentaires.

Le système est destiné aux patients qui ont besoin d'une numérisation en 3D pour des traitements dentaires, tels que :

- Pilier personnalisé simple
- Inlays et Onlays
- Couronne unitaire
- Facette
- Bridge sur implant à 3 unités
- Bridge jusqu'à 5 unités
- Orthodontie
- Guide d'implant
- Modèle de diagnostic

Le scanner peut également être utilisé pour des scans de la bouche entière. Cependant, des facteurs tels que les conditions intra-orales, le niveau d'expertise du technicien et le processus de fabrication de la prothèse peuvent impacter le résultat final.

Contre-indications

Ce scanner n'est pas conçu pour obtenir des images de la structure interne des dents ou des structures squelettiques qui les soutiennent.

Qualification de l'opérateur

Ce scanner doit être utilisé par des dentistes qualifiés et des techniciens de laboratoire dentaire. L'utilisateur de ce scanner est seul responsable de la détermination de l'adéquation de ce scanner à un cas particulier. L'utilisateur est seul responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'adéquation des données obtenues par le scanner et le logiciel fourni. L'utilisateur doit vérifier l'exactitude et l'adéquation des résultats en vue d'un traitement approprié. Le système doit être utilisé conformément au guide de l'utilisateur et aux mises en garde. En outre, l'utilisateur ne doit pas modifier ou changer le système. L'utilisation ou la manipulation incorrecte du système annule toute garantie. Pour plus d'informations sur l'utilisation correcte du système, veuillez contacter votre distributeur local.

Exigences du système

Exigences du système pour Windows

Minimum

	Ordinateur portable	Ordinateur de bureau
Processeur	Intel Core i7-10750H AMD Ryzen 7 4800H	Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 7 3800X
RAM	16 GB (uniquement pour i500, i600) 32 GB	
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX 1660/2060/3060 6 GB ou supérieur * Radeon n'est pas pris en charge.	
OS	Windows 10 Pro ou Home 64-bit Windows 11 Pro ou Home * Windows 11 est recommandé pour les processeurs Intel Core 12e génération.	

Recommandé

	Ordinateur portable	Ordinateur de bureau
Processeur	Intel Core i7-12700H Intel Core i7-11800H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 5800H	Intel Core i7-12700K Intel Core i7-11700K AMD Ryzen 7 5800X
RAM	32 GB	
Carte graphique	Nvidia GeForce RTX 2070/2080/3070/3080/ 3090 8 GB ou supérieur NVIDIA RTX A3000/4000/5000 6 GB ou supérieur * Radeon n'est pas pris en charge.	
OS	Windows 10 Pro ou Home 64-bit Windows 11 Pro ou Home	

Exigences du système pour macOS

iNote

Le Medit i500 n'est pas compatible avec macOS.

Minimum

	i600	i700/i700 wireless
Processeur	Apple M1/M2	Apple M1 Pro
RAM	16 GB	
OS	Monterey 12	

Recommandé

	i600	i700
Processeur	Apple M1 Pro	Apple M1 Max
RAM	32 GB	
OS	Monterey 12	

Installation de Medit Scan for Clinics

Installation

Lorsque vous installez Medit Link, Medit Scan for Clinics est installé comme pack avec Medit Scan for Labs.

Veuillez consulter [Medit Link > Installation > Installation sur Windows](#) ou [Installation sur macOS](#) pour les instructions d'installation.

Mise en garde

Le scanner peut ne pas fonctionner correctement si vous ne redémarrez pas votre PC après l'installation.

Mises à jour

Mise à jour du logiciel

Lorsque vous lancez Medit Link, le programme vérifie les mises à jour. La dernière version est automatiquement mise à jour si vous disposez d'une connexion internet.


Medit Scan for Clinics et Medit Scan for Labs sont mis à jour vers la dernière version lorsqu'un nouveau Medit Link est installé.

Mise à jour du micrologiciel


Nous vous recommandons de maintenir à jour la version du micrologiciel de votre hub sans fil afin d'utiliser les nouvelles fonctions et améliorations. Vous pouvez toujours utiliser les fonctions existantes même si vous ne procédez pas immédiatement à la mise à jour du micrologiciel.

Le programme installe automatiquement le dernier micrologiciel lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, comme suit :


1. Connectez le hub sans fil et le PC à l'aide d'un câble.
2. Vérifiez que votre scanner est connecté au hub sans fil.
3. Lancez Medit Scan for Clinics.
4. La boîte de dialogue suivante s'affiche lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible.

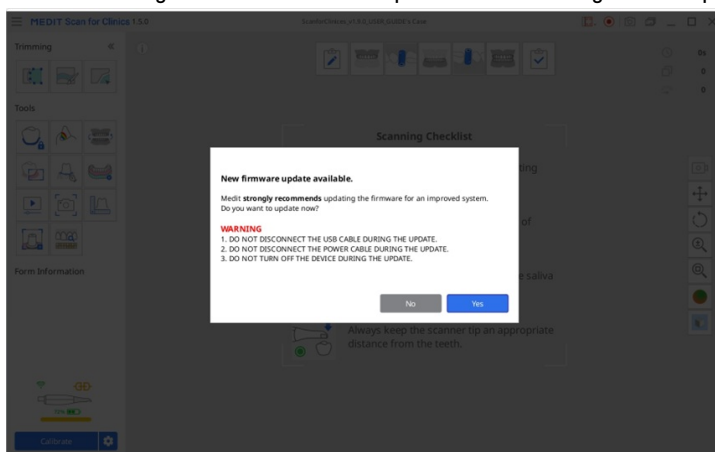

5. Cliquez sur "Oui" pour poursuivre la mise à jour du micrologiciel.

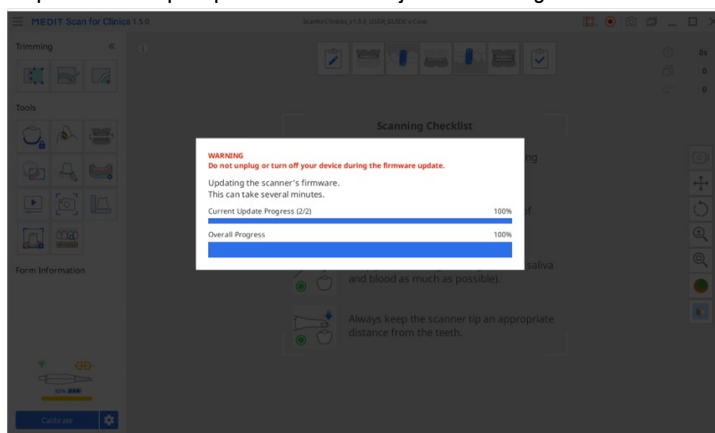

6. Lorsque le micrologiciel est mis à jour, le hub va de nouveau essayer de connecter le scanner.

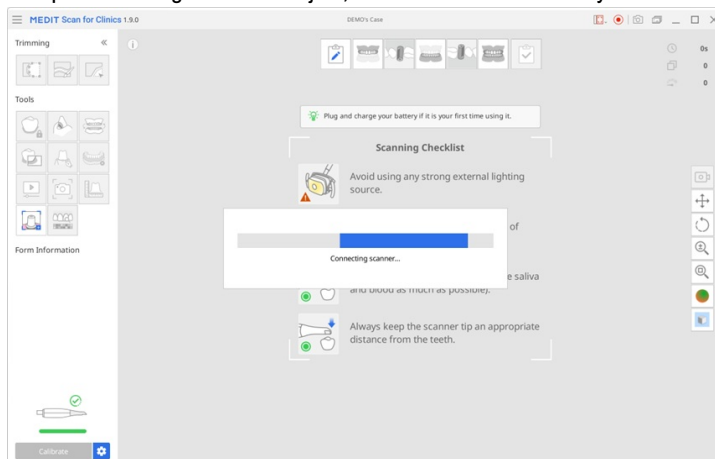


7. Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel dans Menu > À propos > Version du micrologiciel.

iNote

La mise à jour peut être interrompue si le hub est déconnecté du PC local ou si la batterie du scanner est faible. Dans ce cas, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel en reconnectant le hub au PC et en relançant le programme.

Connexion du scanner

Lorsque vous lancez Medit Scan for Clinics, vous pouvez vérifier le statut du scanner et du hub sans fil dans le coin inférieur gauche de l'écran.

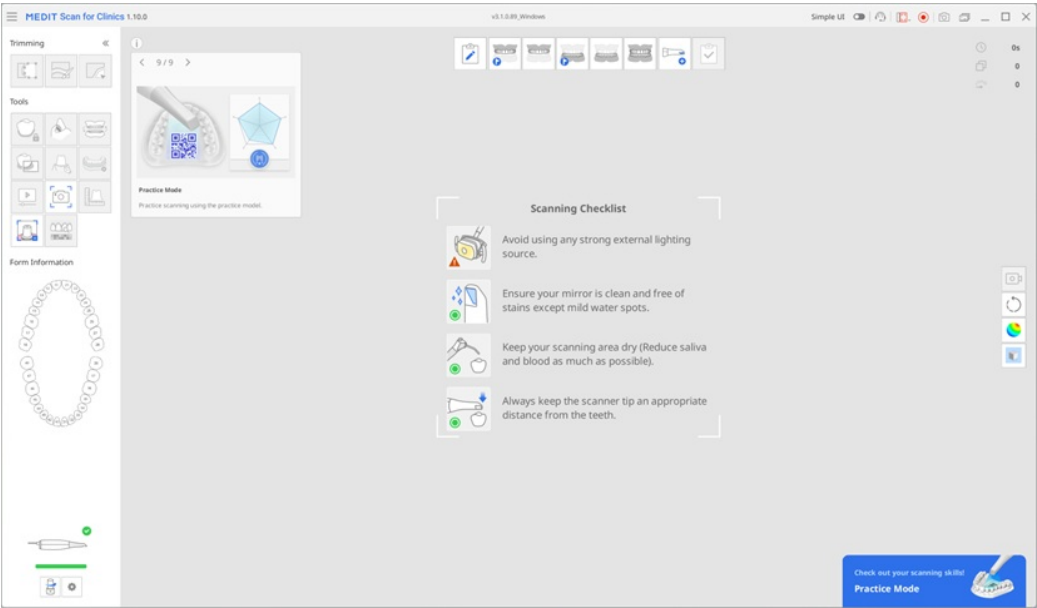

Statut du scanner

Voici les indications du statut du scanner :

Statut	Description	i500	i600	i700	i700 wireless
Déconnecté	Le scanner est déconnecté.				
Embout détaché	L'embout n'est pas monté.	Non disponible			
Connexion	Le scanner tente de se connecter.				
Redémarrage	Le scanner est en train de redémarrer.				
Calibrage requis	Le scanner a besoin d'être calibré.				
Prêt	Le scanner est prêt à être utilisé.				
Numérisation	Le scanner est actuellement en cours de numérisation.				
Veille	Le scanner est en mode veille.		Non disponible	Non disponible	
Surchauffe	Le scanner est en surchauffe.				

Statut du hub

Lorsque vous utilisez un scanner sans fil, le statut du hub sans fil s'affiche comme indiqué ci-dessous :


Hub connecté	Le hub est connecté à un scanner.	
Connexion	Le hub se connecte au PC.	
Scanner déconnecté	Le hub est déconnecté d'un scanner.	

Gestionnaire de jumelage


iNote

Cette fonction n'est disponible que pour l'appareil i700 wireless.

1. Connectez un hub sans fil pour i700 wireless et l'icône suivante apparaît sous l'image du statut du scanner.

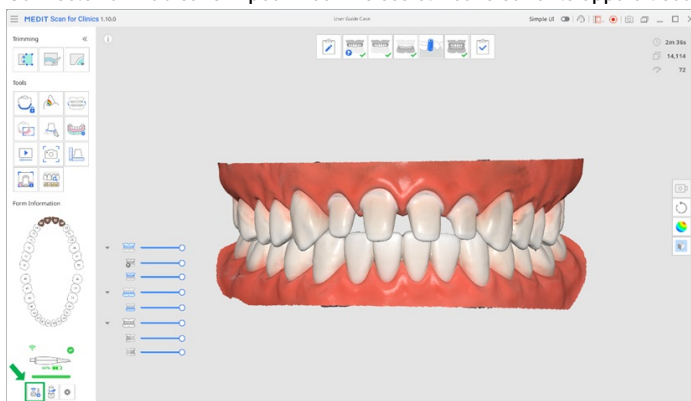


2. Cliquez sur l'icône "Gestionnaire de jumelage" pour afficher les options suivantes.

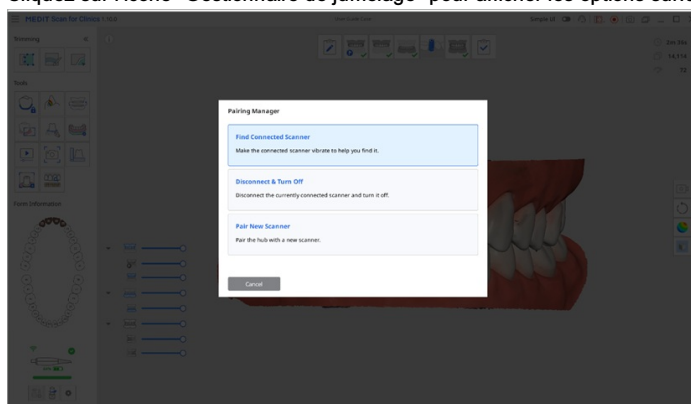


Trouver un scanner connecté	Faites vibrer le scanner jumelé pour vous aider à le retrouver.
Déconnecter et Éteindre	Déconnectez le scanner actuellement jumelé et éteignez-le.
Coupler un nouveau scanner	Associer le hub sans fil à un nouveau scanner.


3. Sélectionnez l'option "Coupler un nouveau scanner".
4. Allumez le scanner et cliquez sur "Suivant".

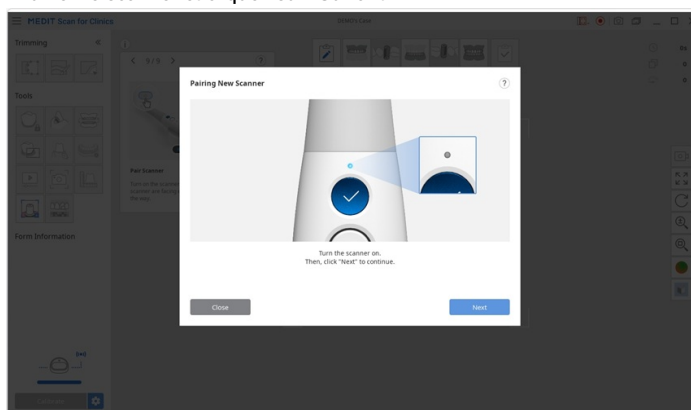


5. Tout d'abord, maintenez enfoncé le bouton de Commande du scanner, puis appuyez simultanément sur le bouton Scan. Lorsque la LED du scanner clignote rapidement, relâchez les deux boutons. Cliquez sur le bouton Coupler à l'écran. Le scanner commence à s'appairer avec le hub.

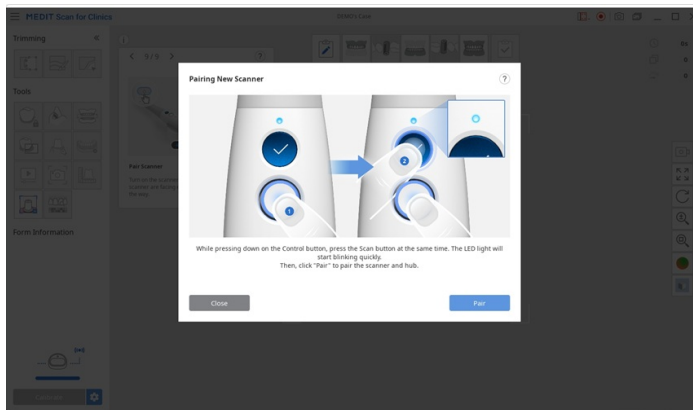


6. Essayez de ne pas perturber la communication entre le scanner et le concentrateur lorsque vous essayez d'appairer. Veillez à ne pas retirer la batterie du scanner ni à déconnecter le hub de votre PC.

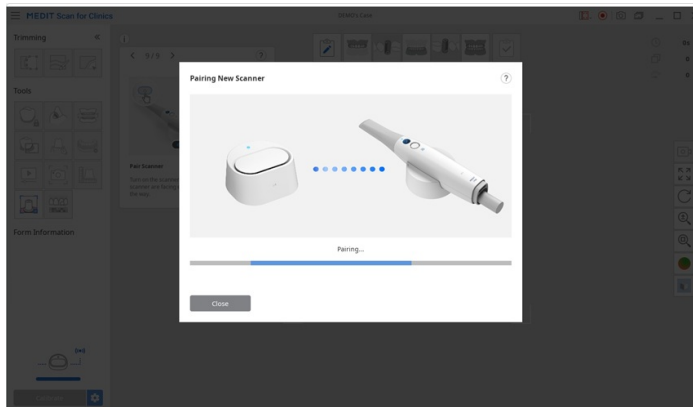

7. Cliquez sur "Terminer" lorsque le message "Le couplage a réussi !" apparaît.

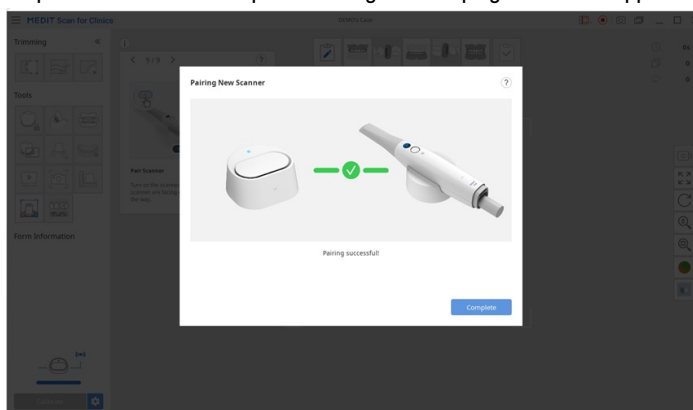


8. Vérifier le statut du scanner en bas à gauche.

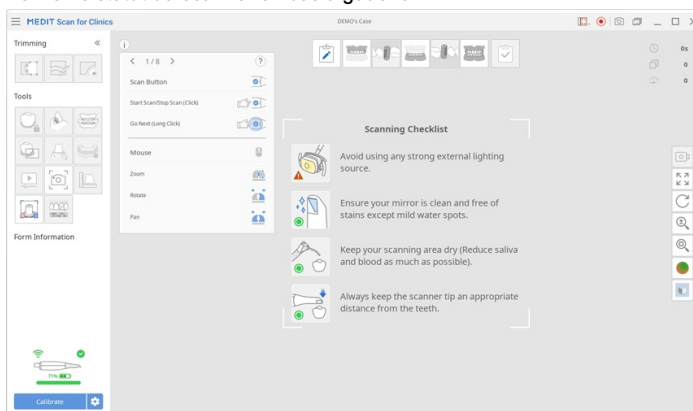

⚠ Mise en garde

Le message d'échec peut s'afficher lorsque la connexion est instable ou que le scanner ne parvient pas à s'associer au hub. Recommencez ensuite le couplage manuel depuis le début.

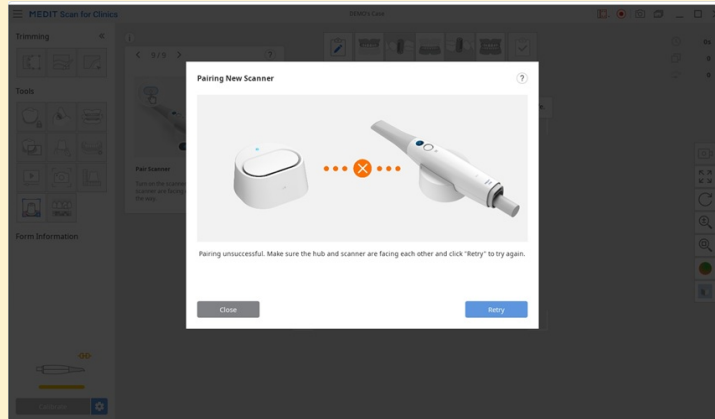

Changer et scanner

Changer et scanner permet d'enregistrer un seul scanner à deux ou plusieurs hubs sans fil et de basculer les connexions entre les hubs. Cette fonction vous permet de transporter un scanner d'une pièce à l'autre et de le connecter à n'importe quel hub sans fil de votre clinique.

Tout d'abord, il est nécessaire d'enregistrer les informations relatives à l'appareil du scanner et du hub sans fil par couplage manuel. Les scanners et les hubs sans fil non enregistrés ne peuvent pas se connecter les uns aux autres, quelle que soit la puissance du signal de connexion.

iNote

Cette fonction n'est disponible que pour l'appareil i700 wireless.

1. Assurez-vous que votre micrologiciel est à jour avant d'utiliser la fonction Changer et scanner.
2. Si vous vous connectez à un nouveau hub qui ne s'est jamais connecté à votre scanner, un couplage manuel est nécessaire pour enregistrer le scanner sur le nouveau hub.
3. Assurez-vous que votre scanner et le hub avec lequel il se connecte sont tous deux allumés. Vous pouvez connecter le scanner et le hub sans fil sans exécuter Medit Scan for Clinics.
4. Appuyez au centre de la touche de Commande pendant plus de deux secondes.
5. Le scanner vibrera brièvement trois fois. Cela signifie que vous êtes prêt à utiliser Changer et scanner.
6. Le scanner génère une courte vibration lorsqu'il est connecté à un hub sans fil.
7. Exécutez le programme et commencez la numérisation.

⚠ Mise en garde

- Si vous disposez de plusieurs hubs sans fil dans un espace de travail non fermé, il se peut que le scanner soit connecté à un autre hub que celui auquel vous souhaitez vous connecter.
- Si vous essayez de vous connecter entre deux hubs sans fil, il se peut que le scanner soit connecté à un autre hub que celui auquel vous souhaitez vous connecter.
- Si le scanner ne parvient pas à se connecter, rapprochez-vous du hub sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et essayez à nouveau de vous connecter en appuyant au centre du bouton de Commande pendant plus de deux secondes.

Calibrage du scanner

Calibrage du scanner intra oral

iNote

Il est recommandé de calibrer l'appareil périodiquement.

Allez dans Menu > Paramètres > Scanner, et configurez la période de calibrage dans l'option Période de calibrage (jours). La période de calibrage par défaut est de 14 jours.

Il est recommandé de procéder à un calibrage pour assurer une numérisation et des performances correctes de l'appareil.

Veuillez calibrer le scanner lorsque :

- La qualité des données numérisées a diminué par rapport aux scans précédents.
- Les conditions extérieures, telles que la température de l'appareil, ont changé pendant l'utilisation.
- La période de calibrage configurée est déjà dépassée.

⚠ Mise en garde

Le panneau de calibrage est un composant délicat. Veuillez ne pas le toucher.

Si l'étalonnage échoue, inspectez le panneau et contactez le fournisseur de services s'il est endommagé.

Veuillez noter que la précision des données de numérisation augmente si la température du scanner pendant le calibrage est similaire à celle de la numérisation.

Laissez votre scanner s'échauffer avant le calibrage pour qu'il atteigne la même température que lors de la numérisation.

Assistant de calibrage

Vous trouverez ci-dessous une description de la procédure de calibrage basée sur l'i700. Les autres scanners intra-oraux Medit peuvent être calibrés de la même manière.

iNote


L'utilisateur peut sélectionner "Suivant" ou "Terminer" en appuyant sur le bouton Scan du scanner.

1. Allumez le scanner et connectez-le au logiciel.
2. Cliquez sur l'icône "Calibrer" dans le coin inférieur gauche du programme pour lancer l'Assistant de calibrage.


Il suffit d'insérer le scanner dans l'outil de calibrage pour lancer l'Assistant de calibrage. (non disponible avec i500)



3. Préparez l'outil de calibrage et cliquez sur "Suivant" pour lancer le processus de calibrage.



4. Réglez le cadran de l'outil de calibrage sur la position 1.



5. Insérez la pièce à main dans l'outil de calibrage.




6. Cliquez sur "Suivant" pour lancer le calibrage.



7. Si la température du scanner est trop basse, un préchauffage sera nécessaire pour une meilleure performance.



8. Si la pièce à main est montée correctement, le système va automatiquement acquérir les données à la bonne position 1.




9. Après avoir terminé l'acquisition des données à la position 1, tournez le cadran à la position suivante selon les instructions à l'écran.




10. Répéter le processus ci-dessus pour les positions 2 à 8 et la DERNIÈRE.

11. Une fois l'acquisition des données à la position LAST terminée, le résultat du calibrage s'affiche.



Interface utilisateur

Vue d'ensemble

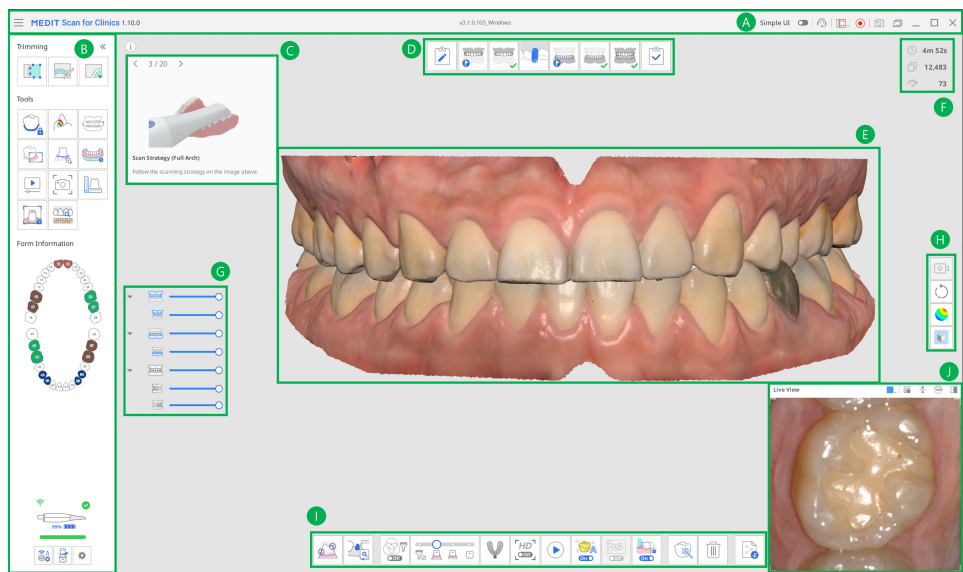

A	Barre de titre
B	Barre d'outils principale
C	Boîte d'informations
D	Étapes de numérisation
E	Vue du modèle
F	Informations sur la numérisation
G	Arborescence des données
H	Barre d'outils latérale
I	Barre d'outils de l'étape de numérisation
J	Vue en direct

iNote

La barre de titre peut avoir un aspect différent sur macOS, et l'image peut apparaître dans des tailles différentes en fonction de la résolution de l'écran.

Barre de titre

La barre de titre comprend les options suivantes.

	Menu	Fournir les fonctions de base du programme telles que Sauvegarder, Paramètres, Guide de l'utilisateur et À propos.
	IU simple	Un bouton de basculement pour passer à l'interface utilisateur simple.
	Soumettre une demande d'assistance	Accédez à une page du Centre d'aide Medit pour soumettre une demande d'assistance.
	Sélectionner zone de capture vidéo	Sélectionnez la zone de l'écran où enregistrer la vidéo. L'utilisateur peut enregistrer toute la fenêtre du programme ou seulement la zone où les données 3D sont affichées.
	Démarrer/Arrêter l'enregistrement vidéo	Démarrer ou arrêter la capture vidéo. Le fichier vidéo capturé peut faciliter la communication entre le patient, la clinique et le laboratoire.
	Capture d'écran	Capturer l'écran entier ou seulement la zone d'affichage des données 3D du logiciel de numérisation. Le fichier des images de capture peut faciliter la communication entre le patient, la clinique et le laboratoire.
	Gestionnaire d'images de captures d'écran	Gérer les images de capture. Les captures d'écran sont automatiquement enregistrées sur Medit Link. L'utilisateur peut les supprimer ou les enregistrer sur le PC local aux formats JPG, JEP, PNG et BMP.

Cliquer sur l'icône "Menu" permet d'afficher les options suivantes :


	Sauvegarder	Enregistre tous les changements dans le cas en cours.
	Paramètres	Affiche les options liées aux paramètres de l'environnement, telles que les options de numérisation.
	Guide de l'utilisateur	Ouvre le guide de l'utilisateur.
	À propos	Fournit des informations détaillées sur le logiciel, le scanner et l'entreprise.

Barre d'outils principale

Veillez vous référer à [Outils de la Barre d'outils principale](#) pour obtenir des informations sur l'utilisation des outils de la Barre d'outils principale.

Formulaire d'informations


Les informations du formulaire enregistrées par Medit Link donnent une vue d'ensemble des dents nécessitant un traitement.

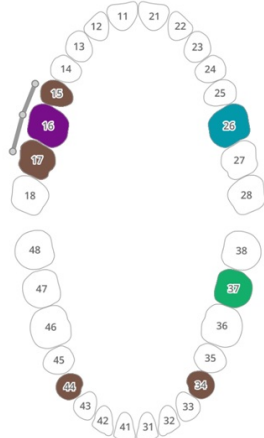

Boîte d'information

Les processus de numérisation et de modification sont accompagnés de brèves explications et d'aides visuelles visant à expliquer les principales fonctions et à présenter les outils qui peuvent être utiles à cette étape.

Pour les étapes de numérisation générale, les informations sont affichées dans un ordre aléatoire afin de permettre aux utilisateurs de découvrir les différentes fonctions.

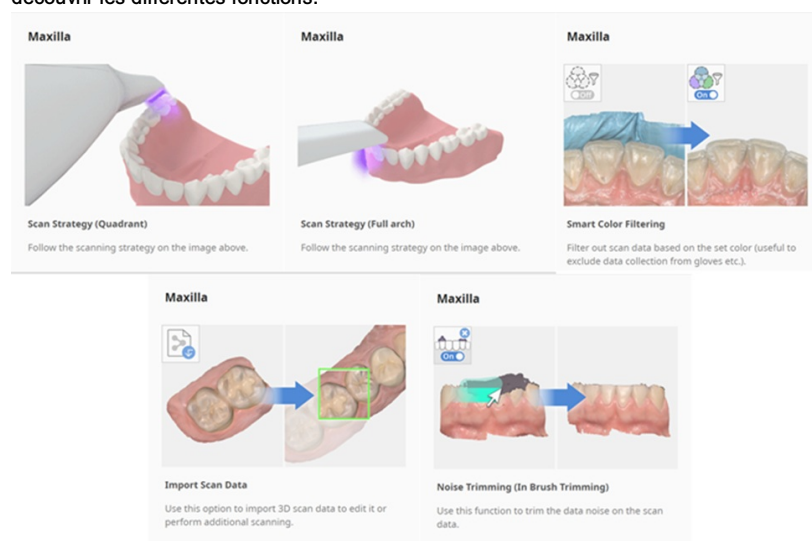

Étapes de numérisation

Veillez consulter [Gestion de l'état](#) pour plus d'informations sur la manière de définir le flux de travail de la numérisation.

Vue du modèle

Les données de numérisation correspondant à l'étape sélectionnée dans le cas sont affichées dans la zone d'affichage des données 3D. Vous pouvez également visualiser en temps réel les données acquises dans la zone pendant la numérisation.

Informations sur la numérisation




	Temps de Scan	Indique la durée de la numérisation pour chaque étape de la numérisation et pour toutes les étapes de la numérisation.
	Nombre de cadres	Affiche le nombre d'images prises pendant la numérisation pour chaque étape de la numérisation et pour toutes les étapes de la numérisation.
	Vitesse de numérisation	Affiche la vitesse de numérisation actuelle.

Arborescence des données

L'arborescence des données à l'étape de vue d'ensemble permet de contrôler les options d'affichage des données.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arborescence des données pour afficher les options suivantes :

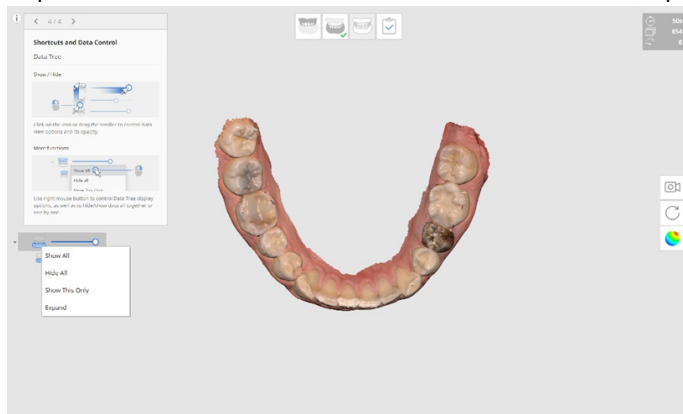

- Afficher tout
- Masquer tout
- Afficher ceci uniquement
- Agrandir/Réduire
- Utilisez le curseur pour contrôler l'opacité de chaque donnée.
- En passant la souris sur l'icône de chaque donnée, la zone correspondante est mise en évidence. Vous pouvez facilement différencier et examiner les données que vous souhaitez inspecter.

Barre d'outils latérale


Veuillez consulter [Outils de la Barre d'outils latérale](#) pour plus d'informations sur les outils de la Barre d'outils latérale.

Barre d'outils de l'étape de numérisation

Veuillez consulter [Outils de l'étape de numérisation](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des outils qui apparaissent au bas de l'écran pour chaque étape.

Vue en direct


La fenêtre Vue en direct affiche l'image 2D obtenue à partir du scanner et fournit des outils utiles.

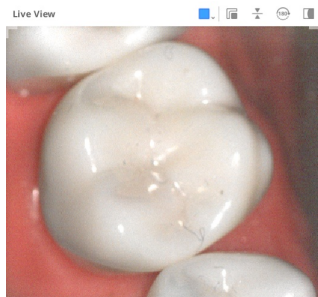


Les outils suivants sont disponibles dans la barre de titre de la fenêtre Vue en direct :

	Zone de scan personnalisée	Ajuste la zone d'acquisition des données de numérisation. Vous pouvez choisir entre les trois modes que nous proposons ou les adapter à votre convenance.
	Détacher la fenêtre Vue en direct	Détache la fenêtre Vue en direct de la position fixe. La taille de la fenêtre peut être modifiée lorsque la fenêtre est détachée.
	Réinitialiser la fenêtre Vue en direct	Permet de ramener la fenêtre Vue en direct à la position et à la taille par défaut.
	Pivoter l'image	Retourne l'image sur l'écran. Cette fonction est utile pour effectuer une numérisation intra-orale à partir du haut de la tête du patient.
	Pivoter à 180°	Permet de pivoter les données de numérisation de 180 degrés pour faire correspondre la direction des données dentaires sur l'écran à votre point de vue sur les dents du patient.
	Afficher/Masquer Masquage	Activer ou désactiver la visibilité de la zone non numérisable. La zone non numérisable est représentée par un masquage bleu.

En cliquant sur l'icône "Zone de scan personnalisée", les quatre options suivantes s'affichent pour définir la taille de la fenêtre Vue en direct :

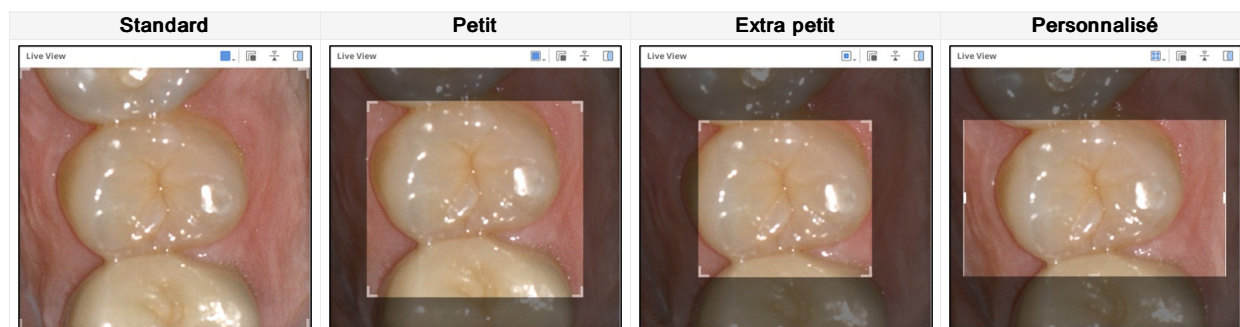

Cliquer sur l'icône "Afficher/Masquer Masquage" permet d'afficher ou de masquer la zone non numérisable de la manière suivante :

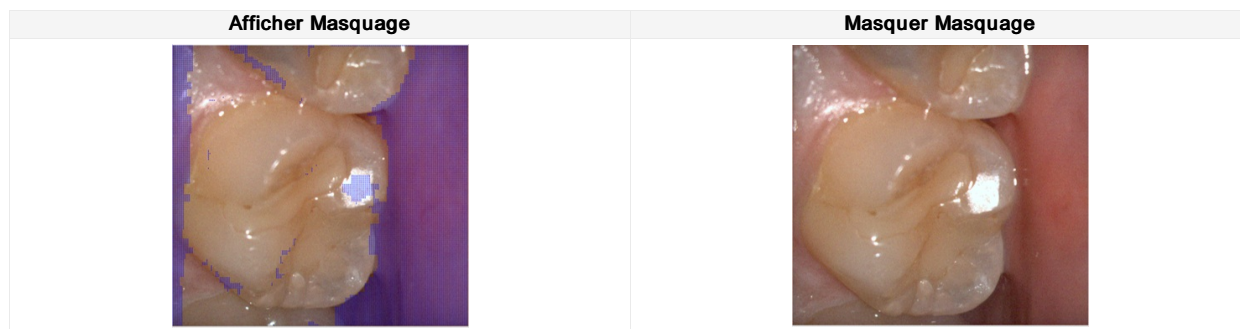


Profondeur de scan

La profondeur de scan peut être réglée comme suit en fonction du type de scanner :


- i500 : 12(mm)-21(mm)
- i600, i700, i700 wireless : 12(mm)-23(mm)

Une profondeur de scan plus importante peut être appliquée à presque tous les procédés généraux de numérisation. Une profondeur de scan plus faible est utile pour filtrer les données bruyantes, telles que les tissus mous inutiles.

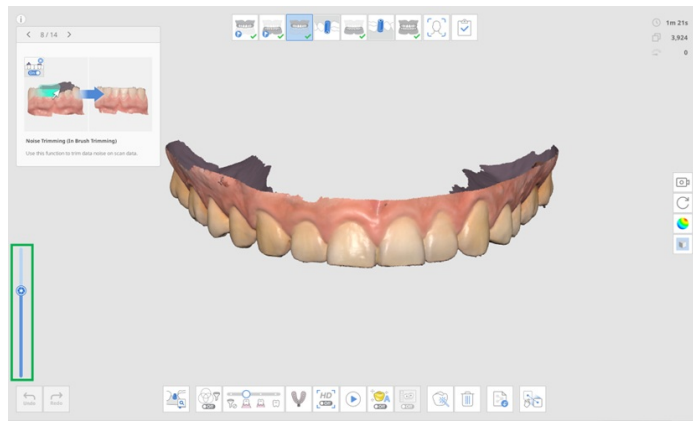

Paramètres

Allez dans Menu > Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres de Medit Scan for Clinics.

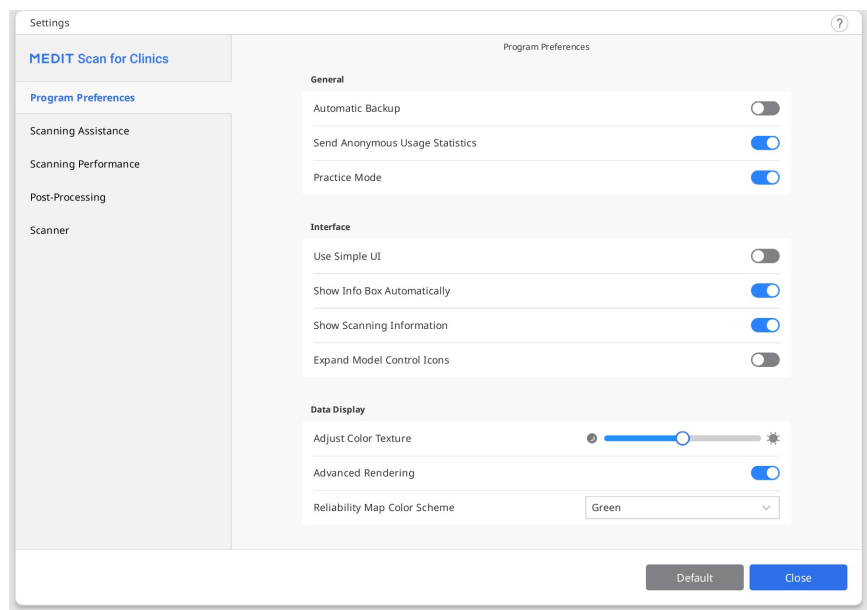

Note

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Par défaut", tous les paramètres configurés sont ramenés à leur valeur par défaut.

Préférences du programme

Général

Sauvegarde automatique	Sauvegarder temporairement le travail en cours. Les données de sauvegarde seront utilisées pour la récupération si le programme s'arrête inopinément sans sauvegarder.
Envoyer des statistiques d'utilisation anonymes	Indiquez si vous souhaitez envoyer des statistiques d'utilisation anonymes à Medit. Collecte de statistiques anonymes Medit s'efforce d'améliorer constamment le produit et l'expérience de l'utilisateur en collectant certaines informations telles que : • Les configurations matérielles et logicielles, telles que le système d'exploitation, la carte graphique, etc. • Les modèles et les tendances d'utilisation de notre logiciel, tels que la fréquence et les performances. • Les informations sur le diagnostic. Les statistiques d'utilisation aideront l'équipe de développement à mieux comprendre les besoins des utilisateurs et à apporter des améliorations dans les versions futures. Nous ne collecterons jamais d'informations personnelles, telles que votre nom, le nom de votre entreprise, votre adresse MAC ou toute autre information liée à l'identification personnelle. Nous ne pouvons pas et nous ne ferons pas de rétro-ingénierie des données collectées pour trouver des détails spécifiques concernant vos projets.
Mode entraînement	Fournit une formation à la numérisation aux utilisateurs à l'aide d'un modèle pratique. Lorsque cette option est activée, la bannière "Mode entraînement" s'affiche en plein écran lorsqu'il n'y a pas de données de numérisation acquises. * Non disponible avec i500




Interface

Utiliser IU simple	Lorsque cette option est activée, le programme passe de l'interface par défaut à l'interface simple. L'interface simple offre un minimum de fonctionnalités pour acquérir et traiter les données de numérisation.	
Afficher automatiquement la boîte d'information	Lorsque cette option est activée, le programme affiche automatiquement la boîte d'information dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pendant que vous travaillez avec le programme.	
Afficher les informations de numérisation	Temps de Scan	Affiche le temps de scan pour chaque étape ou la durée totale de la numérisation.
	Nombre de cadres	Affiche le nombre d'images prises par le scanner pour chaque étape ou le nombre total.
	Vitesse de numérisation	Affiche la vitesse de numérisation actuelle.
Développer les icônes de contrôle du modèle	Lorsque cette option est activée, les icônes de contrôle du modèle 3D de panoramique, rotation, zoom et ajustement du zoom sont ajoutées à la barre d'outils latérale.	

Affichage des données

Ajuster la texture de la couleur	Régler la luminosité du modèle 3D. La couleur du modèle 3D sera optimisée pour le logiciel d'acquisition d'images. Lorsque vous visualisez des données à l'aide d'un autre logiciel, les couleurs obtenues peuvent être légèrement différentes de celles du logiciel d'acquisition d'images.
Rendu avancé	Affiche des données 3D très nettes grâce à une technologie de pointe.
Schéma de couleurs des cartes de fiabilité	Permet de définir la couleur des données fiables entre le vert, le bleu et le vert/jaune.

Assistance à la numérisation

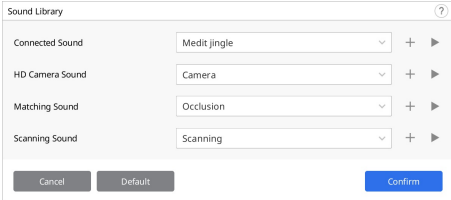Guide de scan intelligent	Permet d'identifier toute action inhabituelle au cours de la numérisation et fournit des conseils pertinents.
Flèche intelligente	Les flèches bleues indiquent les zones à faible fiabilité d'après les données de numérisation recueillies.
Avertissement pour la lumière externe (Bêta)	Affiche un avertissement lorsqu'une source de lumière externe affecte la numérisation.
Avertissement pour les données occlusales	Lorsque l'utilisateur clique sur "Terminer" après avoir scanné les données, le programme vérifie les données et leur statut d'alignement acquis au cours de l'étape de numérisation de l'occlusion.
Activer retour audio	Indique le statut du scanner par différents sons.
Bibliothèque de sons	Permet de sélectionner le fichier son pour le retour audio indiquant le statut de l'appareil. Des fichiers audio de différents formats, notamment .wav, .mp3 et .wma, peuvent être ajoutés à la liste des sons.  Pour le son de numérisation, des options supplémentaires telles que "Lecture aléatoire" et "Volume pour perte de suivi" sont proposées. 
Préréglage de la fenêtre de Vue en direct	Définir les paramètres par défaut des options de la fenêtre Vue en direct, telles que la taille de la fenêtre, détacher/réinitialiser la fenêtre et afficher/masquer Masquage. Une fois que vous avez modifié les paramètres de la fenêtre prédéfinie, les changements sont appliqués à la fenêtre Vue en direct qui s'affiche pendant que vous récoltez les données de numérisation. Live View Window Preset You can save your preferred settings of the Live View window by checking or unchecking the icons on the preset dialog below. The saved settings will be applied to the Live View while scanning. 

Performance de numérisation

Utiliser le GPU	Utilisez cette option pour améliorer les performances informatiques globales à l'aide du GPU (processeur graphique).
Empêcher le désalignement des données de scan	Aligner les données de numérisation à l'aide d'informations supplémentaires lors de l'acquisition de données de numérisation avec l'option Filtrage de scan intelligent activée
Extension de la plage dynamique	Utilise les données périphériques pour faciliter la numérisation des zones difficiles à numériser.
Intervalle Couture intelligente	Règle l'intervalle afin d'acquérir de nouvelles données de numérisation pour la Couture intelligente.  Lorsque la fonction Couture intelligente est activée, vous pouvez acquérir et enregistrer des zones discontinues en tant que données distinctes, et les zones continues seront alignées ultérieurement lorsque vous acquerez d'autres données entre les deux. Un intervalle couture intelligente plus court permettra de commencer la numérisation des données discontinues plus tôt. En même temps, un intervalle couture intelligente plus long attendra un peu plus longtemps que l'utilisateur acquière des données contiguës avant d'accepter des données discontinues.

Utiliser le Filtrage erreur IA dans la Vue en direct (Bêta)	Permet de filtrer l'image parasite acquise lors de la numérisation. Les résultats peuvent être affectés par la force du signal de connexion du scanner. * i700w uniquement
Filtrage global des tissus mous	Permet de supprimer les données des tissus mous et les données bruyantes. Le filtrage global des tissus mous est effectué pendant la numérisation, lorsque vous passez à une autre étape de la numérisation et lorsque vous terminez.
Filtrage actif du bruit (Bêta)	Supprime efficacement les données bruyantes acquises lors de la numérisation.
Empêcher le désalignement de l'occlusion (Bêta)	Permet de vérifier la direction de l'occlusion et des données mandibulaires pour éviter tout désalignement lors de l'acquisition des données d'occlusion.

Post traitement

Taille du fichier	Ajuste la taille du fichier de résultat.  En positionnant la barre de défilement vers la gauche, le calcul est plus rapide et le fichier est plus petit. Les utilisateurs peuvent déterminer la taille du fichier en fonction de l'utilisation prévue du fichier de résultat. Des fichiers de résultat plus petits conviennent aux cas d'orthodontie.
Optimiser l'alignement de l'occlusion	Lorsque cette option est activée, le programme optimise les données d'alignement de l'occlusion.  Positionnez la barre de défilement vers la gauche pour desserrer l'alignement de l'occlusion du maxillaire et de la mandibule, alors que si vous positionnez la barre de défilement vers la droite, vous resserrez l'alignement de l'occlusion du maxillaire et de la mandibule.
Utiliser des couleurs voisines pour les trous remplis	Activez cette option si vous souhaitez remplir les espaces vides dans les données de numérisation avec la couleur des données adjacentes.
Nettoyage des couches de données (Bêta)	Permet d'identifier et supprimer automatiquement les zones de double ou de multiple couches tout en optimisant les données de numérisation.
Utiliser le traitement en arrière-plan	Permet de traiter les données en arrière-plan pour les étapes où aucune donnée n'est acquise ou manipulée.
Optimiser après l'alignement de l'occlusion	Optimise automatiquement les données maxillaires et mandibulaires lorsque l'alignement de l'occlusion est terminé. Les relations occlusales optimisées vous permettent de prévisualiser l'état occlusal des données du résultat final.

Scanner

Scan automatique	Le programme démarre automatiquement la numérisation lorsque vous entrez dans les étapes de numérisation sans appuyer sur le bouton Scan du scanner. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez démarrer la numérisation en appuyant sur le bouton Scan.
Période de calibrage (jours)	Permet de définir la période de calibrage du scanner.
Lancer le scan avec le scan HD	Permet de démarrer la numérisation en mode HD par défaut.
Lumière de scan	Permet de choisir entre la lumière bleue et la lumière blanche pour la lumière de scan.
Notification de la température minimale du scanner	La température du scanner est vérifiée lorsque l'utilisateur commence la numérisation. Si la température du scanner passe en dessous de la valeur minimale, le scanner commence à préchauffer. * Indisponible avec i500
Activer UV automatiquement	Permet d'allumer automatiquement la lampe UV lorsque le scanner est connecté ou lorsque la numérisation s'arrête. La lampe UV s'éteint automatiquement après la durée définie pour l'option "Durée de fonctionnement UV" ou lorsque la numérisation commence. * Indisponible avec i500, i600
Durée de fonctionnement UV	Définissez la durée de l'option "Activer automatiquement les UV".
Activer la rétroaction par vibration pendant la numérisation	Avertit les utilisateurs en faisant vibrer le scanner en cas de désalignement, etc. * Non disponible avec i500, i600
Mode du ventilateur anti-buée	Sélectionnez un mode de ventilation entre le "Mode silencieux" et le "Mode haute performance" pour éliminer la buée du miroir lorsque la température du scanner est basse.
Expérience de numérisation	Permet de choisir entre un affichage plus fluide de l'écran ou l'acquisition de données de numérisation avec les meilleures performances. * i700, i700w uniquement

Actions du bouton Scan

Double clic	Permet de définir l'action du double-clic sur le bouton Scan du scanner.
Triple clic	Permet de définir l'action du triple-clic sur le bouton Scan du scanner.
Clic long	Permet de définir l'action du clic long sur le bouton Scan du scanner.

Sur batterie

Passer au Mode veille après	Le scanner passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant le nombre de minutes défini. * i700w uniquement
Éteindre le scanner après	Le scanner est éteint s'il n'est pas utilisé pendant le nombre de minutes indiqué après le passage en mode veille. * i700w uniquement

Lorsque le scanner est branché

Éteindre le scanner après	Le scanner est éteint s'il n'est pas utilisé pendant le nombre de minutes indiqué lorsqu'il est branché. * Indisponible avec i500
---------------------------	--

Opération de base

Contrôle des données 3D


Contrôle des données 3D à l'aide des boutons du scanner

Medit Scan for Clinics prend en charge trois modes de contrôle des données : Pivoter, Panoramique et Zoom. Vous pouvez changer de mode en cliquant au centre du bouton de commande de votre scanner.


I Note

- Non disponible avec i500, i600


• Zoom

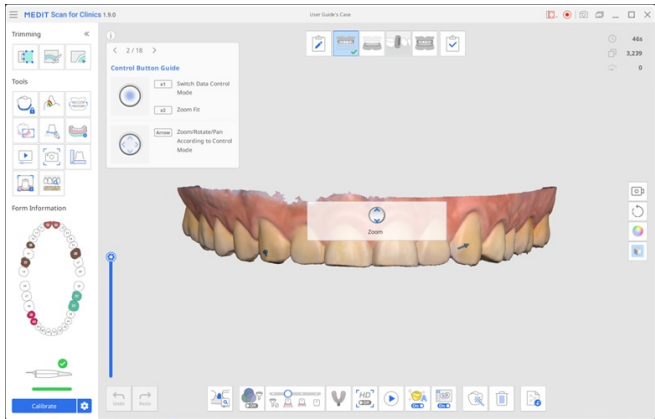

• Pivoter

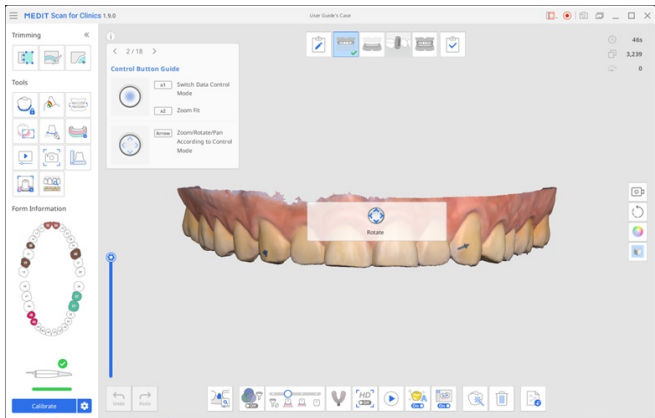


• Panoramique

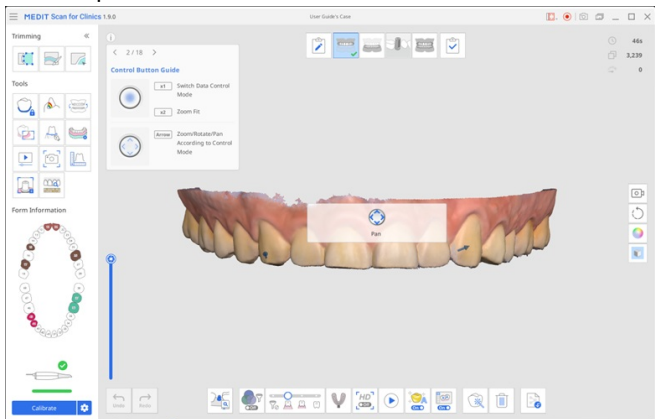

- Ajustement du zoom : Double-cliquez sur le bouton de commande pour aligner les données au centre de l'écran.

Contrôle des données 3D à l'aide de la souris

	Image	Description
Zoom		Défilez la molette de la souris.
Mise au point zoom		Double-cliquez sur les données.

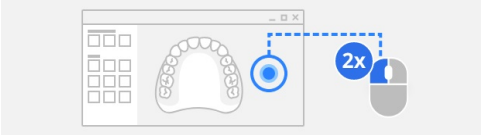Ajustement du zoom		Double-cliquez sur l'arrière-plan.
Pivoter		Faites glisser le bouton droit.
Panoramique		Faites glisser la molette de la souris.

Contrôle des données 3D à l'aide de la souris et des touches du clavier

	Windows		macOS	
Zoom	 + 	 + 	 + 	 + 
Pivoter	 + 	 + 	 + 	 + 
Panoramique	 + 	 + 	 + 	 + 

Prise en charge de la souris 3D


Medit Scan for Clinics prend en charge l'utilisation d'une souris 3D 3Dconnexion.

Les outils de développement de périphériques d'entrée 3D et la technologie connexe sont fournis sous licence par 3Dconnexion. © 3Dconnexion 1992 - 2013. Tous droits réservés.

Principes de base de la numérisation

Check-list de numérisation

Si aucune donnée de numérisation n'a encore été acquise, l'écran principal affiche la check-list de numérisation.

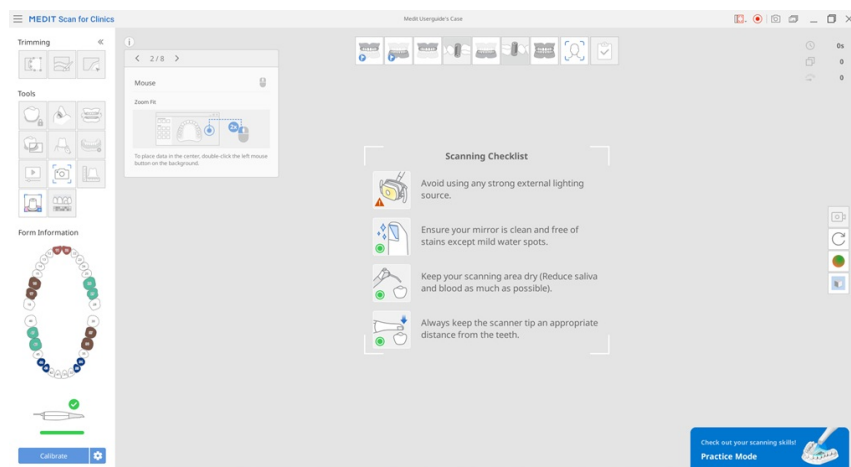

Veuillez lire attentivement les précautions avant de lancer la numérisation :

- Évitez d'utiliser toute source de lumière externe forte.
- Veillez à ce que le miroir soit propre et exempt de taches.
- Gardez la zone de numérisation sèche (réduisez la salive et le sang autant que possible).
- Gardez toujours l'embout du scanner à une distance appropriée des dents.

Mode entraînement


Le mode entraînement est destiné à aider les utilisateurs à apprendre à effectuer des numérisations correctes à l'aide d'un modèle d'entraînement.

Vous pouvez scanner le code QR associé au modèle d'entraînement pour télécharger les données échantillons ou, si vous les avez déjà téléchargées, vous pouvez récupérer et utiliser les données échantillons sauvegardées.

Les données acquises en mode entraînement ne sont pas sauvegardées lorsque vous quittez ce mode.

iNote

- Allez dans Paramètres > Préférences du programme > Général et activez l'option "Mode entraînement" pour afficher la bannière du mode d'entraînement.
- La bannière du Mode entraînement n'apparaît en plein écran que lorsqu'il n'y a pas de données de numérisation acquises.
- Le Mode entraînement n'est pas disponible avec le i500.

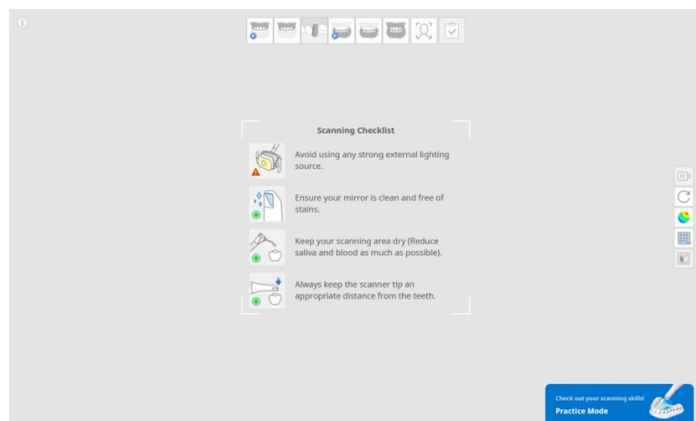


Le Mode entraînement propose trois niveaux d'entraînement, et chaque niveau a des critères de score différents.

- Pour les débutants : un niveau pour les utilisateurs novices d'un scanner intra-oral
- Pour les experts : un niveau pour les utilisateurs intermédiaires qui sont familiers avec l'utilisation d'un scanner intra-oral
- Pour les maîtres : un niveau pour les utilisateurs expérimentés qui veulent atteindre le niveau le plus élevé, au-delà des experts.


Les données de numérisation acquises seront supprimées si le niveau de difficulté est modifié pendant la numérisation.

Accéder au Mode entraînement


1. Préparez le modèle de pratique qui est inclus dans l'emballage du scanner. Veuillez contacter votre prestataire de services local pour des achats supplémentaires.
2. Lancez Scan for Clinics et cliquez sur la bannière "Mode entraînement" en bas à droite de l'écran.




3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

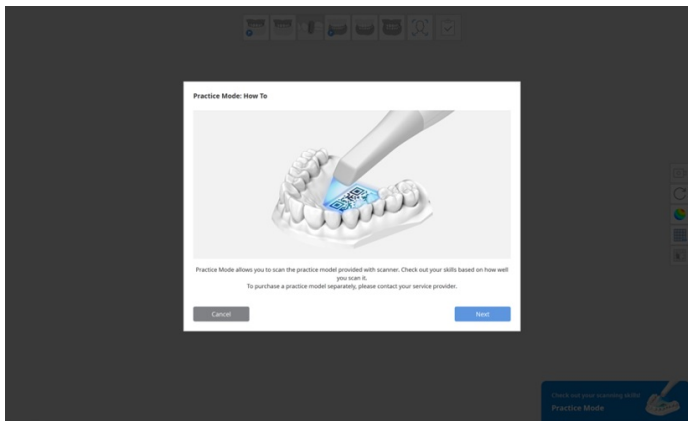


4. Cliquez sur "Télécharger les données du Modèle d'entraînement" pour télécharger les données de votre modèle d'entraînement à partir du serveur.
 Vous pouvez choisir l'option "Utiliser les données du modèle d'entraînement stockées sur votre ordinateur" si vous disposez des données déjà téléchargées. Dans ce cas, sélectionnez le numéro de série qui correspond à celui de votre modèle d'entraînement.

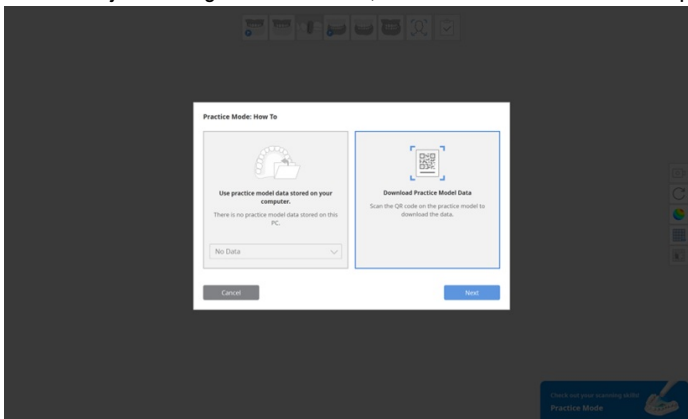


5. Scannez le code QR avec votre scanner. Lorsque l'appareil photo s'allume, il reconnaît le code QR. Si le code QR est endommagé, vous pouvez saisir le numéro de série sur l'autocollant.

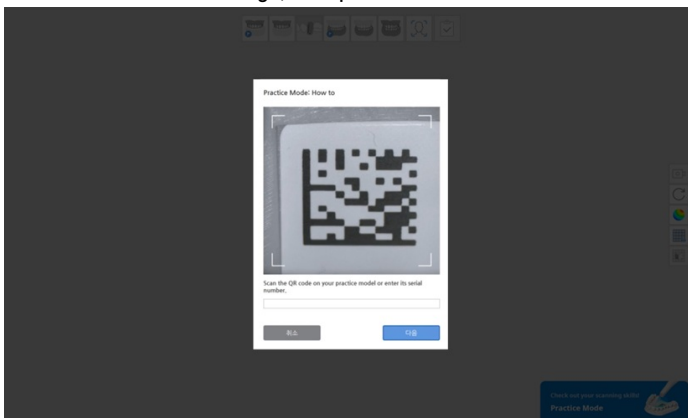


6. Cliquez sur "Suivant" une fois que le numéro de série est validé.

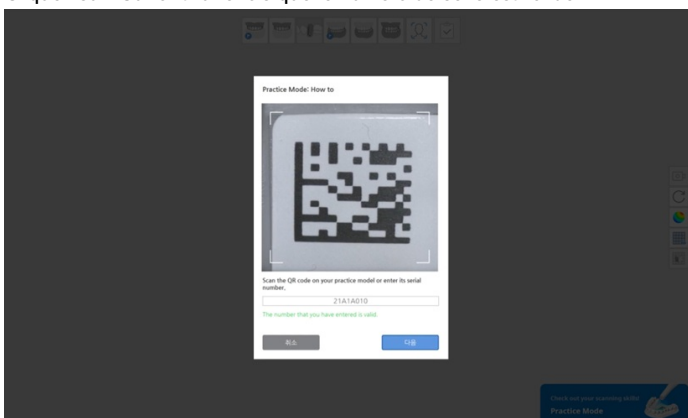

7. Une vidéo d'information sur la manière de numériser le modèle d'entraînement sera diffusée pendant le téléchargement.

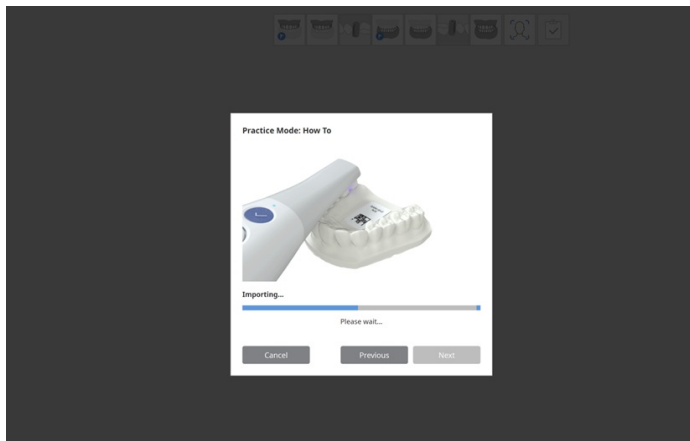

8. Lorsque le téléchargement est terminé, cliquez sur "Suivant" pour sélectionner un niveau.
9. Sélectionnez un niveau de difficulté parmi les niveaux Pour les débutants, Pour les experts et Pour les maîtres.

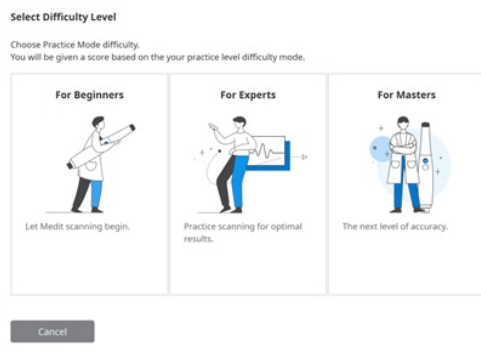



Entraînement à la numérisation

1. Cliquez sur le bouton "Scan" pour commencer une fois que les données échantillon téléchargées sont affichées à l'écran.



2. Suivez les instructions et les indications des flèches pour numériser le modèle d'entraînement.
3. Vérifiez les informations de numérisation et la progression de l'acquisition des données pour une pratique efficace de la numérisation.

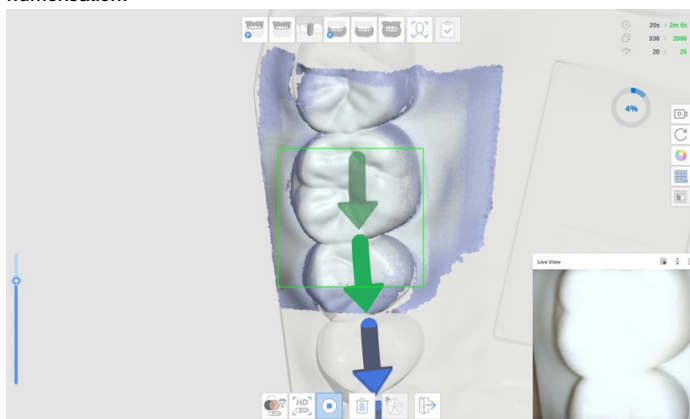

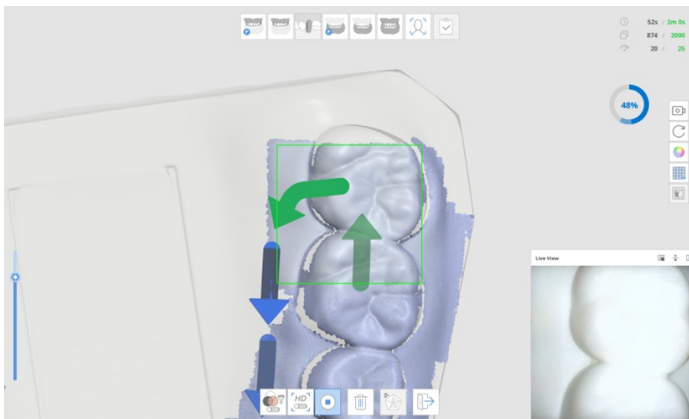


4. Lorsqu'un certain nombre de données de numérisation sont acquises, la progression se transforme en une coche et l'icône "Vérifier les résultats du mode entraînement" en bas de page est activée.




5. Cliquez sur l'icône "Vérifier les résultats du Mode entraînement" pour vérifier le score.



6. Le score sera basé sur le niveau de difficulté sélectionné, le temps de scan, le taux de progression, le taux de fiabilité des données, etc.


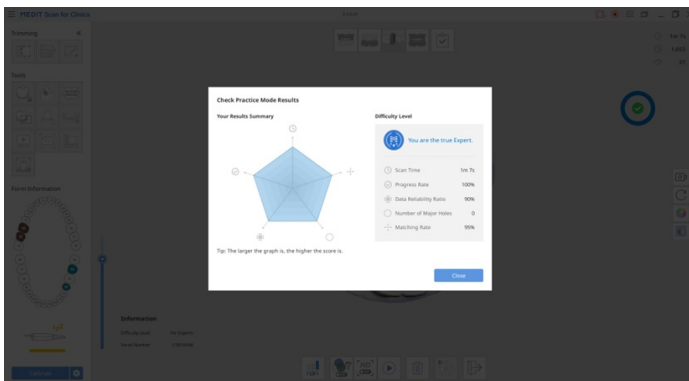


7. Vous pouvez effectuer des numérisations supplémentaires après avoir consulté les résultats et vérifier à nouveau les résultats sur la base des données obtenues après la numérisation supplémentaire.

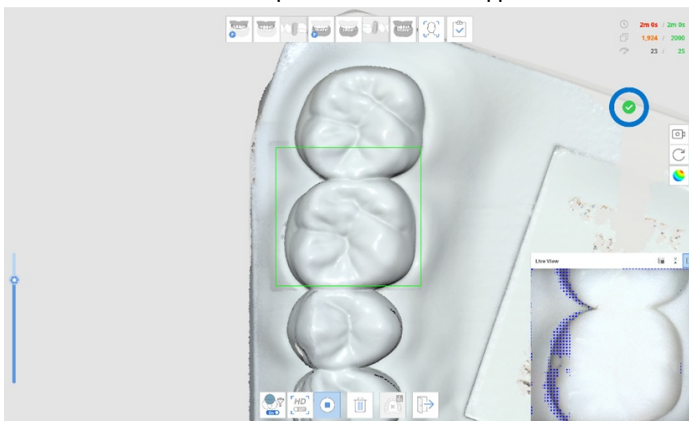

Indication pendant la numérisation

La couleur de la boîte rectangulaire qui apparaît pendant la numérisation indique le statut de la numérisation.

	
La numérisation et le suivi se déroulent normalement.	Perte de suivi lors de la numérisation. Vous devez repositionner l'embout du scanner pour numériser en continu à partir de l'endroit où vous êtes arrêté.

Flèche intelligente


La flèche intelligente indique les zones de faible fiabilité sur les données de numérisation acquises.

Lorsque vous arrêtez la numérisation, une flèche bleue pointe vers la zone dont la fiabilité est insuffisante. Les flèches disparaissent lorsque la fiabilité des données s'améliore grâce à une numérisation supplémentaire.


Cette fonction n'est prise en charge que dans les étapes de numérisation :

- Pré-op pour maxillaire
- Pré-op pour mandibule
- Maxillaire
- Mandibule


1. Numérisez les données dans l'une des étapes de numérisation prises en charge.
2. Lorsque la numérisation s'arrête, des flèches bleues apparaissent pour indiquer les zones où la fiabilité des données est faible.

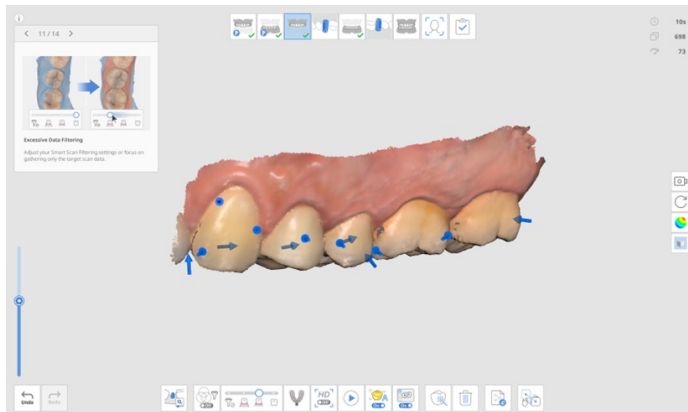

3. Vérifiez les données de numérisation en examinant les zones marquées. Vous pouvez inspecter la zone plus en détail en sélectionnant "Carte de fiabilité" ou "Texture activée + carte de fiabilité" pour le Mode d'affichage du modèle.

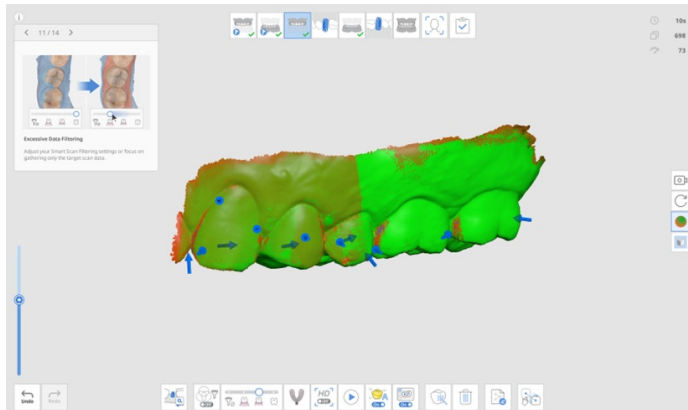

4. Numérisez des données supplémentaires pour combler les lacunes. Déplacez le scanner dans plusieurs directions et numérisez les données sous différents angles afin d'améliorer la fiabilité des données.
5. La flèche disparaît lorsque suffisamment de données fiables sont acquises.

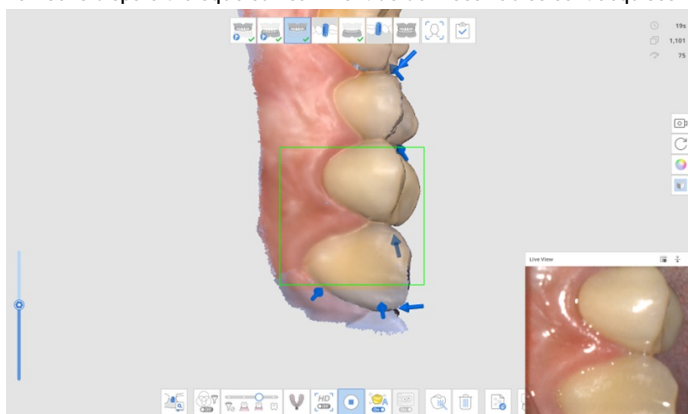


6. Effectuez une numérisation complète pour éliminer toutes les flèches autour de vos zones d'intérêt (par exemple, si vous créez une restauration, concentrez-vous sur les marges et les dents adjacentes) et passez à l'étape suivante de la numérisation.


Guide de scan intelligent

Le Guide de scan intelligent identifie toute action inhabituelle au cours de la numérisation et fournit des conseils appropriés. Le message disparaît automatiquement après un certain temps ou si la situation est résolue.


- Lorsqu'il y a trop de données filtrées au cours de la numérisation avec le Filtrage de scan intelligent

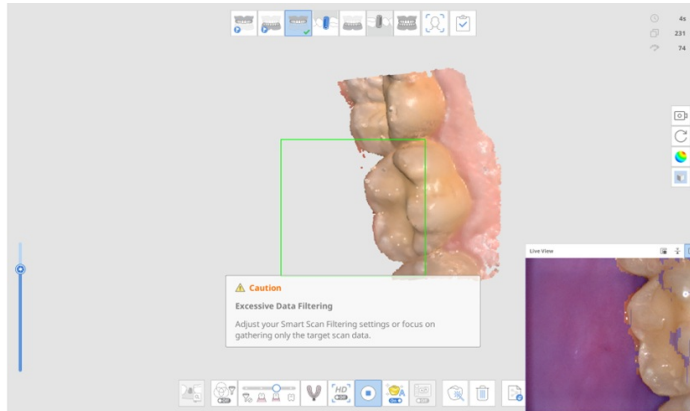

- Lorsque la numérisation est incohérente et qu'elle se poursuit à partir d'un nouvel endroit (lorsque l'option Couture intelligente est désactivée)

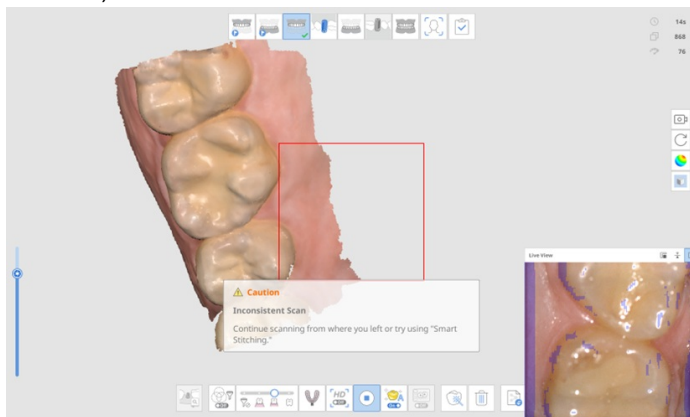

Lorsque la numérisation s'arrête, des guides supplémentaires sont fournis dans la Boîte d'information située dans le coin supérieur droit.

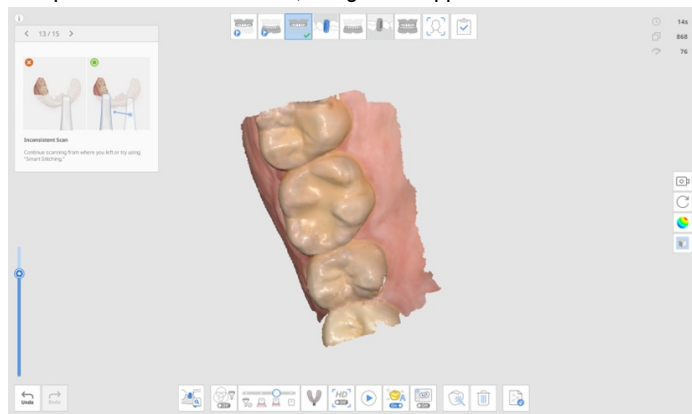

Gestion de l'état

Étapes de numérisation

Scan for Clinics propose Maxillaire, Mandibule et Occlusion comme étapes de numérisation par défaut.



La Gestion de l'état permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer les étapes de leur flux de travail et de modifier l'ordre, quelles que soient les informations du formulaire enregistrées dans Medit Link. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier l'ordre des étapes "Visage" et "Données supplémentaires".



Les étapes de numérisation suivantes peuvent être configurées dans l'étape de Gestion de l'état :

	Pré-op pour maxillaire	Acquiert une image 3D pré-op pour le maxillaire.
	Pré-op pour mandibule	Acquiert une image 3D pré-op pour la mandibule.
	Maxillaire	Réalise une image 3D du maxillaire.
	Scanbody maxillaire	Réalise une image 3D du Scanbody du maxillaire.
	Mandibule	Réalise une image 3D de la mandibule.
	Scanbody mandibulaire	Réalise une image 3D du Scanbody de la mandibule.
	Maxillaire édenté	Réalise une image 3D du maxillaire édenté.
	Prothèse maxillaire	Réalise une image 3D de la prothèse maxillaire.
	Mandibule édentée	Réalise une image 3D de la mandibule édentée.
	Prothèse mandibulaire	Réalise une image 3D de la prothèse mandibulaire.
	Occlusion	Réalise une image 3D de l'alignement de l'occlusion.
	Visage	Permet d'acquérir des données 3D des dents, de la bouche, du nez, etc.
	Données supplémentaires	Permet d'acquérir des données supplémentaires pour le processus de numérisation. Vous pouvez numériser les restaurations existantes des patients, les restaurations provisoires, etc.
	Terminer	Termine la numérisation et génère les données de résultat.

iNote


- L'étape Prothèse maxillaire/mandibulaire est disponible lorsque Prothèse complète, Réplique de prothèse ou Prothèse implanto-portée est spécifiée dans les informations du formulaire sur Medit Link.
- L'étape Maxillaire/Mandibule édenté est disponible lorsque Prothèse complète ou Prothèse implanto-portée est spécifiée dans les informations du formulaire sur Medit Link.

Ajouter/Retirer des étapes


1. Cliquez sur l'icône Gestion de l'état.




2. La boîte de dialogue Gestion de l'état s'affiche.
3. Cliquez sur les étapes que vous souhaitez ajouter dans la liste de la section de droite.

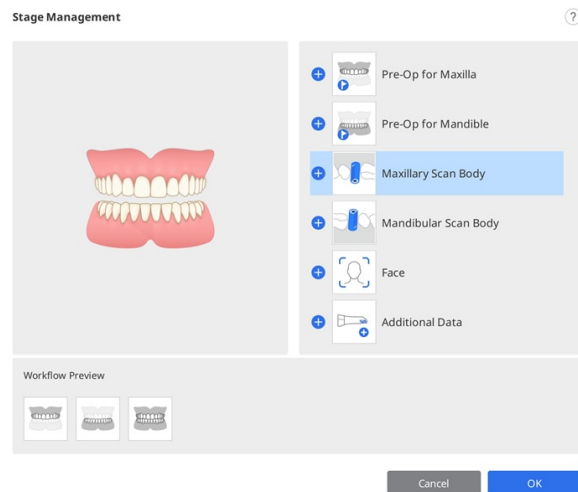

4. L'étape sélectionnée est ajoutée en bas, à la section Aperçu du flux de travail.

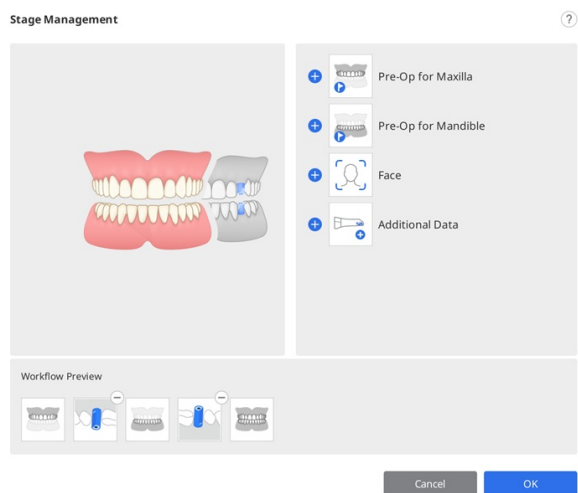

5. Vous pouvez modifier l'ordre des étapes du flux de travail en faisant glisser les icônes des étapes dans l'Aperçu du flux de travail. En cliquant sur ☺ dans le coin supérieur droit de l'icône étape, vous supprimez l'étape du flux de travail.

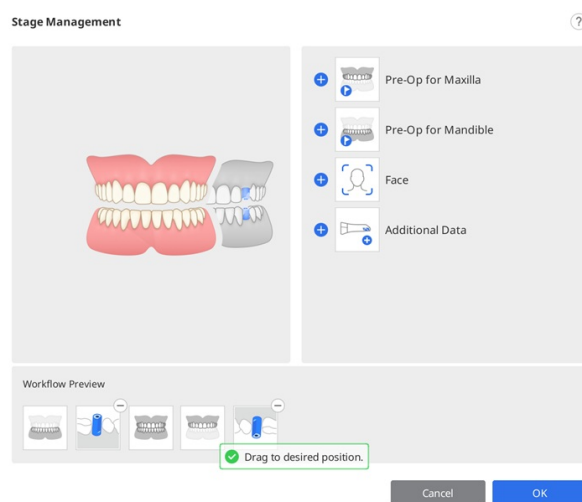


6. Cliquez sur "OK" pour sauvegarder le flux de travail modifié.
 7. La boîte de dialogue Gestion de l'état disparaît et les icônes des étapes en haut de l'écran sont mises à jour en fonction du flux de travail modifié.




Enregistrer comme flux de travail par défaut


1. Cliquez sur l'icône Gestion de l'état pour lancer la Gestion de l'état.

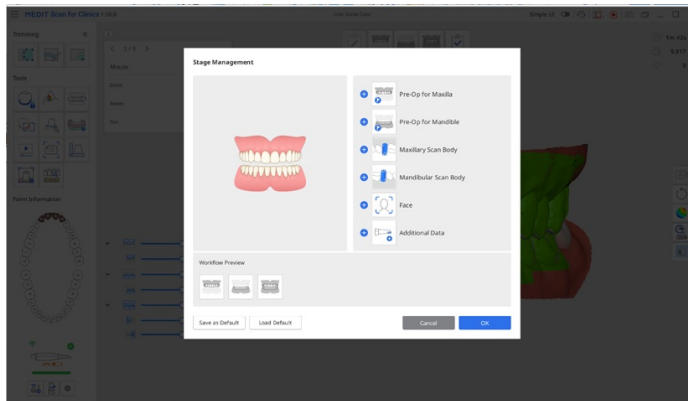


2. Ajoutez les étapes souhaitées de la liste des étapes à l'Aperçu du flux de travail.

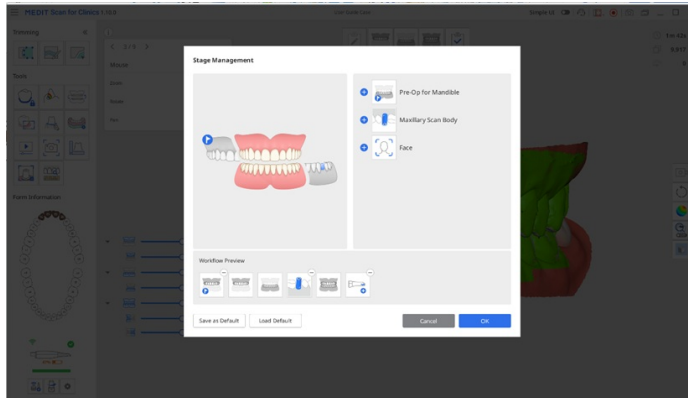


3. Cliquez sur "Enregistrer par défaut" en bas pour enregistrer le flux de travail modifié.

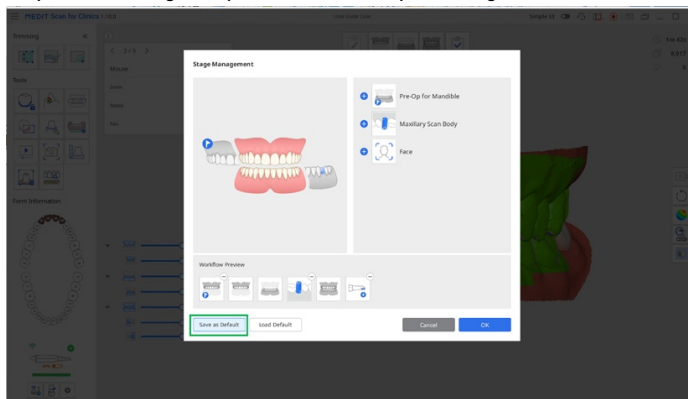

4. Cliquez sur "Confirmer" pour continuer.

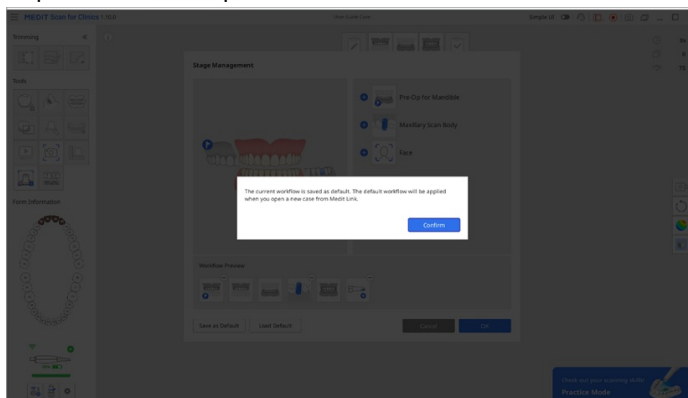

5. Les étapes de numérisation par défaut sont affichées en haut de l'écran lorsque vous ouvrez un nouveau cas.

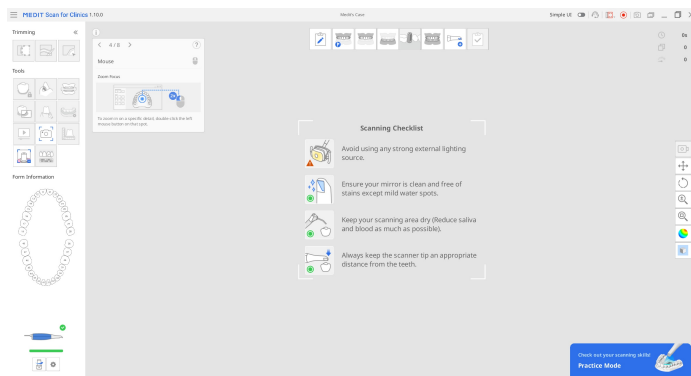

Modification de l'ordre des étapes


Vous pouvez déplacer une icône d'étape à l'endroit souhaité où des barres bleues apparaissent.

Supposons que vous souhaitiez placer une étape Mandibule à la position la plus avancée.


1. Vérifiez les icônes d'étape en haut de l'écran.



2. Cliquez et faites glisser l'icône de l'étape Mandibule. Vous verrez alors apparaître la barre bleue où l'étape de numérisation peut être déplacée.

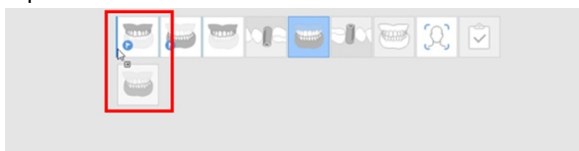

3. Déplacez l'étape de numérisation à l'endroit souhaité.

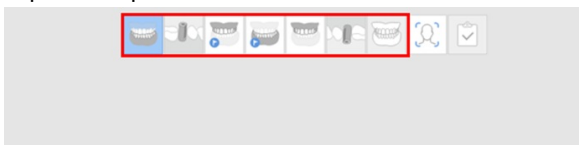


4. Une fois modifiée, le programme continuera à démarrer avec l'ordre modifié à partir de ce moment-là.

iNote

Les étapes Scanbody et Prothèse se déplacent en même temps que l'étape Mandibule/Maxillaire.


Par exemple, si vous faites glisser l'étape Mandibule vers la position la plus à gauche, l'étape Scanbody mandibulaire se déplace de la même manière, comme illustré ci-dessous.

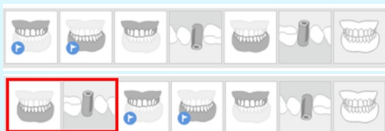

Pré-op pour Maxillaire/Mandibule


Étape pré-op du maxillaire

Acquiert une image 3D pré-op pour le maxillaire.

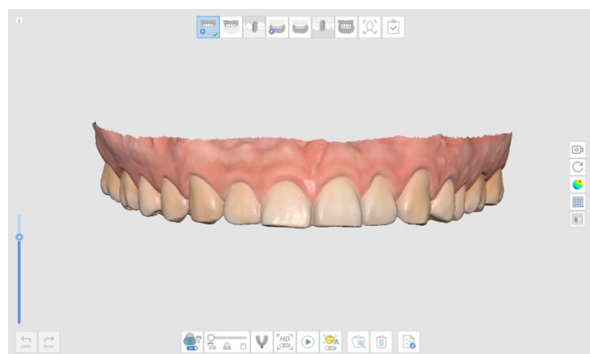

Étape pré-op de la mandibule

Acquiert une image 3D pré-op pour la mandibule.

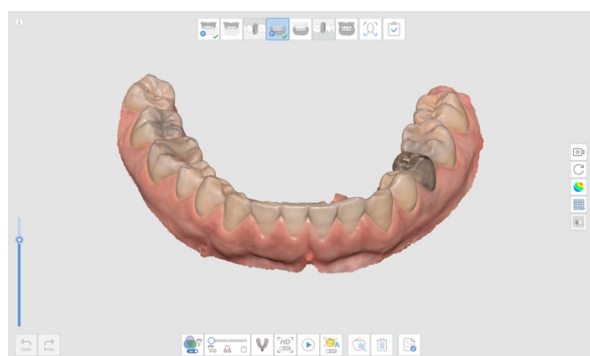

Outil supplémentaire à l'étape Pré-op


Veuillez consulter [Outils de l'étape de numérisation](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des outils qui apparaissent au bas de l'écran pour chaque étape.

	Scan d'empreinte	Permet d'acquérir des données d'empreinte et les aligner avec les données du scanner intra-oral en temps réel.
---	-------------------------	--

Maxillaire/Mandibule


Stade maxillaire

 Réalise une image 3D du maxillaire.

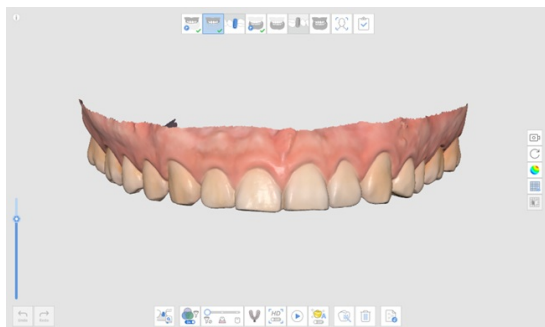

Stade mandibulaire

 Réalise une image 3D de la mandibule.

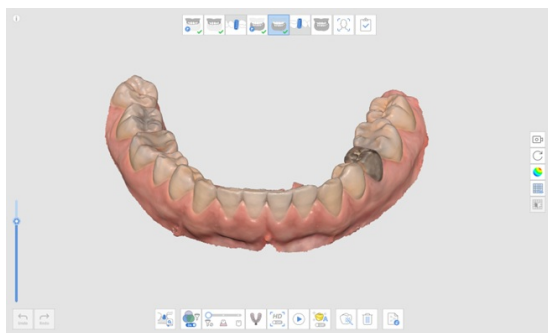

Outils supplémentaires au stade maxillaire/mandibulaire

Veuillez consulter [Outils de l'étape de numérisation](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des outils qui apparaissent au bas de l'écran pour chaque étape.

	Scan d'empreinte	Permet d'acquérir des données d'empreinte et les aligner avec les données du scanner intra-oral en temps réel.
	Correspondance de pilier IA	Gérer des bibliothèques de piliers personnalisés. Les données de la bibliothèque sont automatiquement alignées sur les données de numérisation, ce qui réduit la nécessité de numériser les zones difficiles d'accès. Les données de la bibliothèque peuvent être partagées pour d'autres processus, tels que la conception.
	Révision de la préparation	Permet de vérifier les données de la dent préparée avec le chemin d'insertion et les mesures de distance telles que la profondeur de réduction de la dent, la distance par rapport à l'antagoniste et la distance par rapport à l'adjacente.

Maxillaire/Mandibule édenté


iNote

- L'étape Maxillaire/Mandibule édenté apparaît lorsque la prothèse complète ou la prothèse implanto-portée est enregistrée dans les informations du formulaire sur Medit Link.
- L'étape Maxillaire/Mandibule édenté apparaît à la place de l'étape Maxillaire/Mandibule lorsque vous ajoutez l'étape Prothèse complète dans la Gestion de l'état après avoir lancé Medit Scan for Clinics à partir de l'onglet Arcade sur Medit Link.

Étape maxillaire édenté



Réalise une image 3D du maxillaire édenté.

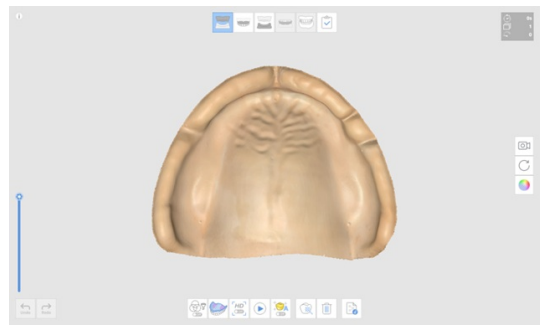

Étape mandibule édentée



Réalise une image 3D de la mandibule édentée.



Outils supplémentaires pour le stade édenté

Veuillez consulter la section Outils de numérisation des étapes pour plus d'informations sur l'utilisation des outils qui apparaissent au bas de l'écran pour chaque étape.

	Scan de la prothèse rebasée	Permet de numériser la surface d'adaptation de la prothèse rebasée, qui sera utilisée comme scan édenté. Cela permet de reproduire l'environnement édenté pour un processus de fabrication optimal de la prothèse.
---	------------------------------------	--

Prothèse Maxillaire/Mandibulaire


iNote

L'étape de Prothèse maxillaire/mandibulaire apparaît lorsque le formulaire est enregistré en tant qu'Arcade sur Medit Link.

Étape de prothèse maxillaire




Réalise une image 3D de la prothèse maxillaire.

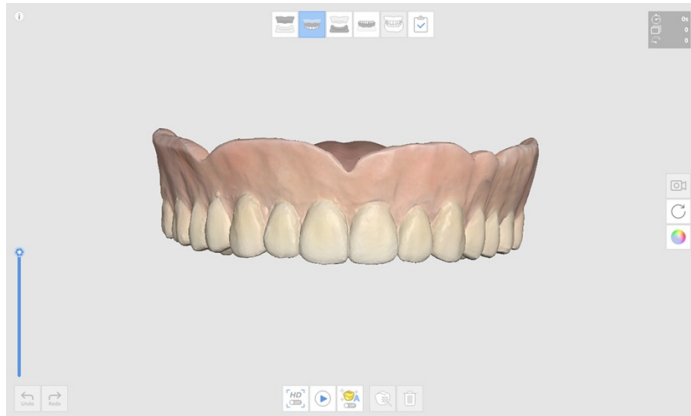

Étape de prothèse mandibulaire




Réalise une image 3D de la prothèse mandibulaire.

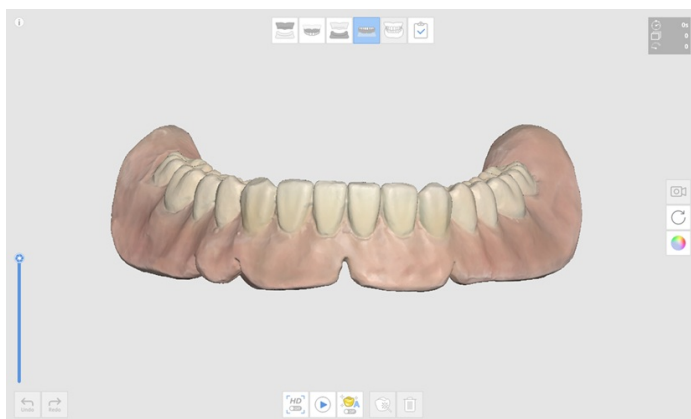

Occlusion

Étape d'occlusion

Acquiert l'image 3D de l'occlusion.

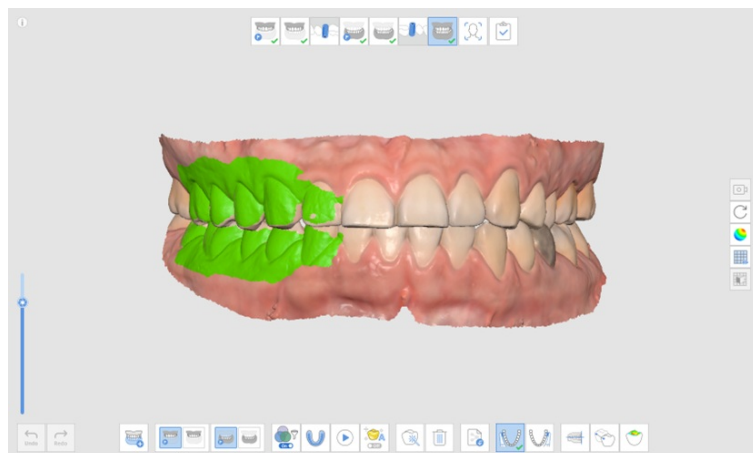

Outils supplémentaires pour l'étape Occlusion

Veuillez consulter [Outils de l'étape de numérisation](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des outils qui apparaissent au bas de l'écran pour chaque étape.

	Multi Occlusion	Reproduit différents types de données de numérisation d'occlusion et d'alignement. Uniquement disponible à l'étape Numérisation de l'occlusion.
	Scan d'empreinte	Permet d'acquérir des données d'empreinte et les aligner avec les données du scanner intra-oral en temps réel.
	Cible d'occlusion pour le maxillaire	Permet de choisir entre les données préopératoires maxillaires et les données maxillaires pour l'alignement de l'occlusion.
	Cible d'occlusion pour la mandibule	Permet de choisir entre les données préopératoires mandibulaires et les données mandibulaires pour l'alignement de l'occlusion.
	Première occlusion	Permet d'acquérir des données de la première numérisation pour l'alignement de l'occlusion.
	Deuxième occlusion	Permet d'acquérir des données de la deuxième numérisation pour l'alignement de l'occlusion. La deuxième occlusion est souvent acquise du côté opposé à la première occlusion.
	Aligner avec le plan occlusal	Déplacer l'emplacement des données sur le plan occlusal compatible avec exocad.
	Alignement manuel	Aligner manuellement les données de numérisation à l'aide de points définis par l'utilisateur.
	Détacher le maxillaire	Détache le maxillaire et la remet en position de pré-alignement.
	Détacher la mandibule	Détache la mandibule et la remet en position de pré-alignement.
	Détacher les données d'occlusion	Détache les données de la première et deuxième occlusion et les ramène à la position de pré-alignement.
	Tout détacher	Détache toutes les données et les ramène à la position de pré-alignement.
	Mouvement mandibulaire	Permet d'enregistrer et de simuler le mouvement mandibulaire réel des patients lors de l'alignement de l'occlusion.


Multi occlusion

La fonction Multi occlusion de l'étape de numérisation de l'occlusion permet de reproduire différentes données de numérisation de l'occlusion et différents alignements. Des modèles d'occlusion multiple peuvent être obtenus chez les patients présentant des mouvements dentaires importants ou irréguliers. Il est également possible de créer et de gérer différentes occlusions dans le cas, telles que la relation centrée pour le patient édenté, l'occlusion ouverte pour la production d'un protège-dents, l'occlusion protrusive pour la production d'appareils contre le ronflement et l'occlusion centrée pour le traitement des patients dans les cliniques.

La boîte de dialogue "Gestion de la Multi occlusion" vous permet d'exécuter les fonctions suivantes :

- Ajouter un groupe d'occlusion
- Supprimer un groupe d'occlusion
- Modifier le nom


Vous pouvez créer jusqu'à 5 groupes d'occlusion et les données de numérisation du groupe d'occlusion sélectionné s'affichent à l'écran. Vous pouvez choisir librement la cible d'occlusion dans chaque groupe.

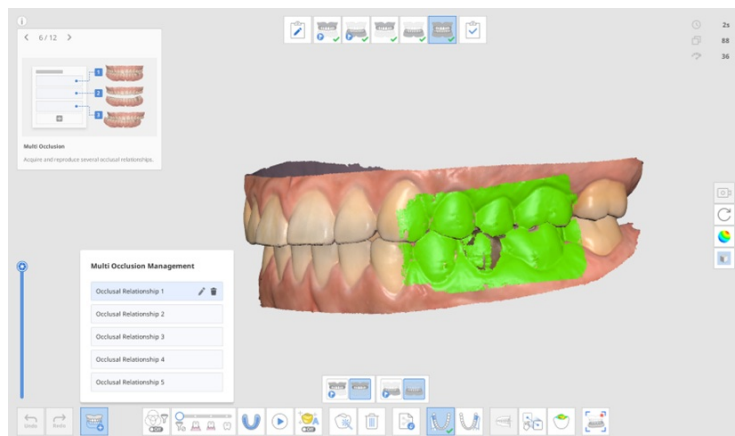

iNote

Étant donné que les données de numérisation du même maxillaire et de la même mandibule sont reproduites en fonction de l'alignement de chaque groupe d'occlusion, cette fonction n'est pas disponible si des données de numérisation d'un maxillaire et d'une mandibule différents sont requises.


1. Acquérir les données maxillaires et mandibulaires dans les étapes Maxillaire et Mandibule.
2. Passez à l'étape Occlusion.

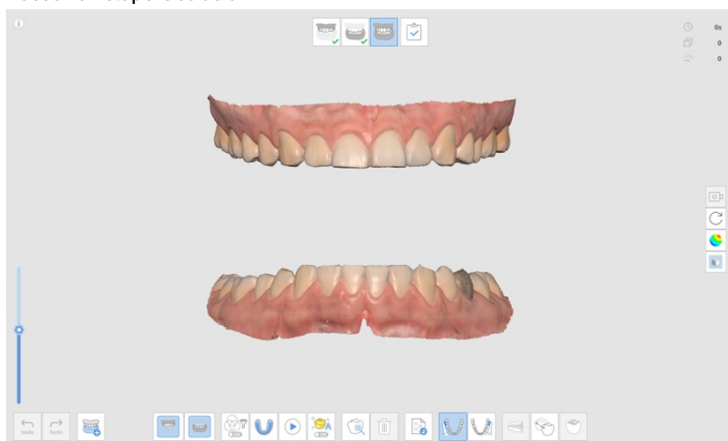


3. Cliquez sur l'icône "Multi occlusion" en bas pour ouvrir le Gestionnaire Multi occlusion.




4. L'étape de numérisation de l'Occlusion existante sera assignée au groupe d'occlusion 1 et bénéficiera d'une assistance pour les fonctions d'ajout et de gestion des groupes d'occlusion.

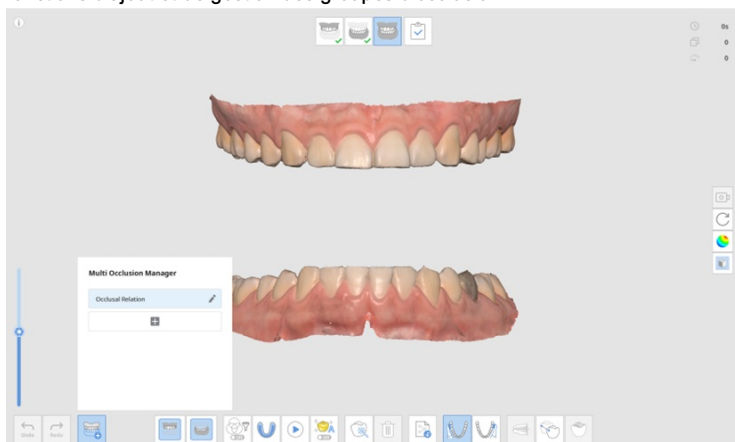


5. Réalisez la première et la deuxième numérisation d'occlusion et alignez les données de numérisation du maxillaire, de la mandibule et de l'occlusion.

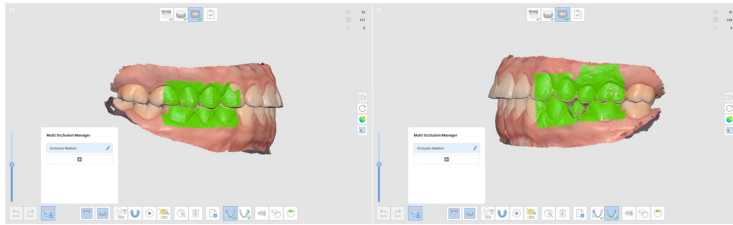


6. Cliquez sur "Ajouter un groupe" pour créer un nouveau groupe d'occlusion.
7. Saisissez la première numérisation d'occlusion après la création du nouveau groupe d'occlusion.

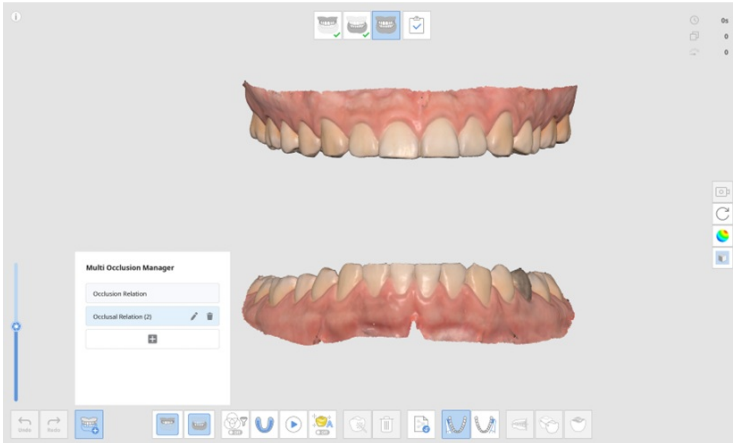


8. Effectuez les nouvelles numérisations d'occlusion et alignez les données de numérisation du maxillaire, de la mandibule et de l'occlusion.

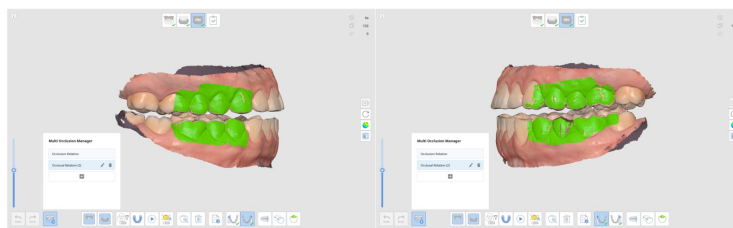

9. Vous pouvez créer jusqu'à 5 groupes d'occlusion.

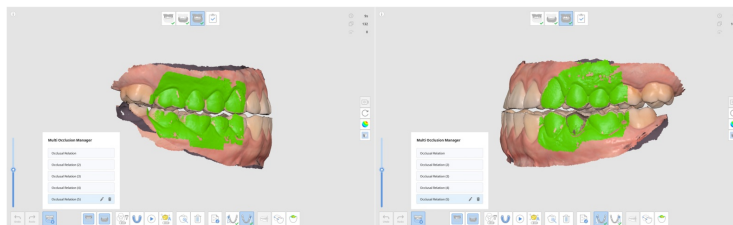

10. En mode "Multi occlusion", vous pouvez créer un nouveau groupe, modifier les noms des groupes créés et supprimer des groupes.

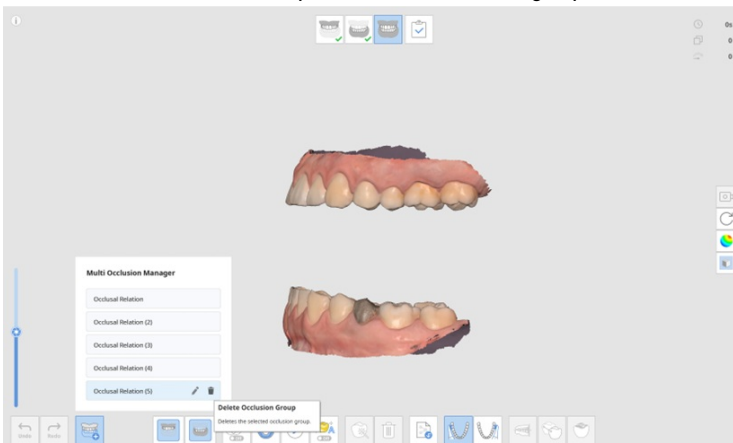


11. Il est possible de vérifier les données de numérisation de divers groupes d'occlusion et l'alignement en utilisant la fonction "Multi occlusion" dans la Vue d'ensemble.



Cible d'occlusion pour maxillaire/mandibule

Vous pouvez sélectionner une cible d'occlusion entre les données pré-opératoires et les données préparées pour le maxillaire et la mandibule.

1. Acquérez les données préopératoires et maxillaires/mandibulaires aux étapes préopératoires pour maxillaire/mandibule et Maxillaire/Mandibule.
2. Passez à l'étape Occlusion. Vous verrez les quatre icônes permettant de sélectionner la cible d'occlusion pour le maxillaire et la mandibule.

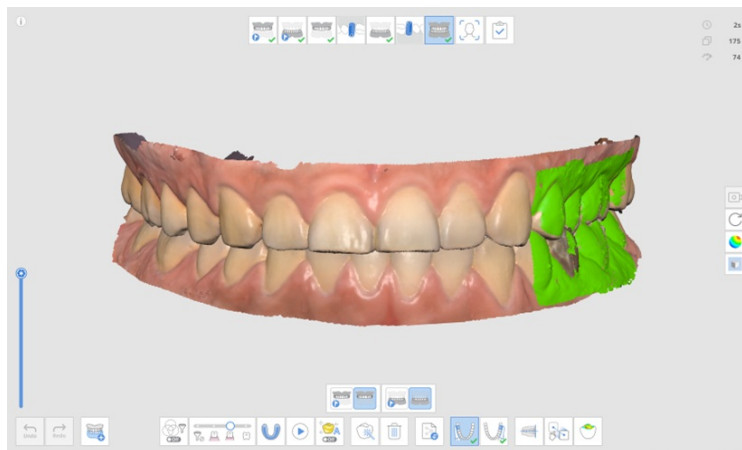

3. Choisissez l'une des quatre paires pour l'alignement occlusal.

Pré-op pour le maxillaire / Pré-op pour la mandibule	 
Pré-op pour maxillaire/mandibule	 
Maxillaire / Pré-op pour la mandibule	 
Maxillaire/Mandibule	 

Aligner avec le plan occlusal


Vous pouvez ajuster la position des données numérisées sur le plan occlusal dans Medit Scan for Clinics et la rendre compatible avec l'articulateur virtuel dans Exocad.

Les outils suivants sont fournis pour la fonction Aligner sur le plan occlusal.


	Aligner avec le plan d'occlusion de trois points	Sélectionnez trois points sur le maxillaire ou la mandibule à aligner sur le plan occlusal.
	Aligner avec le plan occlusal par quatre points	Sélectionnez quatre points sur le maxillaire ou la mandibule à aligner sur le plan occlusal. Avantageux lorsqu'il n'y a pas de dents antérieures.

	Supprimer point de marquage	Supprime les points sélectionnés pour l'alignement.
	Détacher les données	Sépare les données alignées et les ramène à leur position originelle.
	Multi-vue	Les données numérisées en 3D peuvent être visualisées de quatre côtés.
	Quitter	Ramène l'utilisateur à l'étape précédente.


1. Cliquez sur "Aligner avec le plan occlusal" une fois l'alignement de l'occlusion terminé.

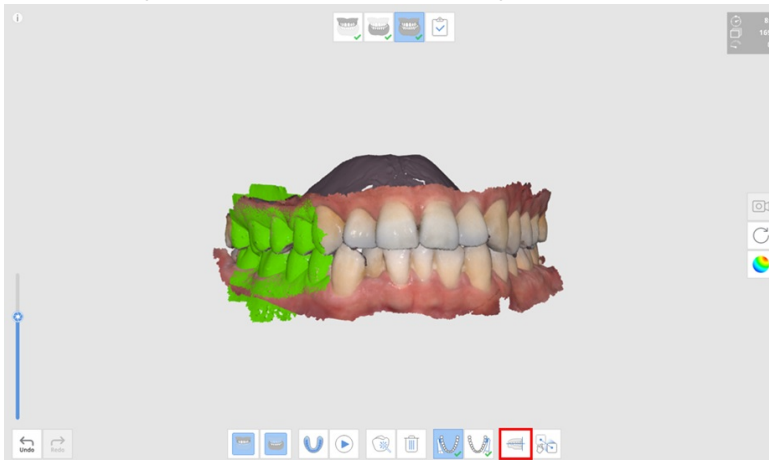


2. Sélectionnez trois ou quatre points sur le maxillaire ou la mandibule. S'il n'y a pas de dents antérieures, sélectionnez quatre points sur les dents correspondantes des deux côtés.

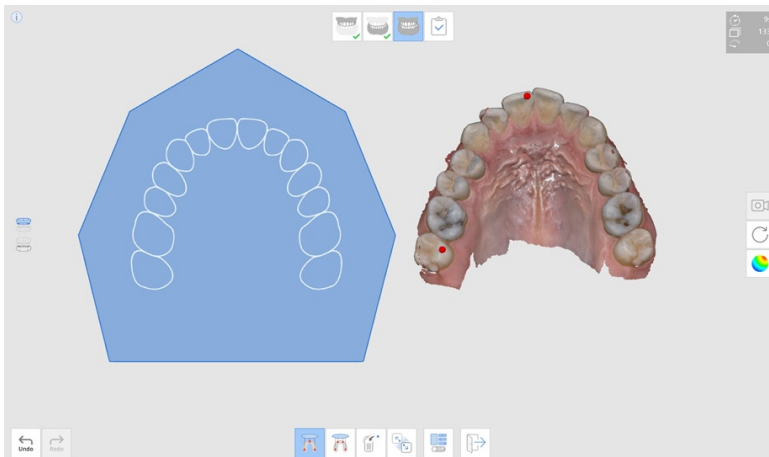


3. Déplacez les données de l'arcade sur le côté droit pour ajuster la position sur le plan occlusal. L'utilisateur peut l'ajuster sous différents angles.

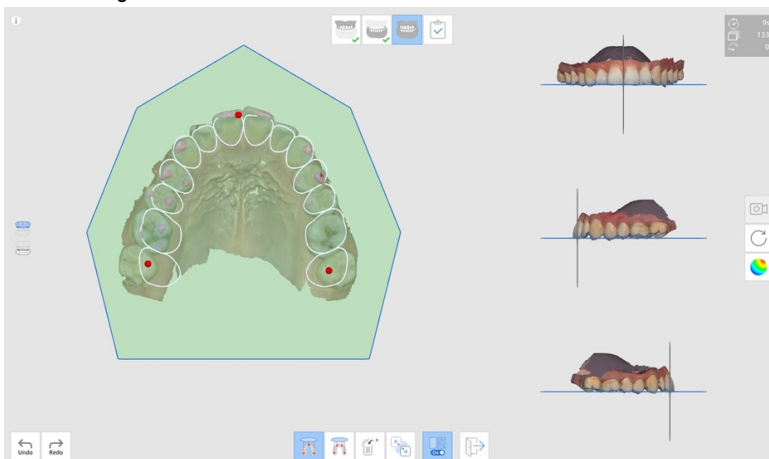


4. Sélectionnez le maxillaire, la mandibule ou les deux en utilisant les boutons à gauche. Cela permet à l'utilisateur de voir les données de numérisation du maxillaire et de la mandibule individuellement ou ensemble.

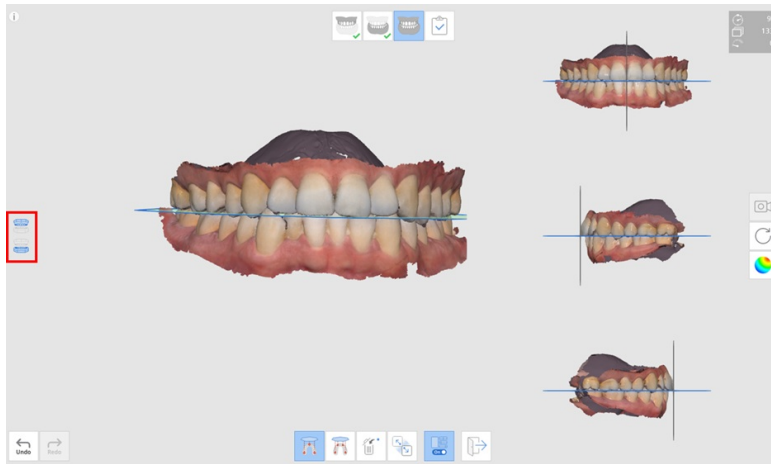

5. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Multi-vue.

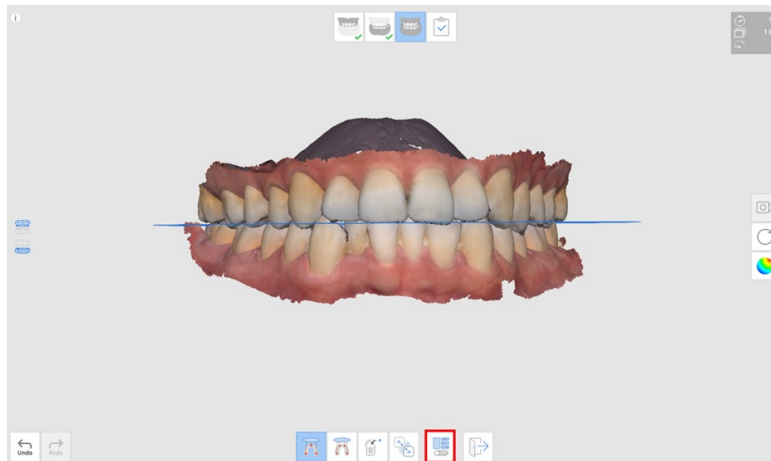


6. Lorsque les données sont chargées à partir d'exocad après l'achèvement, les données de numérisation seront positionnées au même endroit que l'articulateur virtuel.

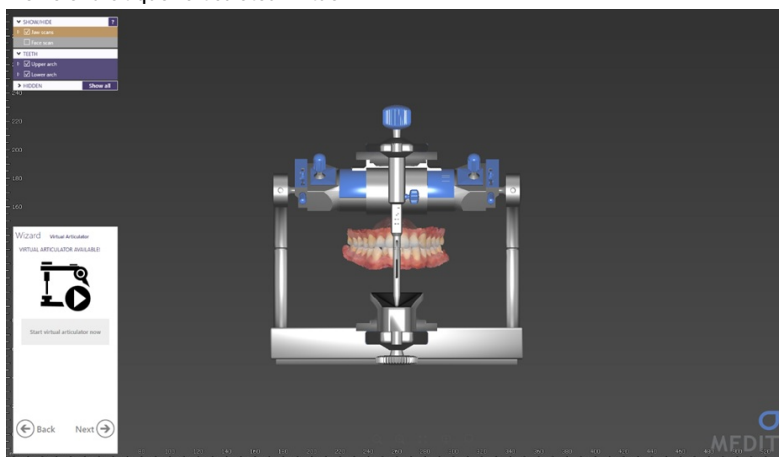

Mouvement mandibulaire

Pour diagnostiquer les patients à l'aide des données scannées acquises, établir des plans de traitement et fabriquer des prothèses et des appareils dentaires, la mandibule et le maxillaire doivent être alignés l'un par rapport à l'autre. Nous avons aidé nos utilisateurs à aligner les cibles d'occlusion mandibulaire et maxillaire sur la base des données de la première et de la deuxième occlusion pour montrer les relations de position. Cependant, elle ne donne que la position du maxillaire et de la mandibule lorsqu'ils restent immobiles, sans aucun mouvement.

Nous devons prendre en compte non seulement l'occlusion centrale mais aussi les mouvements mandibulaires du patient causés par les mouvements de l'ATM pour fabriquer des prothèses et des dispositifs plus précis. Grâce à cette fonction de Mouvement mandibulaire, vous pouvez enregistrer les mouvements réels de la mandibule à partir des données maxillaires et utiliser les données de simulation pour la fabrication de prothèses.

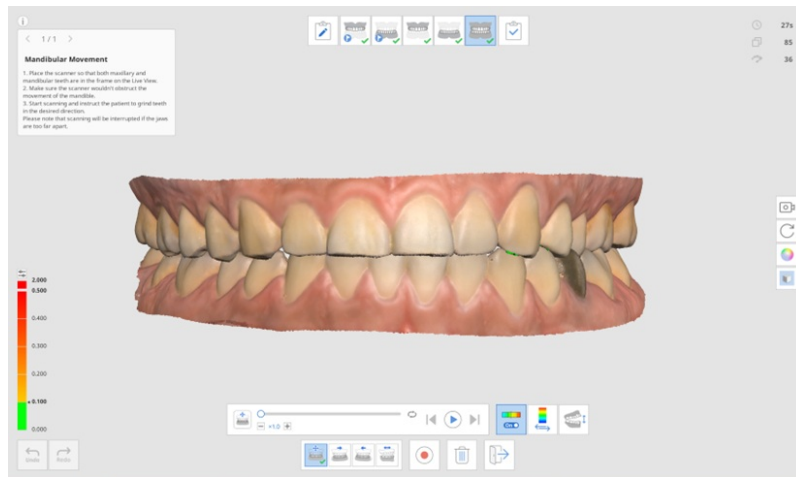


Vous pouvez enregistrer les mouvements suivants :


- Mouvement libre
- Mouvement latéral gauche
- Mouvement latéral droit
- Mouvement protrusif

Après l'enregistrement de chaque mouvement, le mouvement mandibulaire peut être reproduit par simulation. La carte des couleurs permet de reconnaître facilement la zone d'interférence de la mandibule et du maxillaire.


1. Acquérez les données maxillaires et mandibulaires dans les étapes Maxillaire et Mandibule.

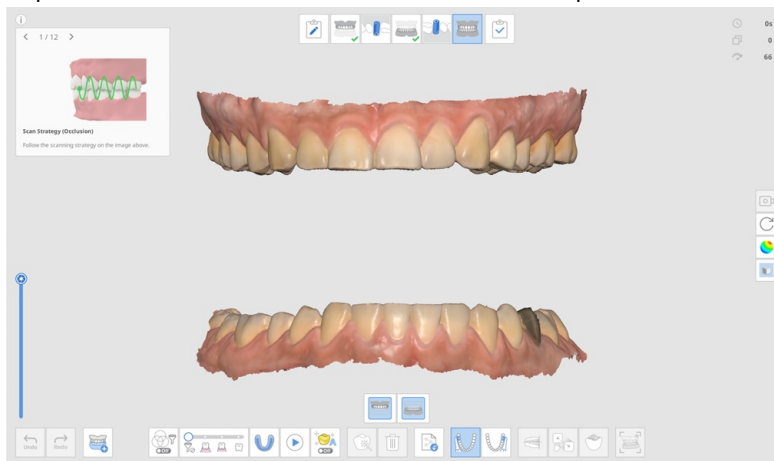


2. Acquérez les données du premier (et du deuxième) scan d'occlusion dans l'étape Occlusion et procéder à l'alignement.

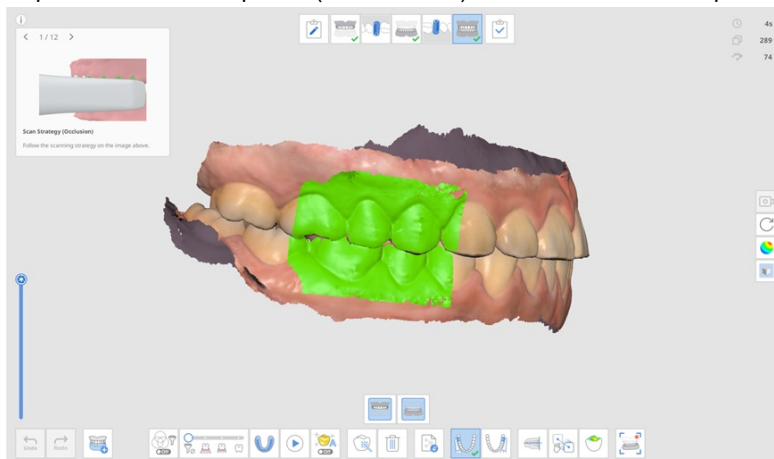


3. Cliquez sur l'icône "Mouvement mandibulaire" en bas lorsqu'elle est activée.

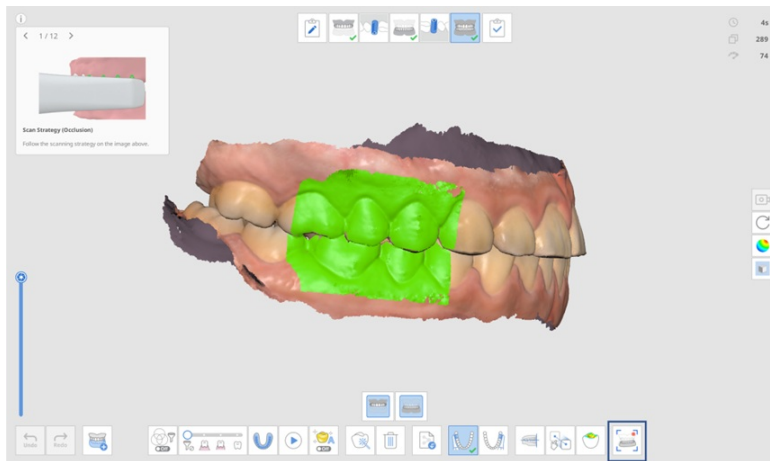


4. Sélectionnez l'icône de la direction de mouvement souhaitée en bas de la page parmi les options suivantes : Libre, Latéral droit, Latéral gauche et Protrusif.

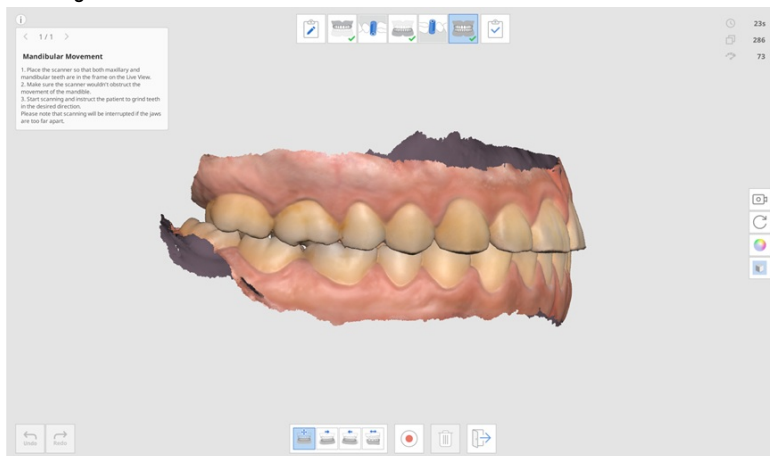


5. Placez l'embout du scanner à la jonction du maxillaire et de la mandibule pendant que le patient maintient le contact entre les mâchoires.

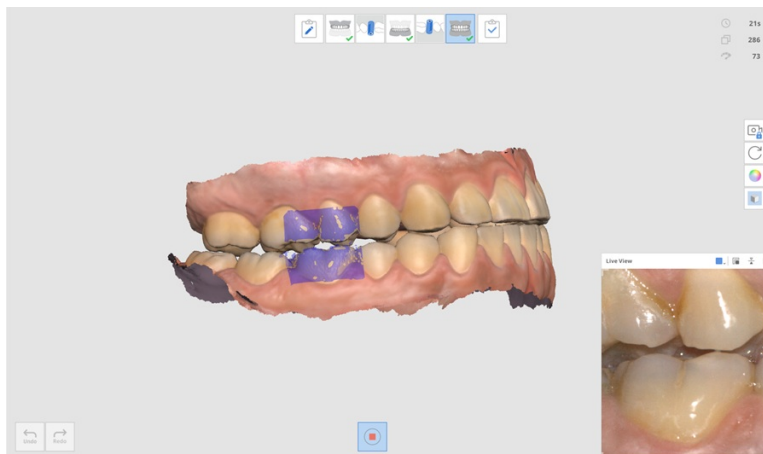


6. La fenêtre Live View apparaît à l'écran lorsque le scanner commence à enregistrer. Demandez ensuite au patient de déplacer la mandibule selon la direction de mouvement sélectionnée. Vérifiez que les dents mandibulaires et maxillaires apparaissent sur la Vue en direct. La numérisation sera interrompue si les mâchoires sont trop écartées et que le mouvement n'est plus visible à l'écran.
7. La barre de lecture et les icônes concernant la simulation du mouvement mandibulaire apparaissent à l'écran une fois l'enregistrement terminé. Vous pouvez lire l'enregistrement du mouvement en cliquant sur le bouton Démarrer. Vous pouvez également ajuster la vitesse du mouvement ou activer la répétition.

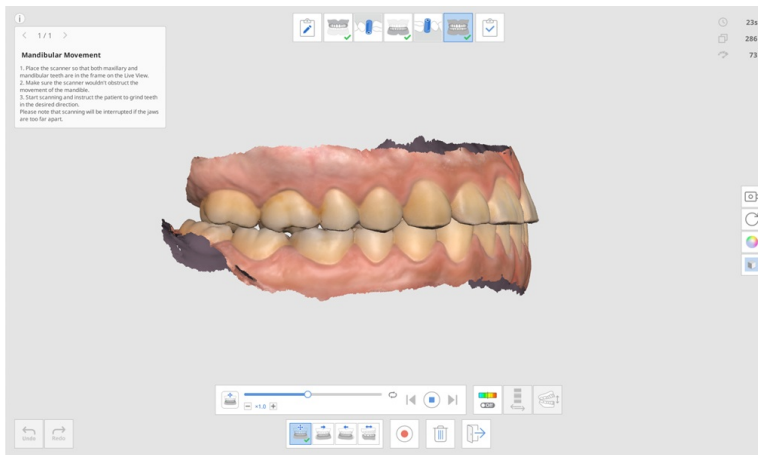


8. Cliquez sur l'icône Écart activé/désactivé pour afficher ou masquer les zones d'interférence lorsque la mandibule se déplace. L'analyse pour représenter les couleurs peut prendre un certain temps.

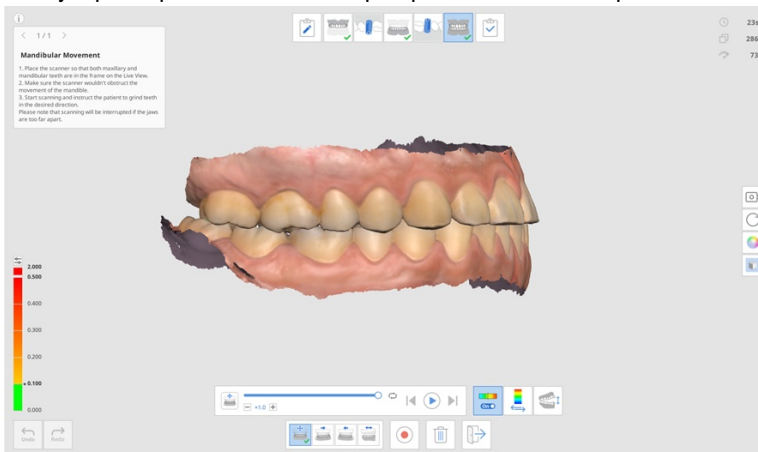

9. Cliquez sur "Changer la zone d'affichage de la déviation" pour afficher l'échelle pour toutes les données ou pour les zones de contact uniquement.

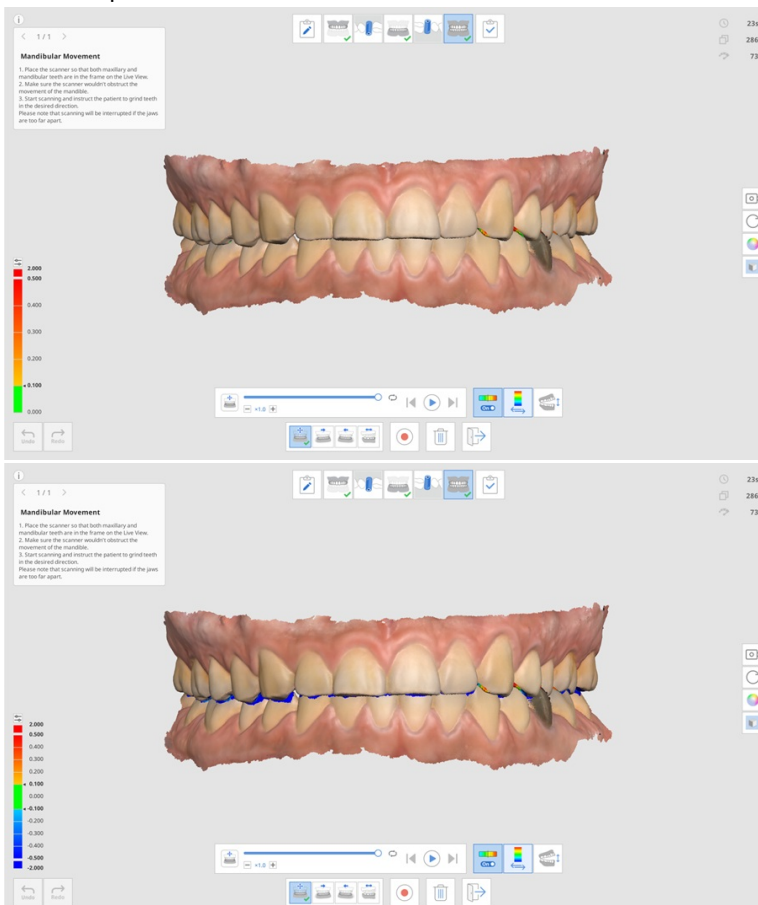

10. Cliquez sur le bouton "Changer la vue" pour changer le style de vue entre mâchoires ouvertes et mâchoires fermées.

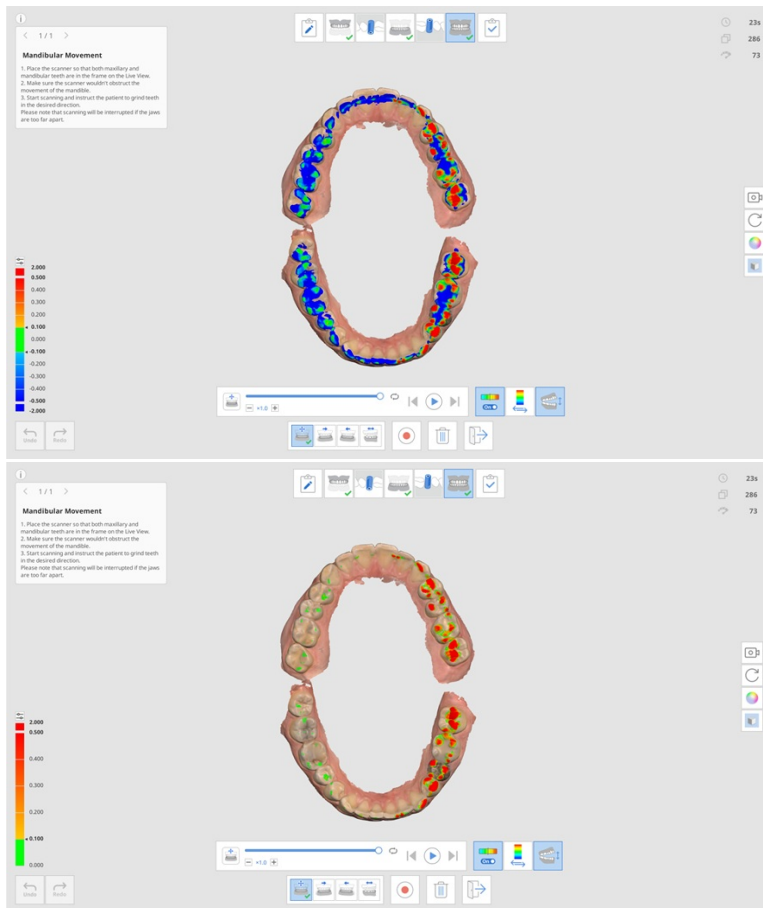


11. Cliquez sur Quitter pour revenir à l'étape Occlusion, et l'enregistrement du mouvement mandibulaire sera ajouté à l'arborescence des données dans Medit Link.

Visage

Étape visage

 **Mise en garde**
Les scans du visage ne peuvent pas être utilisés à des fins médicales telles que la simulation, le diagnostic ou le traitement et ne doivent servir que de référence pour la fabrication de prothèses en laboratoire.

 **Acquérir les données de numérisation des dents, de la bouche, du nez, etc.**

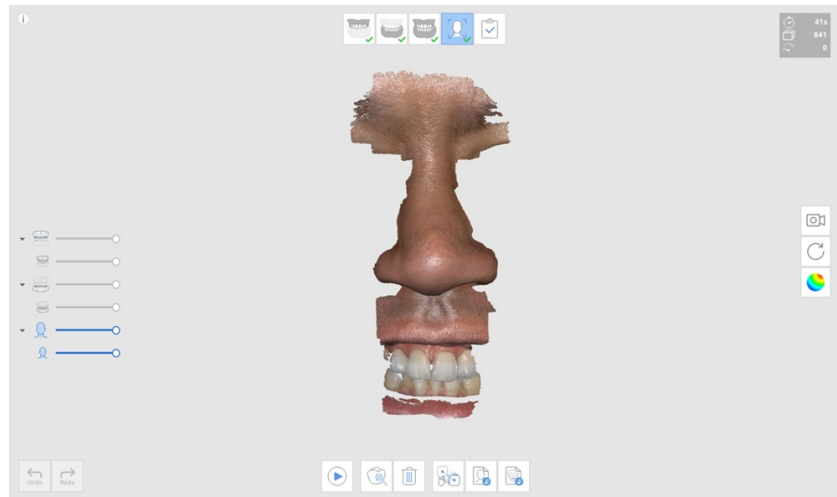

Outils supplémentaires pour l'étape Visage

Veuillez consulter [Outils de l'étape de numérisation](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des outils qui apparaissent au bas de l'écran pour chaque étape.

	Aligner les données de visage	Sélectionner les données et les points de prélèvement sur chacun d'entre eux pour l'alignement.
	Importer des données de visage 3D	Importer des données de visage à partir d'une source externe.
	Importer des données osseuses 3D	Importe les données de visage 3D du tomodensitogramme. Le fichier DICOM n'est pas pris en charge.

Données supplémentaires


Étape des données supplémentaires




Permet d'acquérir toutes les données supplémentaires dont vous avez besoin pour le cas. Vous pouvez numériser les restaurations existantes des patients, les restaurations provisoires, etc.

Vous pouvez numériser la surface extérieure de la prothèse existante du patient ou de la prothèse temporaire pour le cas.


1. Ajouter l'étape Données supplémentaires depuis Gestion de l'état.

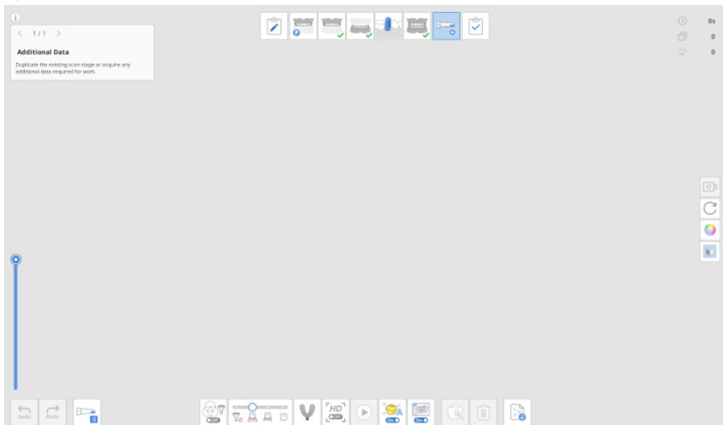


2. Cliquez sur l'icône "Gestion des données supplémentaires" en bas. Vous pouvez ajouter de nouvelles données et supprimer ou renommer des données supplémentaires de la liste dans la boîte de dialogue Gestion des données supplémentaires.

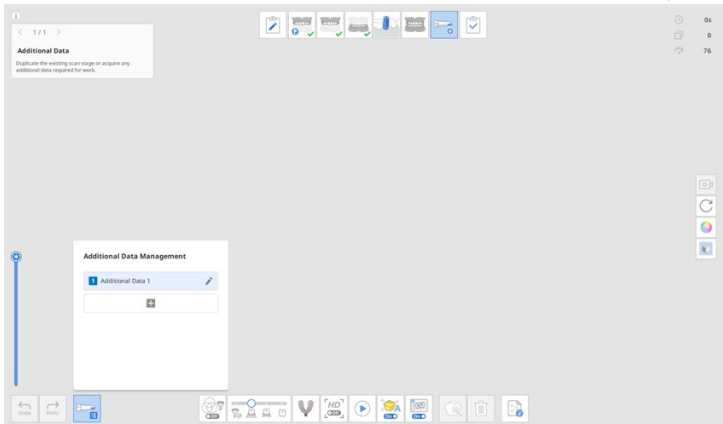


3. Acquérir les premières données supplémentaires.

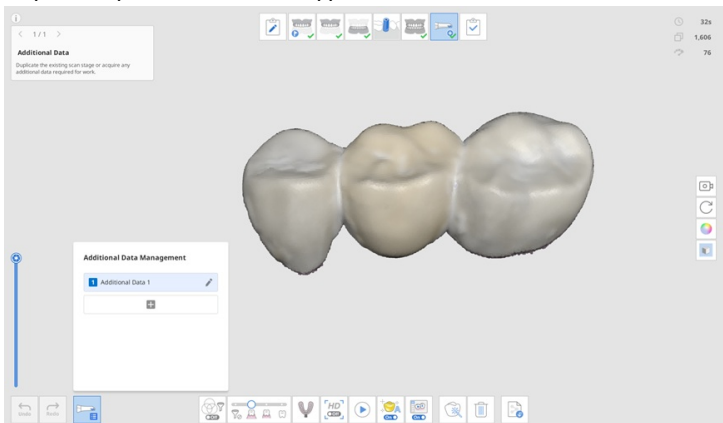


4. Cliquez sur le bouton "+" dans la boîte de dialogue Gestion des données supplémentaires et acquérez d'autres données de numérisation pour la donnée ajoutée.

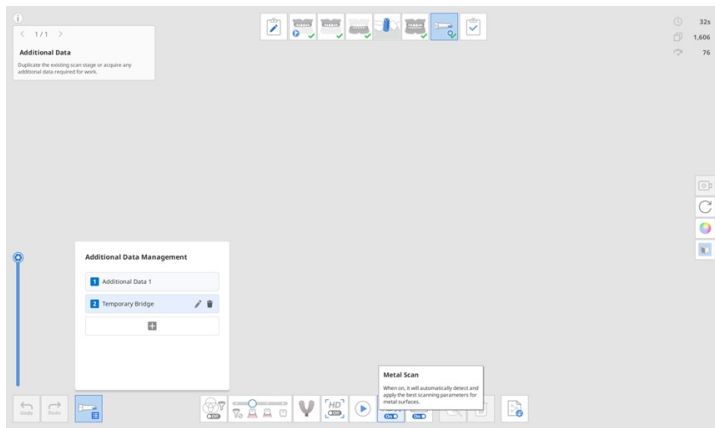

5. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept données supplémentaires. Vous pouvez également supprimer ou renommer les données supplémentaires existantes dans la liste.

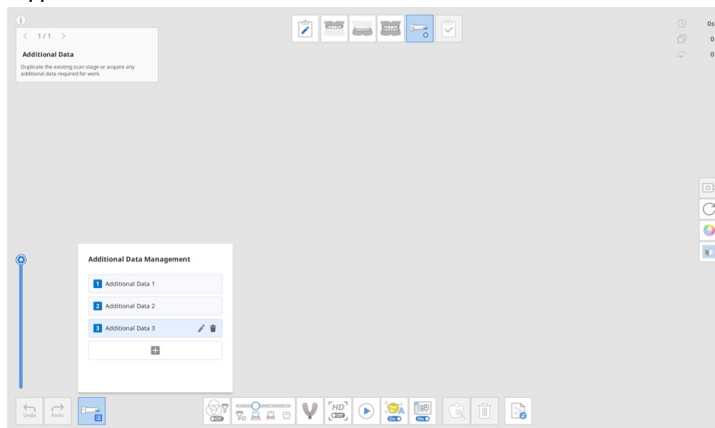

6. Vous pouvez vérifier les données supplémentaires ajoutées dans l'arborescence des données de la Vue d'ensemble.

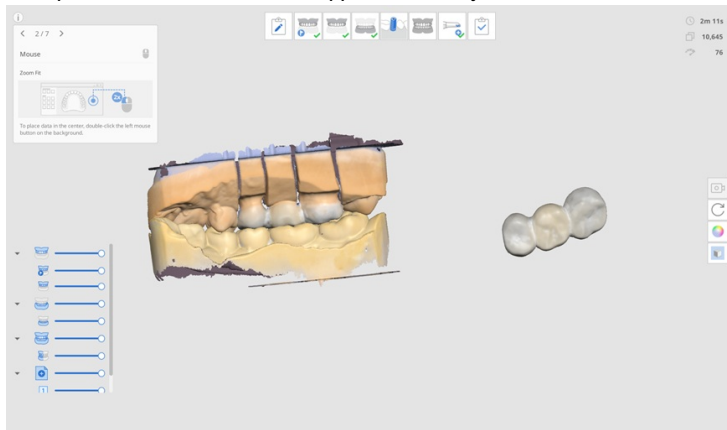

Terminer

Étape Terminer

Termine la numérisation et génère les données de résultat.

Lorsque vous cliquez sur l'icône de l'étape Terminer, la boîte de dialogue suivante apparaît pour sélectionner le mode de traitement des données.

Data processing will start.

Please check the following conditions before the data processing starts.

- All required scan stages are complete. [View More](#)
- There was no missing data while scanning the important and necessary areas. [View More](#)
- There was enough reliable data shown on the Reliability Map. [View More](#)
- Unnecessary soft tissues have been properly removed. [View More](#)

Please select the options.

Cancel

Sélectionnez l'une des options suivantes.

	Traiter les données (en l'état)	Créez des modèles numériques 3D optimisés. Le bruit sera partiellement supprimé, et les zones où les données sont insuffisantes resteront sous forme d'espaces vides. Vous pouvez ajuster la taille du fichier et l'irrégularité de la surface dans les paramètres si nécessaire.
	Remplir trous principaux	Cette option permet de combler tous les trous principaux dans les données de numérisation. Selon la carte de fiabilité, elle génère des données pour les zones où les données n'ont pas été acquises en prolongeant les données avec une fiabilité suffisante.
	Créer un modèle imprimable 3D	Cette option permet de créer un modèle pour l'impression 3D. Elle étend la limite la plus large pour ajouter de l'épaisseur afin de produire un modèle avec un fond plat pour l'impression 3D. Vous pouvez ajuster la taille du fichier et l'irrégularité de la surface dans les paramètres si nécessaire.
	Créer un modèle de copie de prothèse	Cette option permet de créer un modèle optimisé pour une copie de prothèse en 3D. Le bruit sera partiellement supprimé et les zones pour lesquelles les données sont insuffisantes resteront sous forme d'espaces vides. Vous pouvez ajuster la taille du fichier et l'irrégularité de la surface dans les paramètres si nécessaire.

Si vous sélectionnez l'option "Créer un modèle imprimable en 3D", la boîte de dialogue suivante s'affiche.

Create Model Base

☒ Total Height

☐ Minimum Base Height

☒ Hollow Model

Minimum Wall Thickness

30

mm

3

mm

Cancel


Default

Confirm

Veuillez consulter le tableau et l'image suivants et saisir la valeur de la hauteur et de l'épaisseur.


Hauteur totale	Hauteur totale du modèle, y compris la base
Hauteur de base minimale	Hauteur minimale entre la base du socle et le point le plus bas du modèle
Épaisseur minimale de la paroi	Épaisseur minimale de la paroi interne du modèle

53

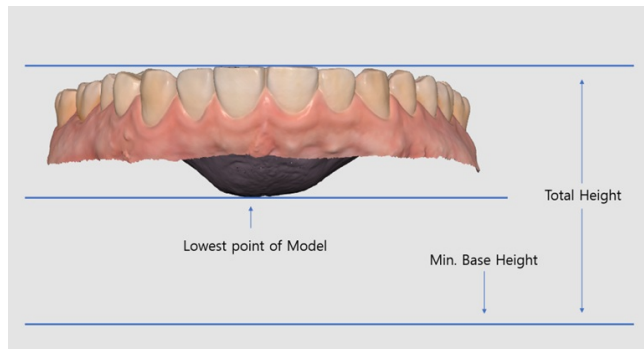

Outils de l'étape de numérisation

Les outils suivants sont fournis en bas de chaque étape numérisation.




Outils de numérisation de base

	Démarrer	Démarrer la numérisation. L'utilisateur peut également lancer la numérisation en appuyant sur le bouton Scan du scanner.
	Stop	Arrêter la numérisation. L'utilisateur peut également arrêter la numérisation en appuyant sur le bouton Scan du scanner.
	Optimiser	Permet d'aligner les images 3D pour une numérisation plus précise. Tous les bruits seront supprimés après l'optimisation.
	Scan haute résolution	Permet d'obtenir un scan haute résolution pour la totalité ou une partie des données de numérisation. Les données de numérisation à haute résolution et à résolution standard sont harmonieusement fusionnées lors du post-traitement. * non disponible avec i600
	Scan métal	Détecte automatiquement le métal pendant la numérisation et applique les paramètres pour les surfaces métalliques. * Désactiver cette option lors de la numérisation d'un modèle dentiforme en plâtre sans surface métallique.
	Importer les données de numérisation	Importer les données 3D depuis Medit Link.
	Supprimer	Supprime les données de numérisation de l'étape en cours. Toutes les données relatives à l'étape en cours peuvent être supprimées.
	Défaire	Annuler le scan précédent.
	Refaire	Rétablit le scan annulé.

Scan haute résolution

* non disponible avec i600

Veillez consulter la comparaison suivante entre les données de numérisation à haute résolution et à résolution standard,

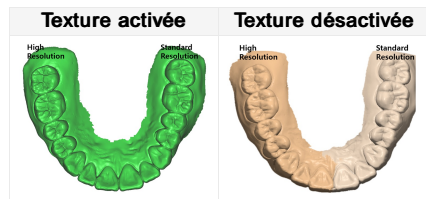


Scan métal

1. Cliquez sur l'icône "Scan métal" avant de commencer à numériser ou pendant la numérisation.



2. Si une prothèse métallique, telle qu'une couronne, occupe plus d'une certaine zone de numérisation, il modifie automatiquement les paramètres de numérisation pour faciliter la numérisation du métal.

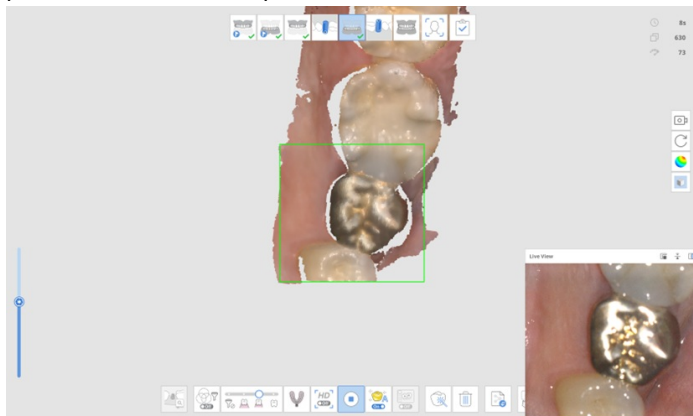


Importer les données de numérisation

Cette fonction permet aux utilisateurs d'importer des données de numérisation acquises par des scanners tiers. Vous pouvez modifier les données ou effectuer une numérisation supplémentaire avec les données importées.


iNote

- Vous pouvez importer un fichier précédemment numérisé à partir d'un dossier dans Medit Link
- Lors de l'importation d'un fichier de numérisation tiers, veillez à le joindre à un dossier dans Medit Link avant de poursuivre.
- Vous pouvez importer un fichier avant de lancer le processus de numérisation ou de passer à l'étape suivante.


1. Cliquez sur l'icône "Importer les données de numérisation".

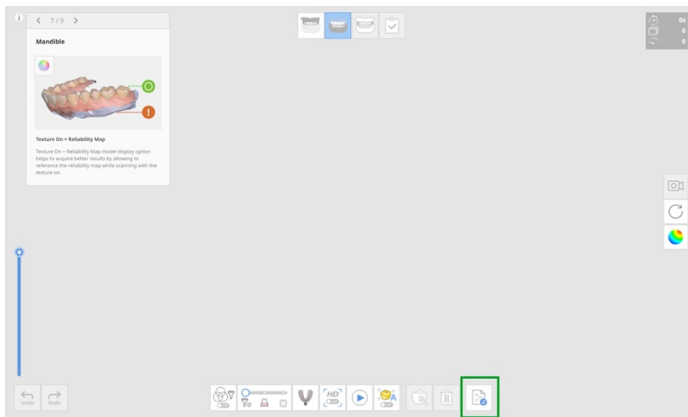


2. Choisissez un fichier à partir d'un cas Medit Link.

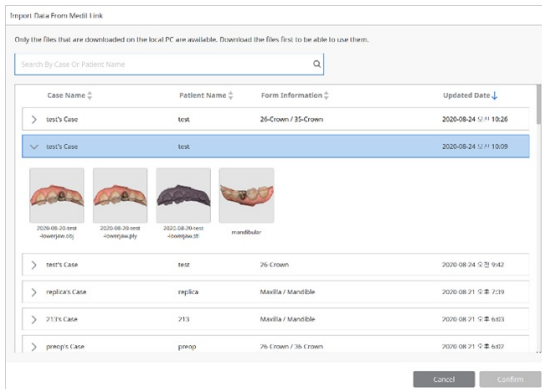

3. Découper la partie nécessitant une nouvelle numérisation.

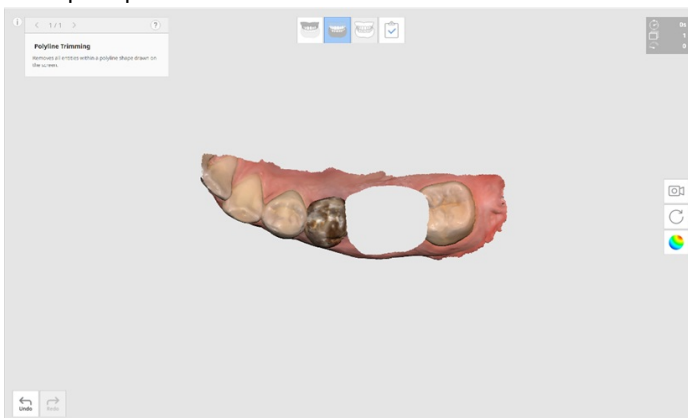

4. Effectuez une numérisation supplémentaire.

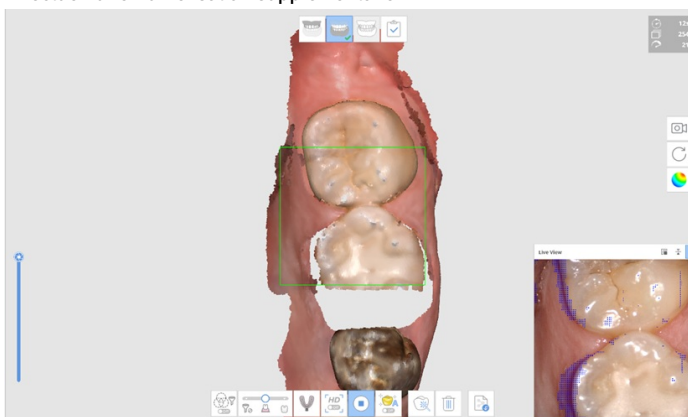

Outils de filtrage

	Filtrage de scan intelligent	Filtre les données inutiles des tissus mous lors de la numérisation. Trois filtres sont disponibles pour le Filtrage de scan intelligent. • Pas de filtrage • Dents + gencive • Dents + gencives intenses • Dents
---	-------------------------------------	---

	Filtrage de couleurs intelligent	Filtre des couleurs spécifiques pour éviter qu'elles ne soient numérisées. Vous pouvez ajouter et gérer les couleurs à filtrer.
	Couture intelligente	Permet d'acquérir et d'aligner des données de numérisation librement, quelle que soit votre stratégie de numérisation. Les données sont automatiquement alignées pendant la numérisation et peuvent être alignées manuellement après l'arrêt de la numérisation.

Filtrage de scan intelligent

Cette fonction permet de supprimer les données inutiles des tissus mous lors de la numérisation, en fonction du filtre sélectionné. Trois filtres sont disponibles pour vous faciliter la tâche.

	Pas de filtrage	Les tissus mous restent intacts. Cette option est utile pour les cas d'arcades édentées ou de modèles en plâtre.
	Dents + gencive	Permet de retirer les tissus mous qui gênent la numérisation, en ne laissant que les dents et la gencive nécessaires. Vous pouvez utiliser cette option pour la plupart des cas de numérisation générale.
	Dents + gencives intenses	Permet de retirer les tissus mous qui gênent la numérisation, en ne laissant que les dents et la gencive nécessaires. Cette option ne permet d'acquérir que les données relatives à la gencive à une certaine distance de la dent et exclut les autres tissus mous situés à l'écart des dents.
	Dents	Retirer tous les tissus mous et la gencive, en ne laissant que les dents. Cette option est utile pour numériser uniquement les dents en tant que numérisation supplémentaire après avoir utilisé le filtre "Dents + gencive" pour la numérisation initiale.

Filtrage de couleurs intelligent

L'option "Filtrage de couleurs intelligent" empêche la numérisation de matériaux étrangers (par exemple, des gants, etc.) dans l'environnement intrabuccal en enregistrant leurs couleurs. Une fois que les couleurs sont enregistrées et que l'option est activée, les couleurs sont automatiquement filtrées pendant le processus de numérisation.


1. Activez le filtrage en cliquant sur l'option "Filtrage de couleurs intelligent" en bas de page.




2. Pour enregistrer une nouvelle couleur, cliquez sur l'icône "Ajouter une couleur".




3. La boîte de dialogue Filtrage de couleurs intelligent s'affiche.

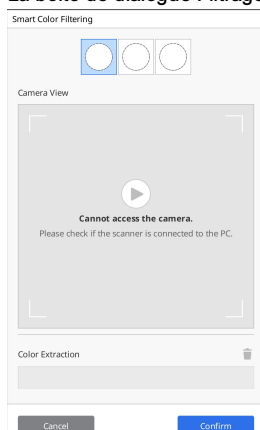

4. Préparez le matériel à filtrer. Ensuite, appuyez sur le bouton Scan du scanner pour lancer le processus de reconnaissance des couleurs.

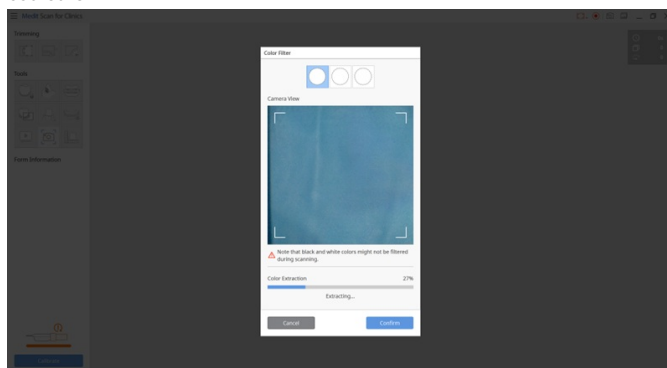

5. Cliquez sur "Confirmer" pour enregistrer la couleur et terminer l'enregistrement de la couleur.
6. Vous pouvez activer ou désactiver chaque filtre de couleur en cliquant sur les icônes de couleur.



7. Les couleurs enregistrées seront affichées sur l'icône et sauvegardées pour toutes les étapes de la numérisation, à moins que vous ne les changiez.



Couture intelligente

iNote

- La Couture intelligente n'est prise en charge que pour les étapes Pré-op pour le maxillaire, Pré-op pour la mandibule, le maxillaire et la mandibule.
- La fonction Couture intelligente n'est pas disponible pour les outils de Correspondance de pilier IA Scan d'empreinte et Scan de la prothèse rebasée.
- Vous ne pouvez pas utiliser la Couture intelligente après avoir utilisé les fonctions Correspondance de pilier IA, Correspondance scanbody IA ou après l'alignement de l'occlusion.


Pour la numérisation 3D à l'aide de la méthode d'enregistrement vidéo, il est important de numériser en continu afin que la caméra ne perde pas la mise au point pendant le processus d'acquisition des données de numérisation.

Ce processus dépend fortement de l'habileté de l'utilisateur et de l'état de la bouche du patient, mais la méthode de numérisation par Couture intelligente peut éliminer cet inconvénient.


1. Activez l'icône "Couture intelligente" en bas.




2. Commencez la numérisation à l'étape qui prend en charge la Couture intelligente, Pré-op.

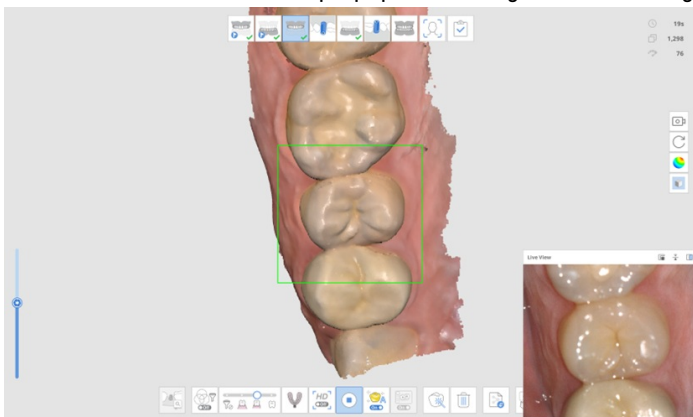


3. Lorsque le scanner est placé dans une zone non contiguë aux données de numérisation en cours d'acquisition, de nouvelles données de numérisation sont acquises. Les données précédemment numérisées s'affichent alors sous la forme d'une vignette dans le coin inférieur gauche.

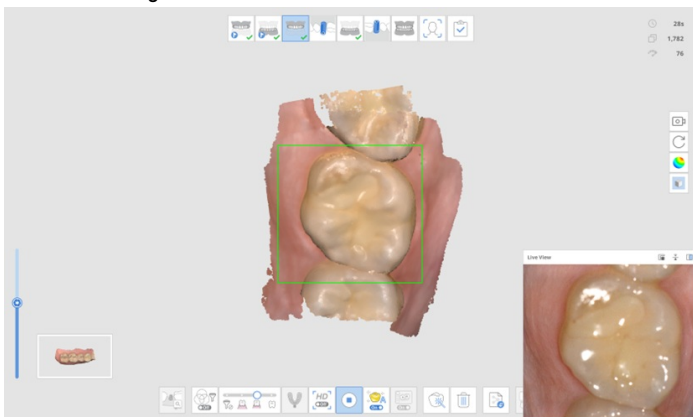



4. Dans le coin gauche de l'écran, vous pouvez afficher jusqu'à cinq vignettes des données de numérisation précédentes.

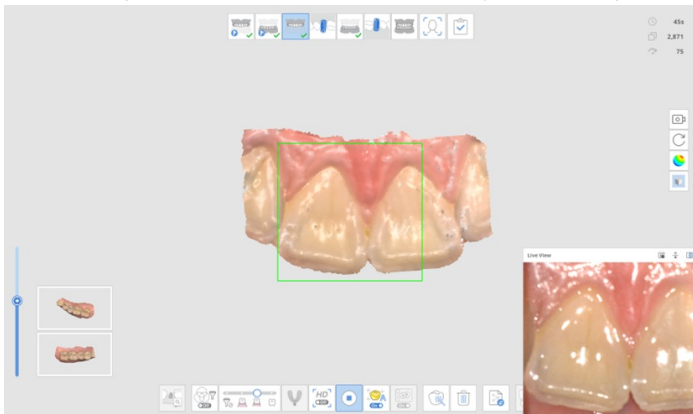


- Vous pouvez cliquer sur chaque vignette pour visualiser les données au centre de la zone d'affichage des données, et les données précédemment affichées sont ajoutées aux vignettes.

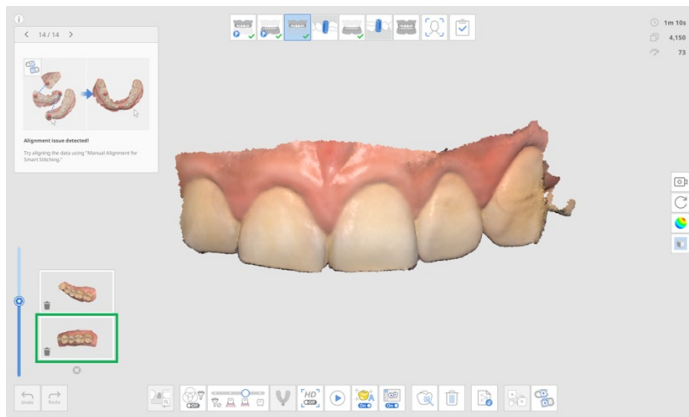


- Vous pouvez cliquer sur l'icône de la corbeille sur chaque vignette pour supprimer chacune d'entre elles ou sur le bouton "x" au bas de la liste des vignettes pour supprimer toutes les vignettes.

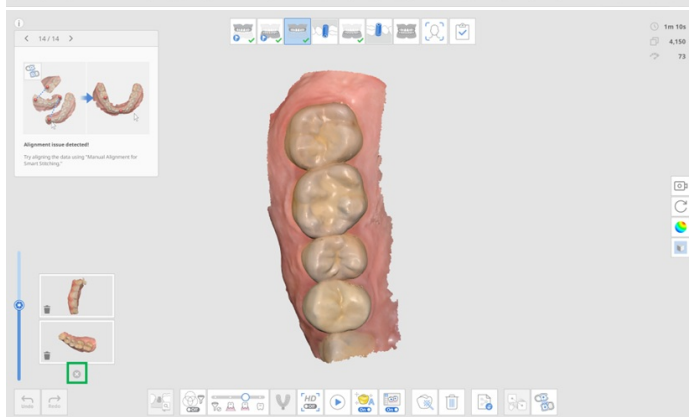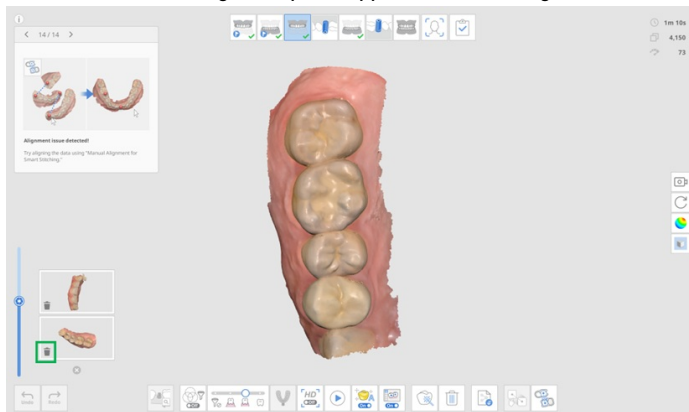


5. Pendant la numérisation, si le scanner reçoit de nouvelles données dans une zone de données de numérisation non alignée, il tentera automatiquement de s'aligner et toutes les vignettes de données alignées disparaîtront.

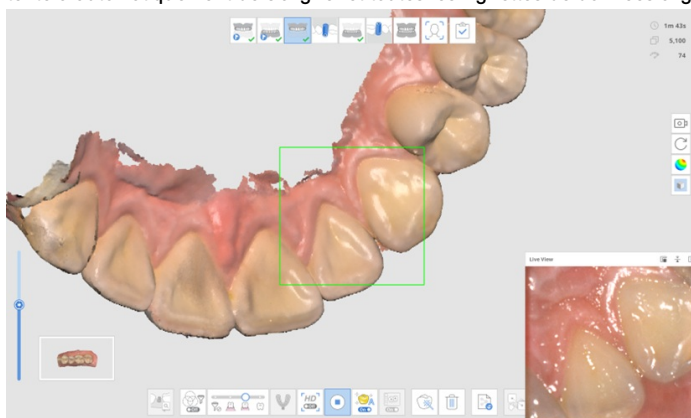

6. Le message suivant peut apparaître lorsque vous essayez de quitter les étapes alors qu'il existe des données de numérisation non alignées.

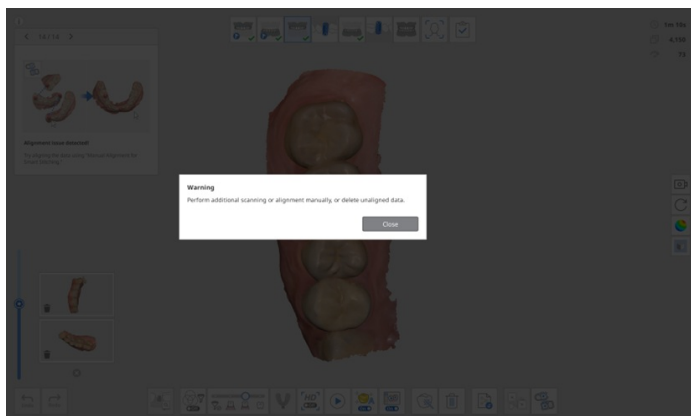

7. Pour aligner toutes les données de numérisation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Numérisez des données supplémentaires pour obtenir plus de données pour l'alignement automatique
 - Utilisez l'outil Alignement manuel pour aligner les données
 - Supprimez tout ou partie des données de numérisation qui ne sont pas alignées.
8. L'acquisition des données est terminée lorsque toutes les données de numérisation non alignées sont alignées, comme indiqué ci-dessous.

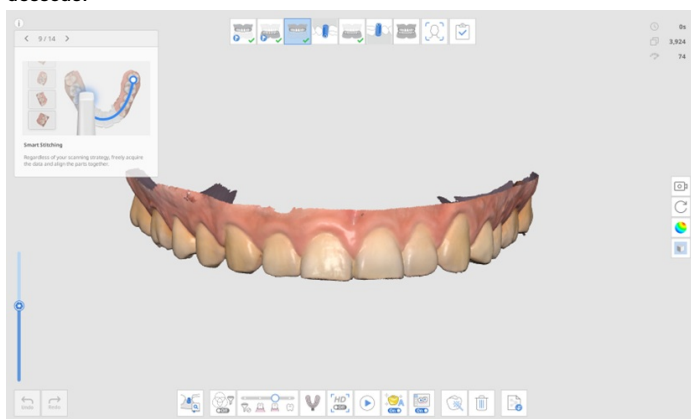

Outils avancés

	Scan d'empreinte	Fournit une numérisation fluide pour combiner les données de numérisation intraorale et d'empreinte. Fusionne facilement les données de numérisation intraorale et d'empreinte avec la numérisation intégrée. * Consultez Exemples de cas et de flux de travail > Scan d'empreinte pour une description détaillée de l'utilisation de l'outil.
	Correspondance de pilier IA	Permet de gérer des bibliothèques de piliers personnalisées. Ces données de bibliothèque sont alignées automatiquement sur les données de numérisation, ce qui minimise la nécessité de numériser les zones difficiles d'accès. * Consultez Exemples de cas et de flux de travail > Correspondance de pilier IA pour obtenir une description détaillée de l'utilisation de l'outil.
	Correspondance scanbody IA	Permet de gérer des bibliothèques scanbody personnalisées. Ces données de bibliothèque sont alignées automatiquement sur les données de numérisation, ce qui minimise la nécessité de numériser les zones difficiles d'accès. Les données de la bibliothèque peuvent être partagées pour d'autres processus, tels que la conception. * Consultez Exemples de cas et de flux de travail > Correspondance scanbody IA pour une description détaillée de l'utilisation de l'outil.
	Mouvement mandibulaire	Permet d'enregistrer et de rejouer le mouvement mandibulaire du patient. * Consultez Étapes de numérisation > Occlusion > Outils supplémentaires pour l'étape d'occlusion > Mouvement mandibulaire pour une description détaillée de l'utilisation de l'outil.
	Révision de la préparation	Vérifiez si la préparation de la dent est effectuée dans la plage de valeurs prédéfinie. Vous pouvez vérifier les données de la dent préparée avec le chemin d'insertion et les mesures de distance telles que la profondeur de réduction de la dent, la distance par rapport aux antagonistes et la distance par rapport aux adjacentes. * Consultez Exemples de cas et de flux de travail > Révision de la préparation pour obtenir une description détaillée de l'utilisation de l'outil.

Outils de la barre d'outils principale

Outils de découpage

Les outils de découpage permettent d'éditer et d'éliminer le bruit des données.


	Découpage polyligne	Permet de supprimer toutes les entités à l'intérieur d'une polyligne dessinée à l'écran.
	Découpage pinceau	Supprime toutes les entités situées sur une trajectoire dessinée à main levée sur l'écran. Seule la face avant sera sélectionnée. Le pinceau est disponible en trois tailles différentes.
	Découpage rapide	Retire rapidement les données détachées du reste des données.

Découpage polyligne


1. Cliquez sur "Découpage polyligne" dans l'Outil de découpage de la barre d'outils principale.



2. Dessinez une polyligne autour de la zone à supprimer dans les données 3D.

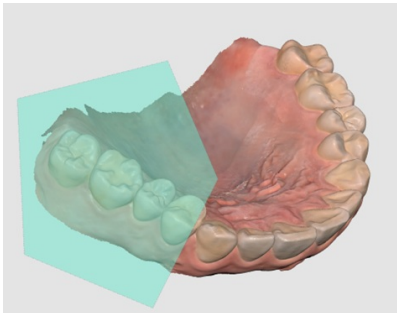

3. Supprimez la région sélectionnée en cliquant avec le bouton droit de la souris.

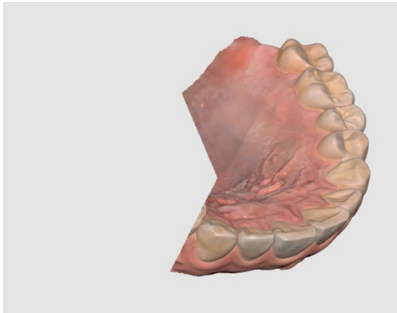

Découpage pinceau


Avec le Découpage pinceau, vous pouvez supprimer toutes les entités d'un chemin dessiné à main levée sur l'écran. Les outils suivants sont disponibles au bas de l'écran lorsque vous sélectionnez l'outil Découpage pinceau.

	Taille de pinceau	Permet de définir la taille du pinceau. Le pinceau est disponible en trois tailles différentes.
	Découpage manuel de bruit	Élimine les données parasites inutiles dans la zone sélectionnée à l'aide d'un pinceau.
	Découpage de bruit automatique	Permet de supprimer automatiquement les données parasites superflues en fonction de la direction de vue.


1. Cliquez sur "Découpage pinceau" dans l'outil Découpage de la barre d'outils principale.




2. Sélectionnez la taille du pinceau en bas.



3. Sélectionnez les zones où le bruit doit être éliminé. Seule la face avant sera sélectionnée.

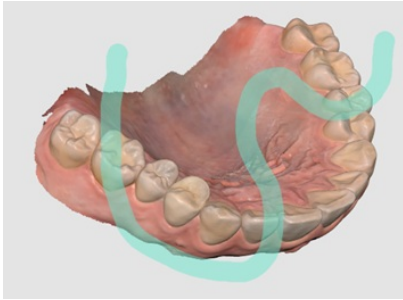

4. La zone sélectionnée avec la souris est automatiquement supprimée.

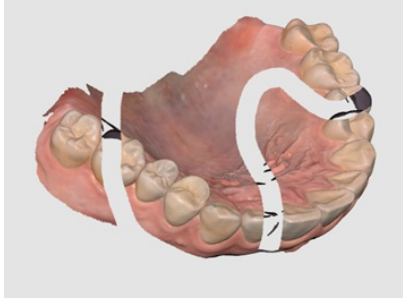

Découpage manuel de bruit

Vous pouvez supprimer manuellement les données parasites inutiles.

Note

Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez sélectionner une zone à l'aide d'un pinceau, mais la zone n'est pas supprimée.

1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Découpage manuel du bruit" en bas.



2. Sélectionnez la taille du pinceau en bas.



3. Sélectionnez les zones où le bruit doit être éliminé.
4. La zone sélectionnée avec la souris est automatiquement supprimée.


Découpage de bruit automatique

Vous pouvez automatiquement couper les tissus mous superflus tels que les lèvres, les joues et la langue.


1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Découpage automatique du bruit" en bas.
2. Le programme supprime automatiquement les tissus mous inutiles.

Découpage rapide


1. Cliquez sur "Découpage rapide" dans l'outil Découpage de la barre d'outils principale.



2. Cliquez sur les données séparées du reste des données de numérisation.

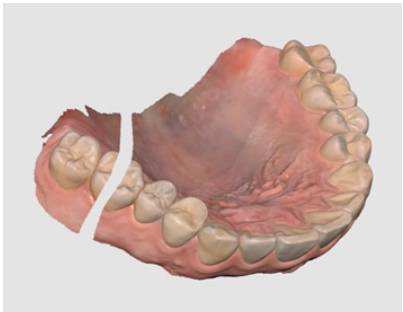

3. La zone isolée où vous avez cliqué est supprimée comme ci-dessous.

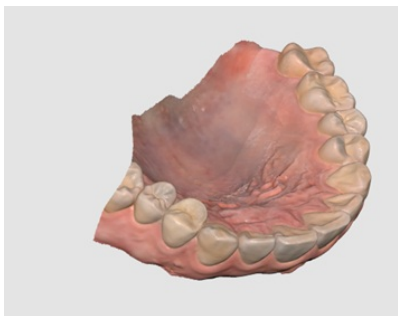

Outils de fonction

	Zone de blocage	Permet de verrouiller une zone spécifique à l'aide des outils de sélection.
	Analyse de contre-dépouille	Analyse la zone de contre-dépouille en fonction de la direction d'insertion.
	Échangez maxillaire et mandibule	Intervertit les scans du maxillaire et de la mandibule. Cette fonction est utile si l'opérateur numérise accidentellement la mauvaise mâchoire.
	Aperçu du résultat	Affiche l'aperçu de la zone sélectionnée pour vérifier la qualité des données avant le traitement proprement dit.
	Ligne de marge	Crée une ligne de marge automatiquement ou manuellement. Les informations relatives à la ligne de marge peuvent également être importées dans un programme de conception.
	Nettoyage intelligent des données	Filtrez les données sur les tissus mous en supprimant les données non fiables à l'aide de la Carte de fiabilité.
	Rejouer le scan	Relit le processus de numérisation.
	Caméra HD	Prenez des images 2D avec des données de modèle 3D et partagez les images avec un laboratoire.
	Enregistrer les piliers	Enregistrez un pilier dans la bibliothèque en le numérisant vous-même ou en l'important. Une fois enregistré, vous pouvez l'utiliser pour la mise en Correspondance de pilier IA.
	Guide de teintes intelligent	Fournit des recommandations de teintes basées sur l'intelligence artificielle.

Si vous sélectionnez l'un des outils de fonction ci-dessus dans la barre d'outils principale, les outils de sélection suivants s'affichent en bas pour travailler sur la fonction.

	Sélection polyligne	Sélectionne toutes les entités au sein d'une forme polyligne à l'écran.
	Sélection cercle	Sélectionne toutes les données dans une zone circulaire.
	Sélection pinceau	Sélectionnez toutes les entités sur un chemin tracé à main levée sur l'écran. Le pinceau est disponible en trois tailles différentes.
	Sélection	Activez le mode de sélection pour sélectionner des zones à l'aide des outils de sélection ci-dessus.
	Désélection	Activez le mode de désélection pour désélectionner des zones à l'aide des outils de sélection ci-dessus.
	Effacer toute la sélection	Efface la totalité de la sélection.
	Confirmer	Appliquer les résultats pour l'outil sélectionné.

Zone de blocage

Vous pouvez bloquer une zone spécifique à l'aide des outils de sélection afin que la numérisation ultérieure n'affecte pas les formes de la zone bloquée, mais seulement la couleur.

Cette fonction est utile pour préserver les données de la gencive rétractée numérisées après le retrait du cordon.


1. Cliquez sur "Zone de Verrouillage" dans la barre d'outils principale.



- Sélectionnez une zone à verrouiller à l'aide des outils de sélection de zone.



- Sélectionnez la zone que vous souhaitez verrouiller. La zone sélectionnée est présentée dans une couleur différente.

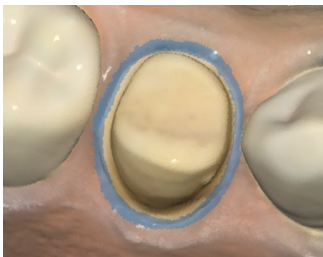

Vous pouvez déverrouiller la zone verrouillée en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'icône de l'outil "Désélection" pour passer en mode désélection, sélectionnez un outil de sélection et masquez les zones à déverrouiller.



- Cliquez sur l'icône de l'outil "Effacer toute la sélection" pour déverrouiller toutes les zones verrouillées.



Analyse de contre-dépouille

Analyse la zone de contre-dépouille en fonction de la direction d'insertion. La direction d'insertion peut être déterminée par la Direction automatique ou la Direction manuelle.

	Direction Automatique	Le système calcule automatiquement la direction dans laquelle la zone de contre-dépouille est minimisée. Il affiche alors la zone de contre-dépouille sur l'écran de visualisation.
	Direction Manuelle	Le système calcule la zone de contre-dépouille en fonction de la direction du regard de l'utilisateur. L'utilisateur peut modifier la direction de la vue en déplaçant ou en faisant pivoter les données. Il affiche alors la zone de contre-dépouille sur l'écran de visualisation.

Analyse de contre-dépouille avec Direction automatique

- Cliquez sur l'icône de l'outil "Analyse de contre-dépouille" dans la barre d'outils principale.



- Sélectionnez la région d'intérêt pour calculer la zone de contre-dépouille à l'aide des outils de sélection de zone.




Si aucune zone n'est sélectionnée, le programme calculera la zone de contre-dépouille pour l'ensemble du modèle 3D dans la zone d'affichage des données.


- Cliquez sur l'icône "Direction automatique" en bas.



- Une flèche du chemin d'insertion apparaît dans la direction où la zone de contre-dépouille est minimisée, et les zones de contre-dépouille sont représentées en bleu foncé.

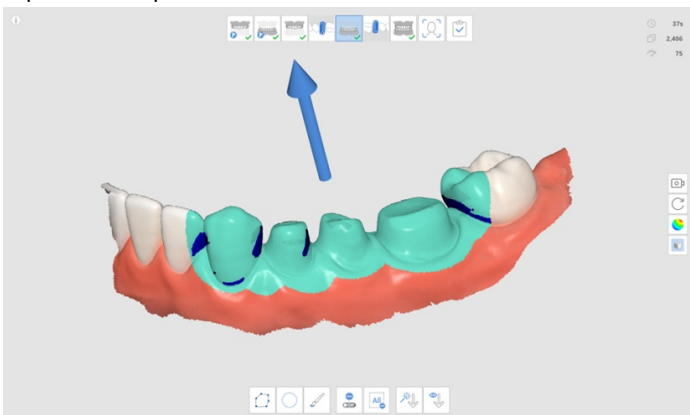

- Vous pouvez modifier la direction du chemin d'insertion en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en faisant glisser la flèche.

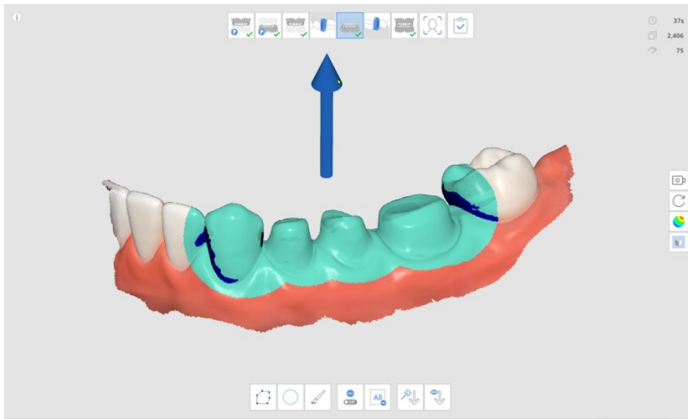

Analyse de contre-dépouille avec Direction manuelle

1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Analyse de contre-dépouille" dans la barre d'outils principale.



2. Sélectionnez la région d'intérêt pour calculer la zone de contre-dépouille à l'aide des outils de sélection de zone.
3. Utilisez les outils "Déplacer", "Pivoter", "Zoom avant" et "Zoom arrière" de la barre d'outils latérale pour modifier la direction du modèle.
4. Cliquez sur l'icône "Direction manuelle" en bas.



5. Une flèche du chemin d'insertion apparaît dans la direction du point de vue de l'utilisateur.
6. Vous pouvez modifier la direction du chemin d'insertion en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en faisant glisser la flèche.

Échanger Maxillaire et Mandibule

Lorsque la mandibule est numérisée par erreur dans l'étape de numérisation du maxillaire ou vice versa, vous pouvez le corriger à l'aide de cette fonction.

1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Échanger Maxillaire et Mandibule" dans la barre d'outils principale.




2. Les données actuelles aux étapes Maxillaire et Mandibule sont permutées.

Aperçu du résultat

1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Aperçu du résultat" dans la barre d'outils principale.




2. Sélectionnez une zone à prévisualiser à l'aide des outils de sélection de zone.

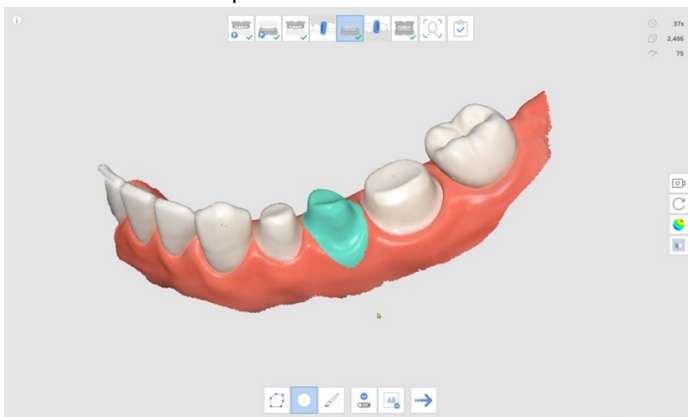

3. Cliquez sur "Étape suivante" pour afficher le résultat.



4. Prévisualiser le résultat.

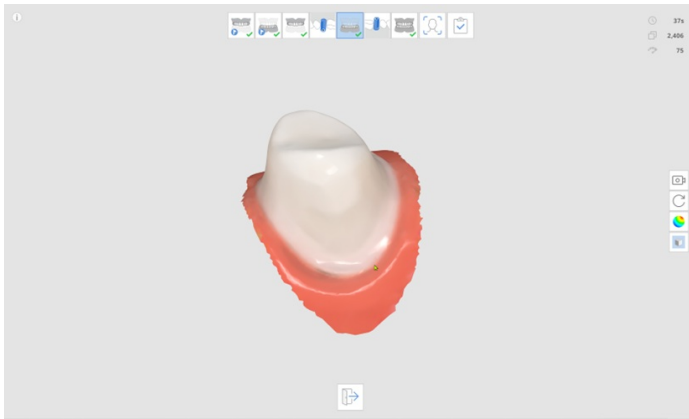

5. Cliquez sur "Quitter" pour revenir à l'étape précédente.



Ligne de marge


Les outils suivants sont fournis pour la fonction Ligne de marge.

	Création automatique	Créer automatiquement une ligne de marge en fonction des points sélectionnés par l'utilisateur. En sélectionnant plusieurs points, une ligne de marge fermée sera créée.
	Création manuelle	Créer une ligne de marge manuellement en fonction des points sélectionnés par l'utilisateur. Lorsqu'une courbe fermée est complétée par l'ajout manuel de points de contrôle, une ligne de marge est créée.
	Modifier	Permet de modifier la ligne de marge. L'utilisateur peut ajouter, déplacer et supprimer les points de contrôle d'une ligne de marge.
	Supprimer	Supprime la ligne de marge.
	Mode d'affichage de la courbure	Permet de mesurer la courbure de la surface des données pour afficher les données en différentes couleurs à travers une carte de couleurs. Si la couleur tend vers le rouge, elle est plus gaufrée, tandis que si elle tend vers le bleu, elle est plus gravée. Vous pouvez utiliser le curseur de l'intervalle d'expression de la couleur pour ajuster le rayon de la couleur.
	Vue de section	Affiche la section transversale de la zone où se trouve le pointeur de la souris. Cela permet d'éviter que des zones soient cachées lors d'un zoom rapproché et de vérifier plus attentivement la marge agrandie.


1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Ligne de marge" dans la barre d'outils principale.




- Sélectionnez l'étape Maxillaire ou Mandibule.
- Sélectionnez un numéro de dent.
- Sélectionnez une zone pour le numéro de dent sélectionné à l'aide des outils de sélection de zone et cliquez sur l'icône "Étape suivante".

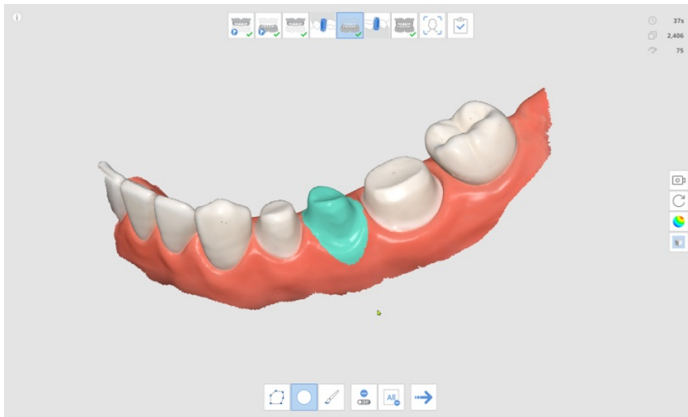


5. Le système génère un résultat temporaire avec la zone sélectionnée. Vous pouvez créer une ligne de marge à l'aide de ces données de résultat.
6. Cliquez sur l'icône "Création automatique" ou "Création manuelle" pour tracer la ligne de marge.
 - Création automatique : Cliquez sur l'icône "Création automatique" et sélectionnez les points. La ligne de marge est alors automatiquement créée sur la base des points de contrôle sélectionnés.
 - Création manuelle : Cliquez sur l'icône "Création manuelle" et marquez des points le long de la ligne de marge en utilisant le bouton gauche de la souris pour relier chaque point au suivant. Maintenez la souris enfoncée et déplacez-la pour affiner la position du point sur la Vue de section.

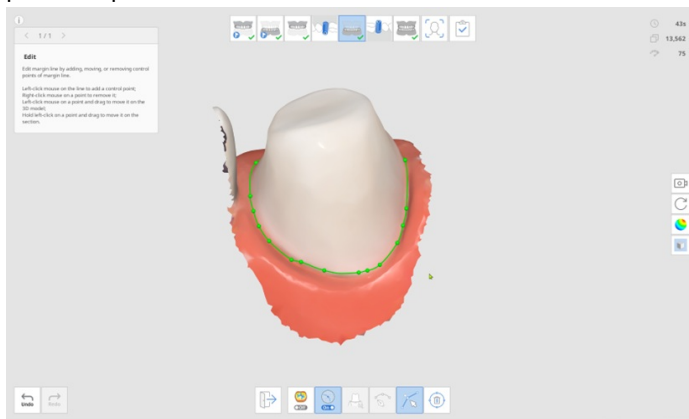

7. Vous pouvez effectuer des ajustements en cliquant sur l'icône "Modifier".
 - Ajouter un point de contrôle : cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la ligne de marge
 - Supprimer un point de contrôle : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point de contrôle
 - Déplacer un point de contrôle sur le modèle 3D : cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point de contrôle et faites-le glisser
 - Déplacer un point de contrôle sur la section : cliquez avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde sur un point de contrôle, puis faites-le glisser
8. Cliquez sur "Quitter" pour afficher la ligne de marge avec le numéro de la dent.

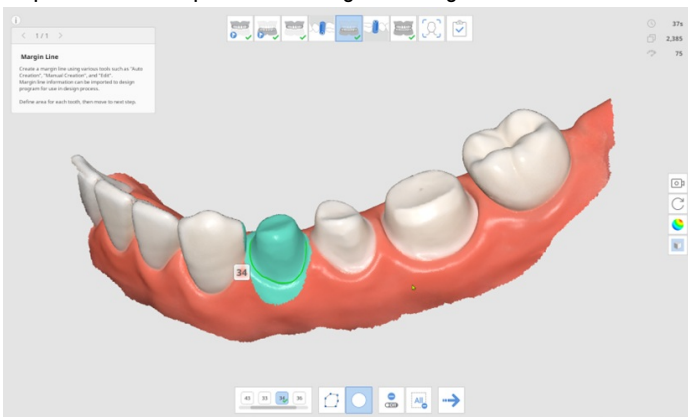

9. Vous pouvez modifier le numéro de dent d'une ligne de marge en cliquant sur un numéro de dent dans la vue du modèle 3D et en sélectionnant un numéro cible dans la fenêtre contextuelle.

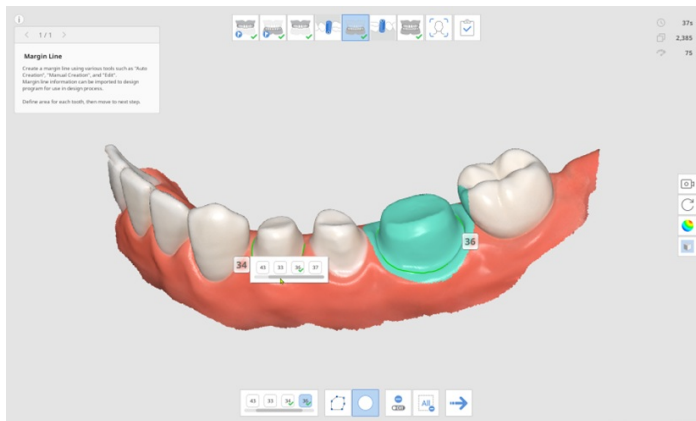

10. Répétez les étapes 3 à 9 pour tracer les lignes de marge des autres dents.

Nettoyage intelligent des données


Les outils suivants sont fournis pour la fonction Nettoyage intelligent des données.

	Rendre la zone à l'épreuve des modifications	Permet à l'utilisateur de sélectionner la zone qu'il souhaite protéger de la modification. - Lorsque cette option est activée, les zones sélectionnées sont protégées contre la suppression. - Lorsqu'elle est désactivée, les zones sélectionnées sont la cible de la suppression.
	Sélectionnez la zone des dents	Sélectionnez uniquement la zone des dents dans les données de numérisation. * Cette option n'est activée que lorsque l'option Rendre la zone à l'épreuve des modifications est activée.
	Intensité	Sélectionnez les données à l'aide d'une barre de défilement. La carte de fiabilité vous permet de sélectionner et de retirer facilement les tissus mous. - L'augmentation de l'intensité permet d'élargir les zones sélectionnées. - L'ajustement de la barre de défilement modifie les zones sélectionnées en temps réel.
	Sélection Flood Fill	Permet de sélectionner toutes les données dans la zone connectée.
	Rétrécir la zone sélectionnée	Réduit la zone sélectionnée chaque fois que l'utilisateur appuie sur le bouton.
	Développer la zone sélectionnée	Agrandit la zone sélectionnée chaque fois que l'utilisateur appuie sur le bouton.
	Inverser la zone sélectionnée	Inverse la sélection de la zone. La zone sélectionnée sera désélectionnée et la zone non sélectionnée précédemment sera sélectionnée.
	Supprimer la zone sélectionnée	Supprime les données dans la zone sélectionnée.


1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Nettoyage intelligent des données" dans la barre d'outils principale.




2. Réglez la barre de défilement "Intensité" pour sélectionner la quantité de données non fiables à supprimer. Le système sélectionne les données sur la base de la carte de fiabilité et les affiche en temps réel au fur et à mesure que vous réglez la barre de défilement.

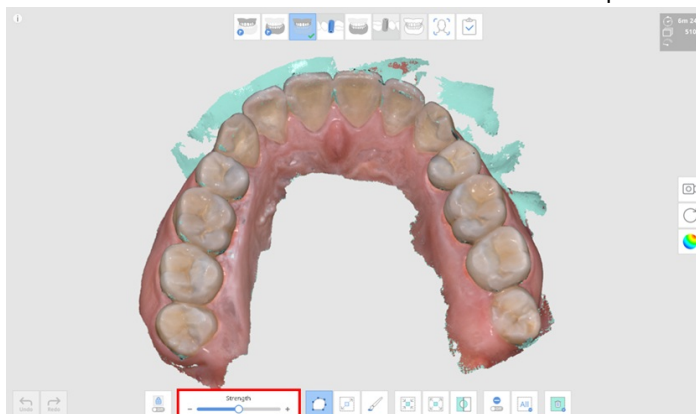


◦ L'augmentation de l'intensité élargira les zones sélectionnées.

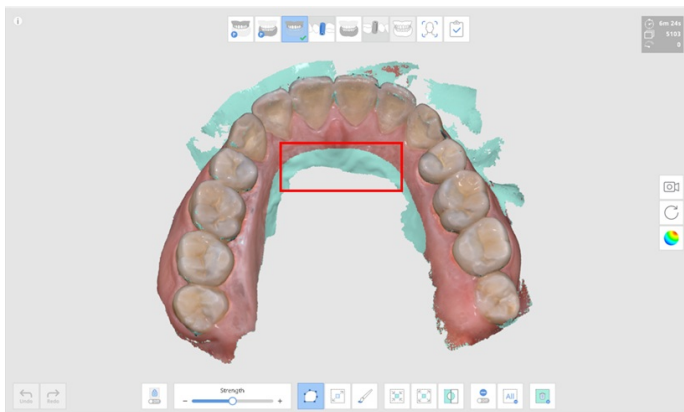

3. Sélectionnez les zones à supprimer à l'aide de divers outils de sélection.

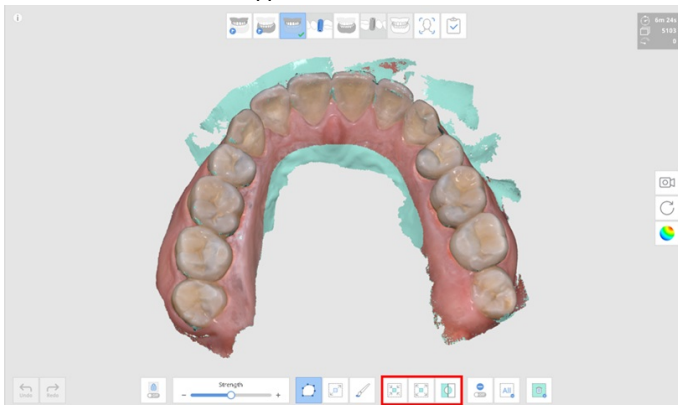

4. Cliquez sur l'icône "Supprimer la zone sélectionnée" pour supprimer toutes les zones sélectionnées.

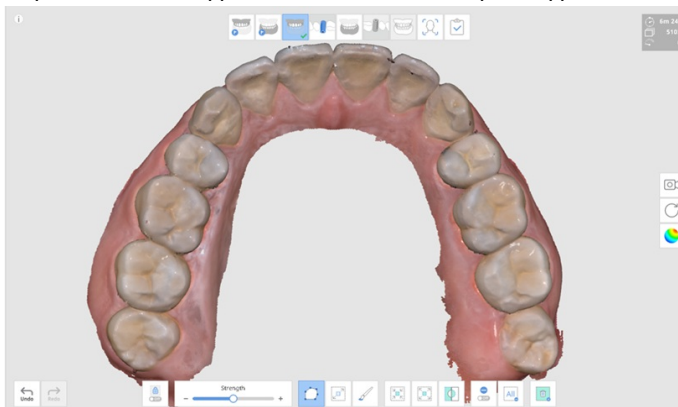

Rejouer le scan

Vous pouvez rejouer votre processus de numérisation après avoir numérisé des données dans Medit Scan for Clinics. Cette fonction est utile pour vérifier l'environnement de numérisation et les habitudes de l'utilisateur.

Les outils suivants sont fournis pour la fonction Rejouer le scan.

	Embout du scanner	Afficher ou masquer l'embout du scanner pendant la relecture.
	Zone de numérisation	Permet d'afficher ou de masquer la zone de numérisation pendant la relecture.
	Inverser la direction de l'embout	Changer la direction de l'embout pendant la relecture.


1. Cliquez sur l'icône de l'outil "Rejouer le scan" dans la barre d'outils principale.



2. Sélectionnez les options de rejouer le scan dans le coin inférieur gauche de l'écran. L'embout du scanner et la zone de numérisation s'affichent dans la vidéo, en fonction de votre sélection.



3. Cliquez sur le bouton "Lecture" pour lancer la relecture.

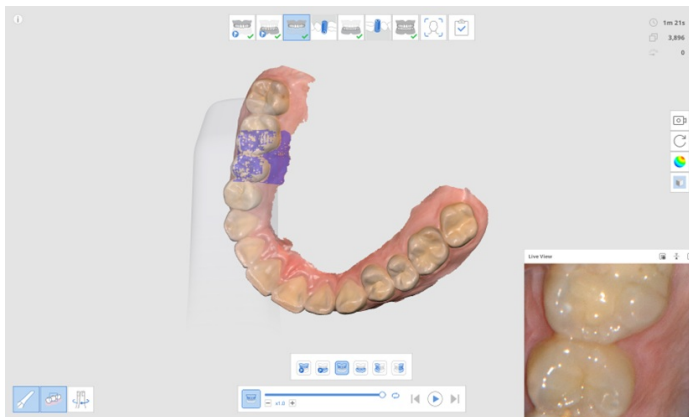

4. Les étapes sélectionnées seront rejouées dans l'ordre.



Vous pouvez utiliser les différents outils fournis pour contrôler la vidéo.

	Barre de défilement	Démarrer la vidéo à partir du point d'intérêt.
	Vitesse de la vidéo	Modifier la vitesse (x0,5, x1,0 ou x3,0).
	Répéter	Répéter la lecture.
	Replay précédent	Rejouer le scan de l'étape précédente.
	Lecture	Lancer la relecture du scan.
	Stop	Arrêter la relecture du scan.
	Relecture suivante	Rejouer le scan de l'étape suivante.

Caméra HD

La fonction de caméra HD permet de prendre des images de haute qualité à l'aide du scanner.


1. Sélectionnez l'icône "Caméra HD" dans la barre d'outils principale.



2. La boîte de dialogue Caméra HD s'affiche.

3. Placez l'embout du scanner sur la région d'intérêt.

4. Appuyez sur le bouton Scan de la pièce à main pour prendre une photo.

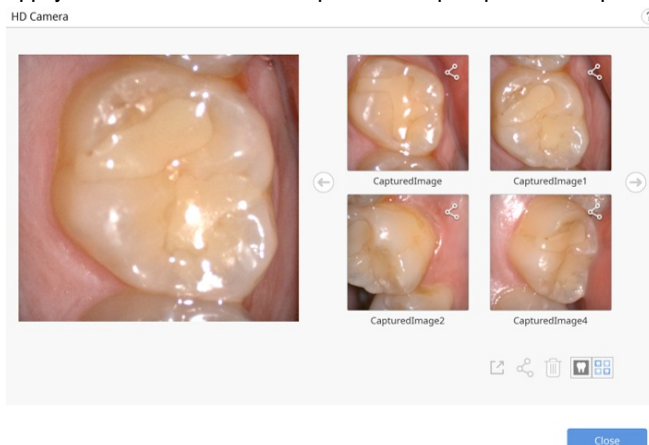

5. Vous pouvez renommer une image en cliquant sur l'image et en saisissant le nouveau nom.

6. Vous pouvez partager, exporter ou supprimer l'image à l'aide des outils suivants fournis au bas de la boîte de dialogue.

	Exporter les fichiers sélectionnés vers l'ordinateur local.
--	---

	Partager l'image sélectionnée ou arrêter le partage de l'image.
	Supprimer l'image sélectionnée.
	Modifier le style d'affichage d'une vignette.

- Les images capturées sont enregistrées dans Medit Link en tant que pièces jointes lorsque vous quittez Medit Scan for Clinics après avoir enregistré les modifications.

Enregistrer les piliers

Il fallait recevoir des fichiers de piliers personnalisés créés par des scanners de table dans les laboratoires ou même faire des cas inutiles dans Medit Clinics pour numériser le pilier et créer des données 3D, ce qui rendait difficile l'utilisation correcte de la "Correspondance de pilier IA".

La fonction Enregistrer piliers vous permet de numériser le pilier du patient directement dans son cas et de l'enregistrer en tant que bibliothèque. Avant de placer l'implant dans la bouche du patient, numérisez d'abord le pilier et enregistrez-le en tant que bibliothèque. Vous pouvez ensuite utiliser "Correspondance de pilier IA" pour remplacer les données de numérisation par les données de la bibliothèque.


iNote

Veuillez consulter [Exemples de cas et de flux de travail > Correspondance de pilier IA](#) pour savoir comment utiliser les piliers enregistrés.


Les outils suivants sont fournis pour la fonction Enregistrer piliers.

	Ajouter	Ajouter des piliers. Vous pouvez ajouter via la numérisation ou l'importation.
	Remplir les trous pour Piliers Activé/Désactivé	Activez ou désactivez cette option pour remplir les trous pour piliers lors de la fusion.
	Fusionner piliers	Permet de fusionner les piliers numérisés ou importés.
	Remplir trou depuis votre perspective	Remplissez le trou du pilier depuis la direction vers laquelle vous regardez.
	Réinitialiser le pilier	Réinitialisez pour annuler toutes les modifications apportées au pilier.
	Enregistrer dans Bibliothèque	Enregistrer le pilier fusionné dans la bibliothèque. Si vous cochez la case, elle ne sera utilisée que dans ce cas précis.


- Cliquez sur l'icône de l'outil "Enregistrer le pilier" dans la barre d'outils principale.

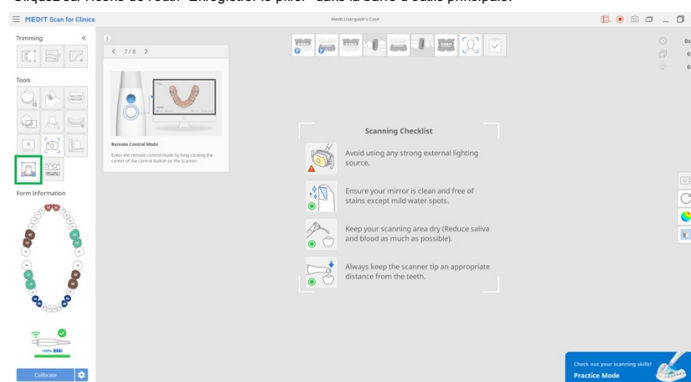


- Vous verrez les outils décrits ci-dessus en bas de l'écran.

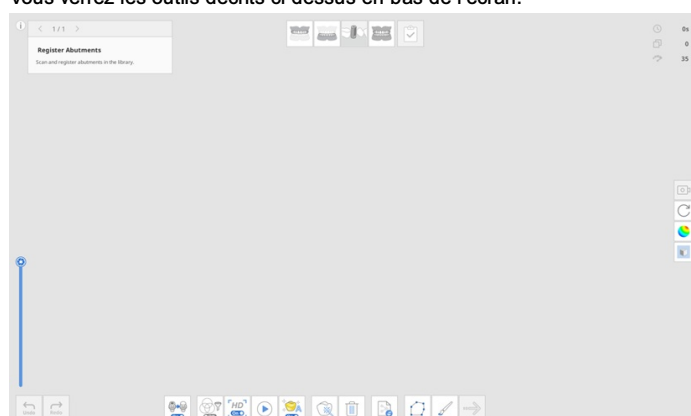


3. Numériser le pilier.

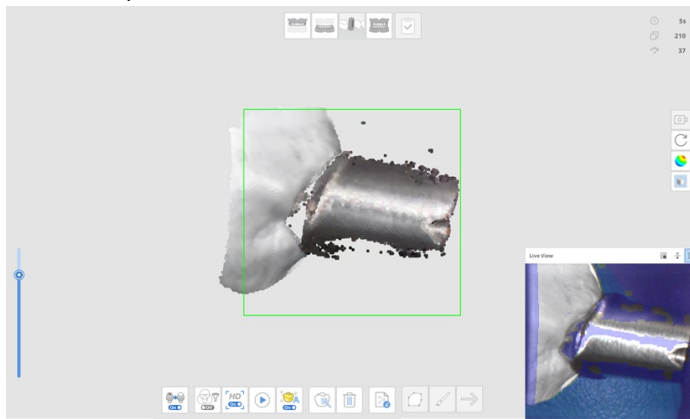


4. Vous pouvez modifier les données à l'aide des outils Polyligne et Découpage pinceau lorsque vous arrêtez la numérisation.

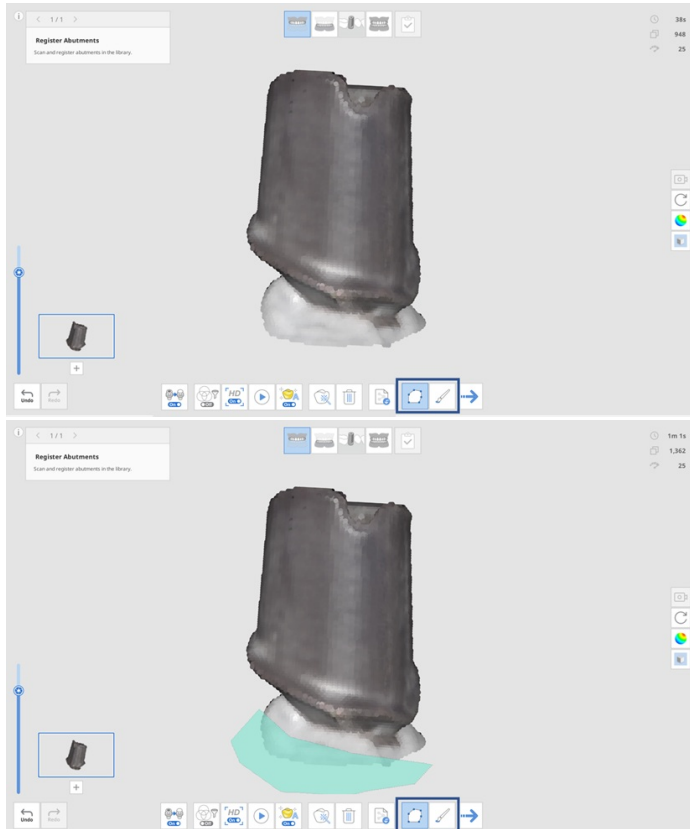


5. Cliquez sur le bouton "+" situé sous la vignette du pilier pour numériser un autre pilier. Vous pouvez numériser et enregistrer jusqu'à 6 piliers.

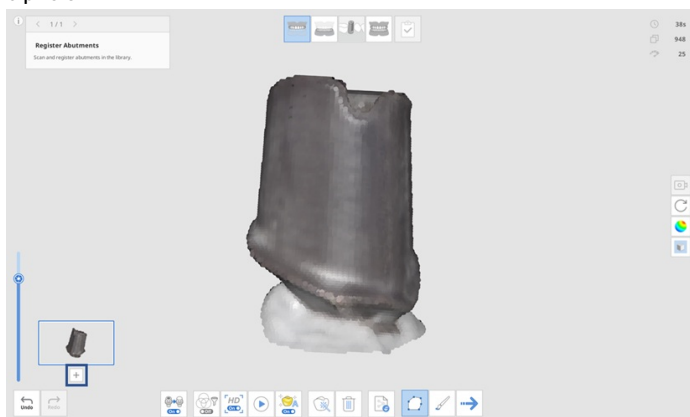


6. Après avoir numérisé tous les piliers, cliquez sur le bouton "Fusionner les piliers" pour fusionner les données des piliers pour l'enregistrement dans la bibliothèque.

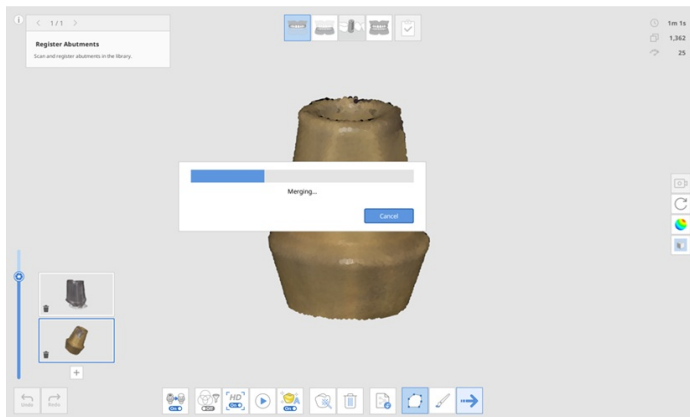

7. Lorsque la fusion est terminée, le pilier s'affiche à l'écran. Si nécessaire, vous pouvez supprimer les trous remplis automatiquement ou modifier les données du pilier à l'aide des outils Polyligne et Découpage pinceau.

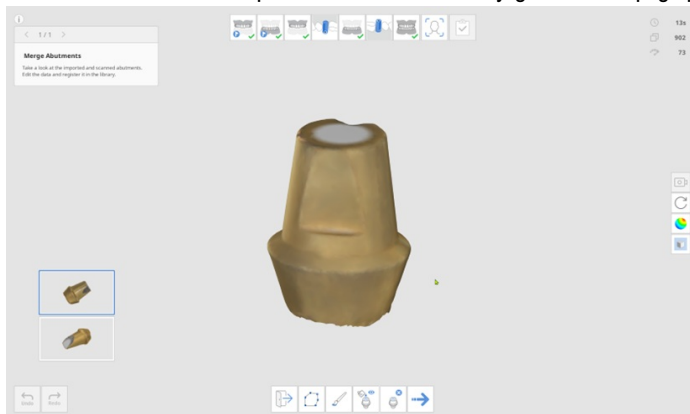


8. Cliquez sur le bouton "Enregistrer le pilier" lorsque la modification est terminée.

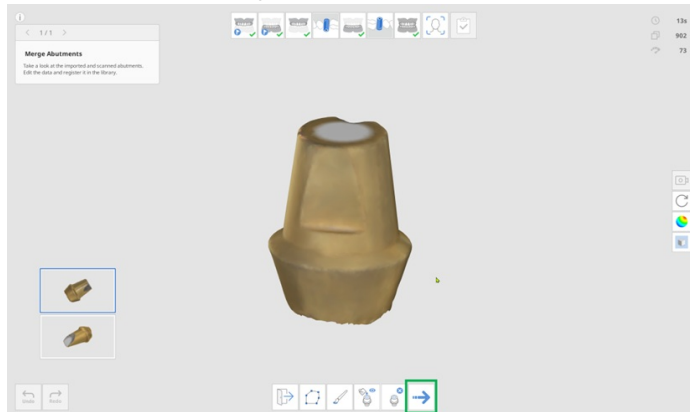


9. Saisissez le nom de chaque pilier fusionné et cliquez sur "Confirmer".

Si vous souhaitez conserver les bibliothèques de piliers et les utiliser pour d'autres cas, décochez la case "Utiliser les piliers fusionnés uniquement dans ce cas".

Les bibliothèques seront alors enregistrées dans l'onglet Collections au lieu de l'onglet Usage unique dans la fenêtre Bibliothèque de piliers, ce qui vous permettra de les sauvegarder et de les réutiliser dans d'autres cas si nécessaire.

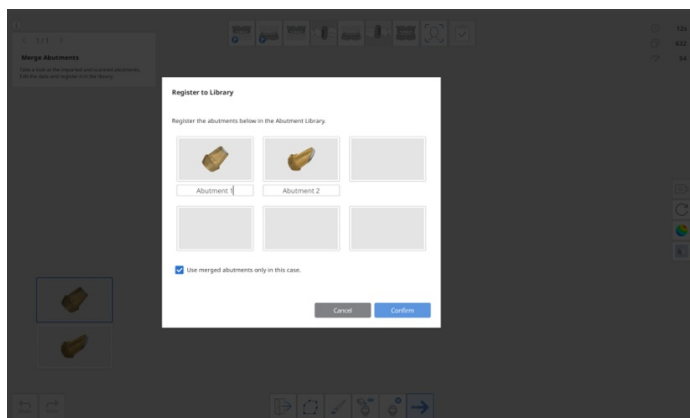

10. Vérifiez que vos piliers ont bien été ajoutés à la bibliothèque lorsque la boîte de dialogue Bibliothèque de piliers s'affiche.

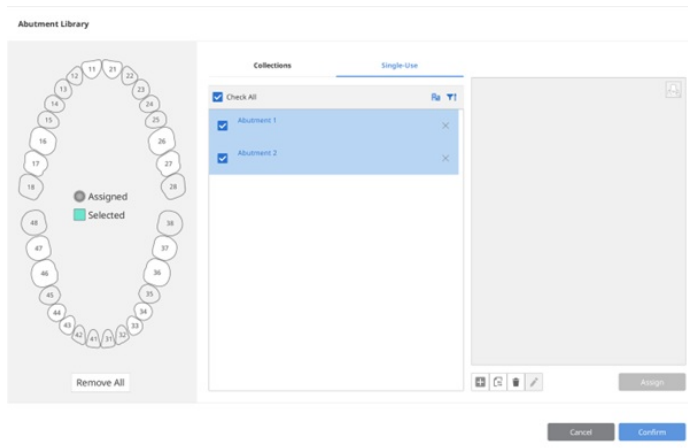

11. Cliquez sur "Confirmer" pour fermer la boîte de dialogue.

Guide de teintes intelligent

iNote


Cette fonction n'est pas disponible pour les données acquises avec le i500.

Le Guide de teintes intelligent recommandera la teinte la plus proche grâce à l'analyse des données.


Nous prenons en charge les guides de teintes suivants :

- VITA Classical
- Guide de teintes Vita 3D-Master

1. Après l'acquisition des données de numérisation, cliquez sur l'icône de l'outil "Guide de teintes intelligent" dans la barre d'outils principale.

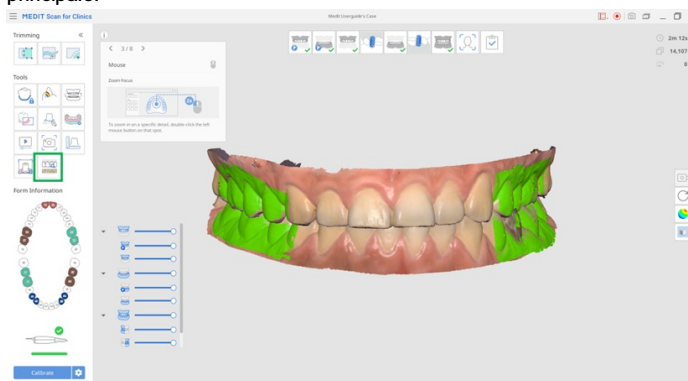


2. Cliquez sur l'icône de l'étape de numérisation sur le côté gauche de l'écran pour sélectionner la zone pour laquelle vous souhaitez recevoir des mesures.


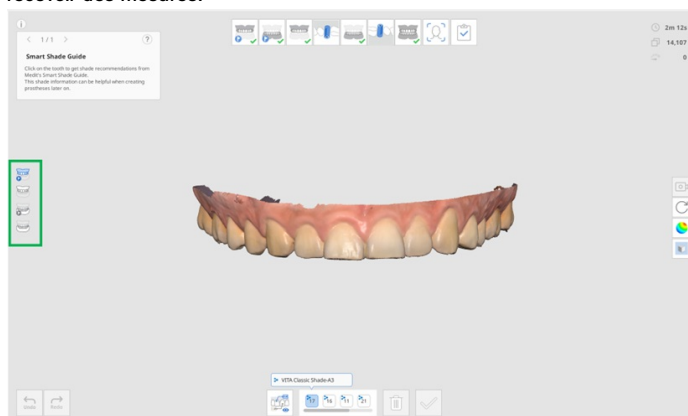


- Pré-op pour maxillaire
- Pré-op pour mandibule
- Maxillaire
- Mandibule
- Prothèse maxillaire
- Prothèse mandibulaire


3. Sélectionnez le numéro de la dent dans la liste des numéros de dents en bas. En cliquant sur le numéro de la dent, les informations de teinte enregistrées dans Medit Link s'affichent.

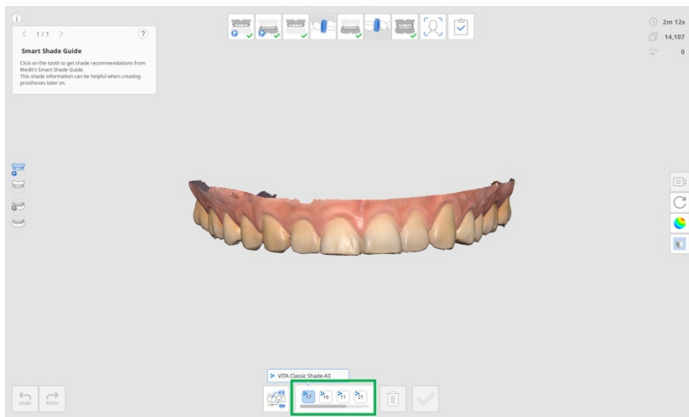


4. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur les données de numérisation de cette dent, le curseur change de forme pour les recommandations de teinte. Si vous survolez une zone non mesurable, vous serez informé que la mesure n'est pas possible.

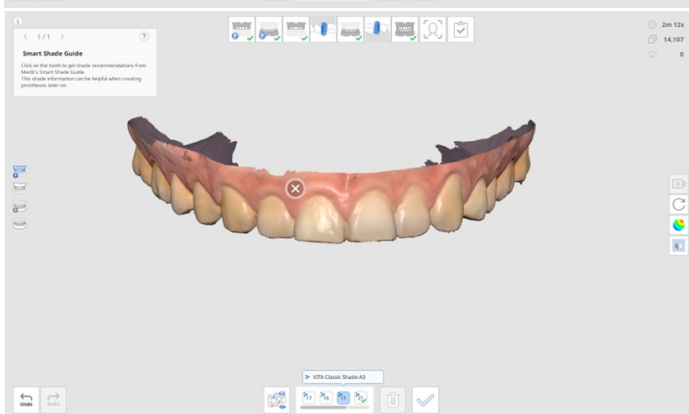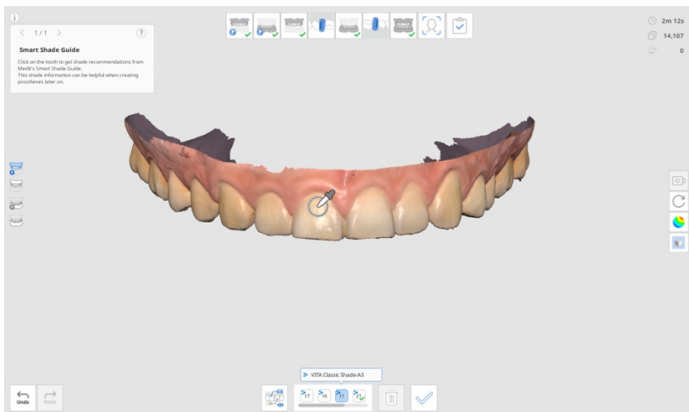


5. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la zone de la dent pour obtenir des recommandations de teintes. L'icône en forme d'étoile indique la teinte la plus proche. Si vous souhaitez désigner une teinte autre que celle recommandée, cliquez sur "Manuel" et sélectionnez la teinte souhaitée dans la liste.

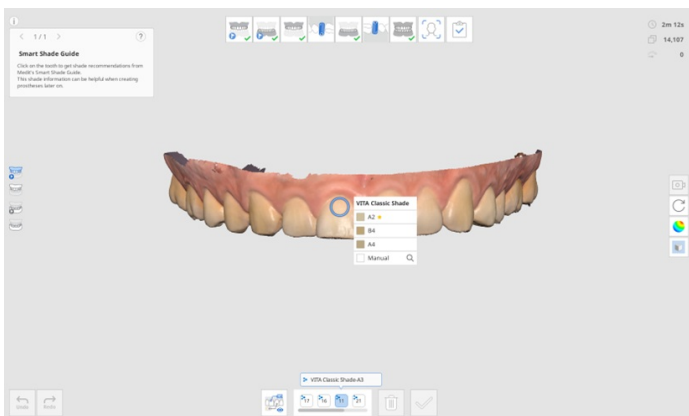

6. Cliquez sur la teinte désirée dans la liste.

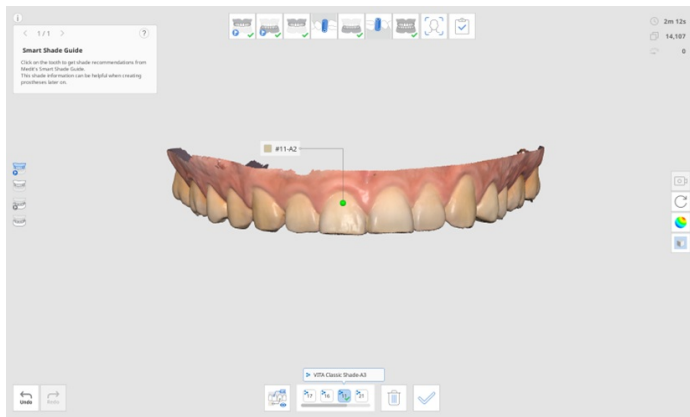


7. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq teintes par dent.

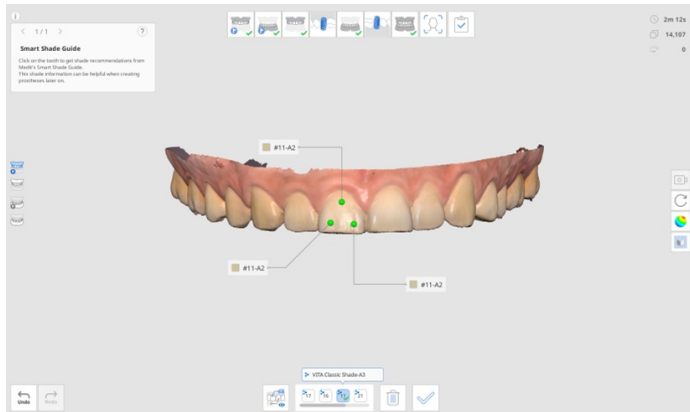

8. Après avoir sélectionné toutes les teintes, cliquez sur "Confirmer teinte" en bas.

9. Les teintes sélectionnées pour chaque dent sont affichées dans la boîte de dialogue Mettre à jour les informations sur la teinte.


10. Sélectionnez la teinte représentative qui sera enregistrée dans le Medit Link.

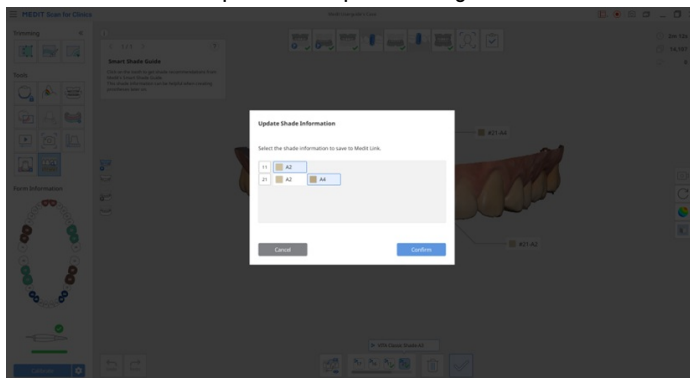

11. Cliquez sur "Tout voir" pour afficher toutes les informations de teinte.









12. Une fois l'opération terminée, sélectionnez la manière dont vous souhaitez mettre à jour les informations du formulaire dans Medit Link.

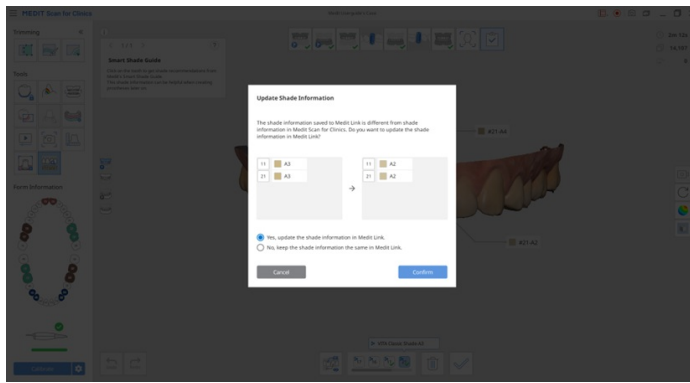

Outils de la barre d'outils latérale

iNote

Allez dans Paramètres > Préférences du programme > Interface et activez l'option "Développer les icônes de contrôle du modèle" pour afficher les icônes Panoramique, Zoom avant/arrière et Ajustement du zoom.

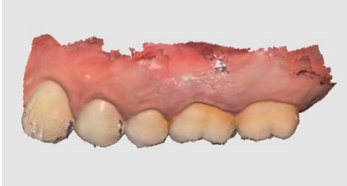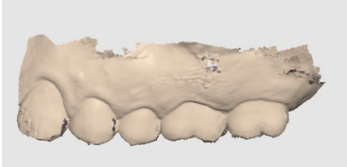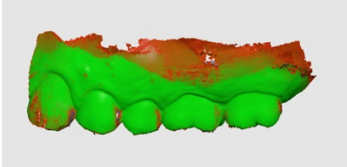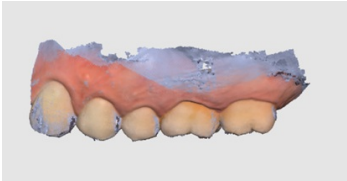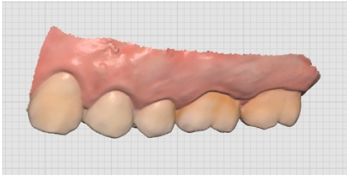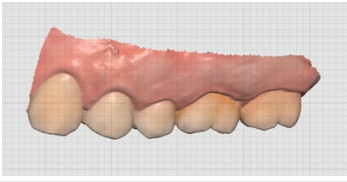	Mode de visualisation de la caméra	Permet de changer le mode d'affichage de la caméra entre les modes "Vue dynamique" et "Vue fixe".
	Panoramique	Déplacer le modèle.
	Pivoter	Pivoter le modèle.
	Zoom avant/arrière	Zoom avant et arrière sur le modèle.
	Ajustement du zoom	Positionne le modèle au centre de l'écran.
	Texture activée	Appliquer différentes couleurs de texture au modèle. 
	Texture désactivée	Applique une seule texture au modèle. 
	Mode d'affichage du modèle	Appliquez les couleurs rouge, jaune et verte au modèle pour indiquer la fiabilité des données de numérisation. * Les données vertes indiquent une grande fiabilité, tandis que les données rouges indiquent une faible fiabilité. Vous pouvez effectuer une numérisation supplémentaire pour réduire les zones non fiables.
	Carte de fiabilité	
	Texture activée + Carte de fiabilité	Aide à obtenir de meilleurs résultats en permettant de se référer à la carte de fiabilité tout en scannant avec la texture. 
	Grille activée	Affiche la grille en arrière-plan. 
	Paramètres de grille (mm)	Grille désactivée
		Masque la grille en arrière-plan.
		Superposition activée
		Superpose la grille au modèle. 

Scan de la prothèse

La séquence de la prothèse peut être utilisée pour numériser la prothèse actuelle du patient, la prothèse temporaire ou la cire d'occlusion.


iNote

L'étape de Prothèse maxillaire/mandibulaire apparaît lorsque le formulaire est enregistré en tant qu'Arcade (Complet résine, Copie de complet résine ou Complet résine sur implant) sur Medit Link.

- Veillez à ce que toutes les faces de la prothèse soient suffisamment numérisées, y compris les surfaces labiales/buccales et palatines/linguales.
- Pour le maxillaire, veillez à numériser la zone palatine, y compris les papilles palatines et la tubérosité maxillaire.
- Pour la mandibule, veillez à numériser le triangle rétromolaire.
- Si la caméra se perd pendant la numérisation, recommencez à partir des parties les plus importantes du palais, tels que les papilles palatines ou la crête alvéolaire.

Complet résine


Le flux de travail suivant de Complet résine apparaît comme Maxillaire édenté > Prothèse maxillaire > Mandibule édentée > Prothèse mandibulaire > Occlusion.




Acquérir les données de scan édenté

Numérisez le maxillaire/mandibule édenté à l'étape de numérisation du Maxillaire /Mandibule édenté et les données de la prothèse à l'étape de la Prothèse maxillaire/mandibulaire.


1. Numérisez la surface édentée pour le maxillaire.

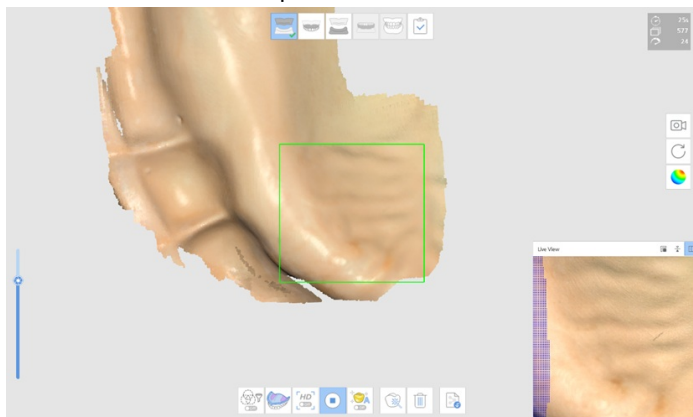

2. Les données sur l'édentement acquises lors de la première étape de numérisation (Maxillaire édenté) seront inversées et serviront de base à l'alignement de la prothèse lors de l'étape de numérisation suivante.

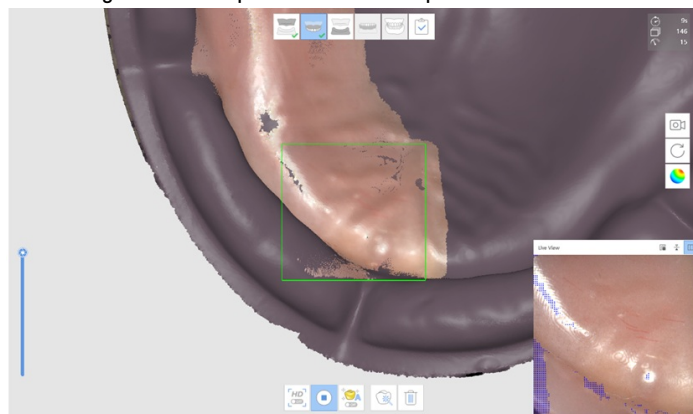



3. Numérisez les données de la prothèse dans l'ordre suivant : surface d'adaptation > bord > surface polie et dents artificielles.
4. Répéter l'opération pour la mandibule.
5. Numérisez l'occlusion de la prothèse à l'étape Numérisation de l'occlusion. Les données peuvent être utilisées dans la CAD.

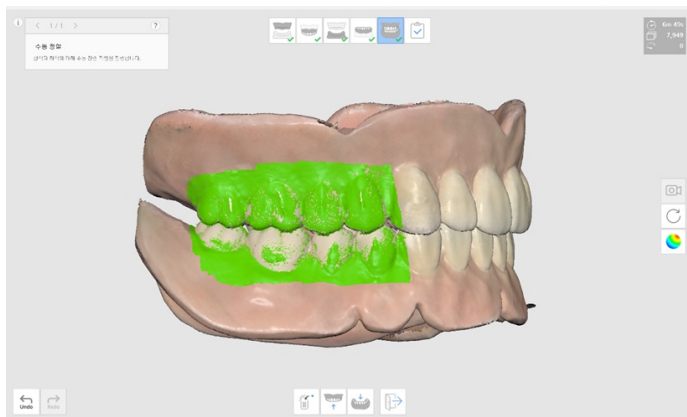


Scan de la prothèse rebasée

Permet de numériser la prothèse sans acquérir de données intra-orales du patient. Numérisez la surface d'adaptation de la prothèse à l'étape de numérisation de la Mandibule édentée et l'extrados aux étapes de la prothèse.


1. À l'étape de numérisation de la Mandibule édentée, cliquez sur "Scan de la prothèse rebasée" pour numériser en mode inversé.

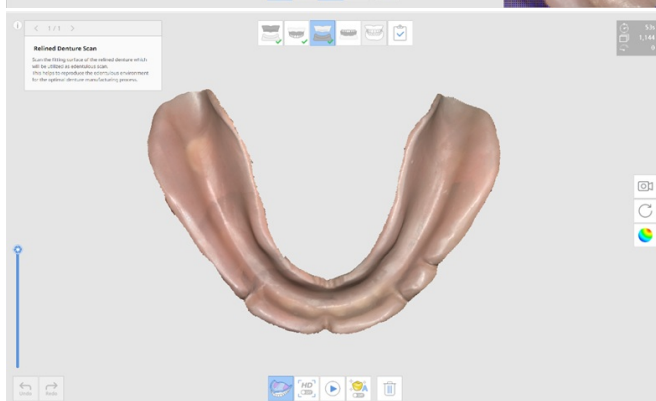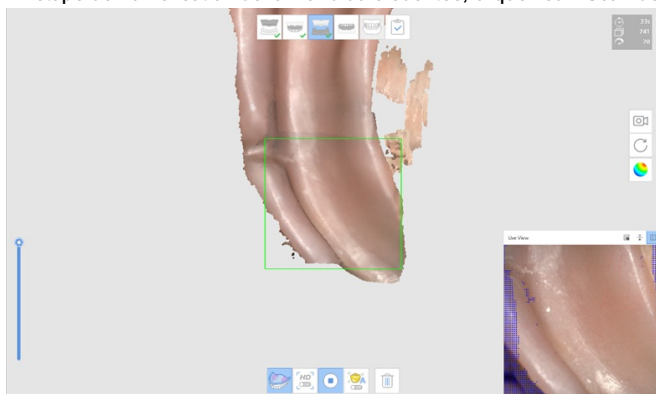

2. Après être passé à l'étape suivante, numérisez l'extrados de la prothèse. Les données de l'étape précédente seront copiées et inversées puisqu'elles serviront de base à l'alignement de la prothèse.
3. Répéter l'opération pour le maxillaire.

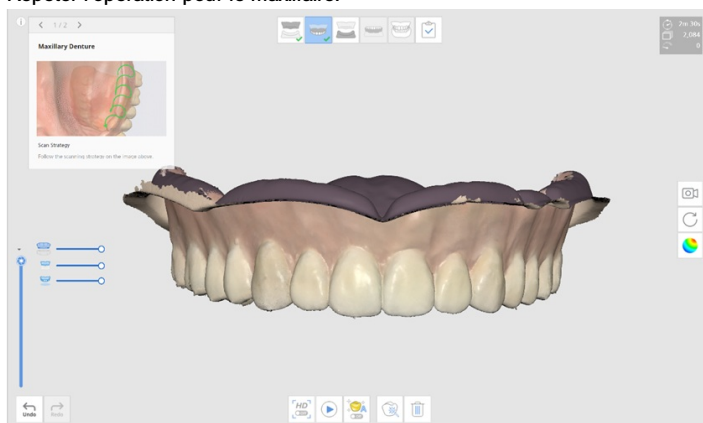


4. Numérisez l'occlusion de la prothèse à l'étape Numérisation de l'occlusion. Les données peuvent être utilisées dans la CAD.

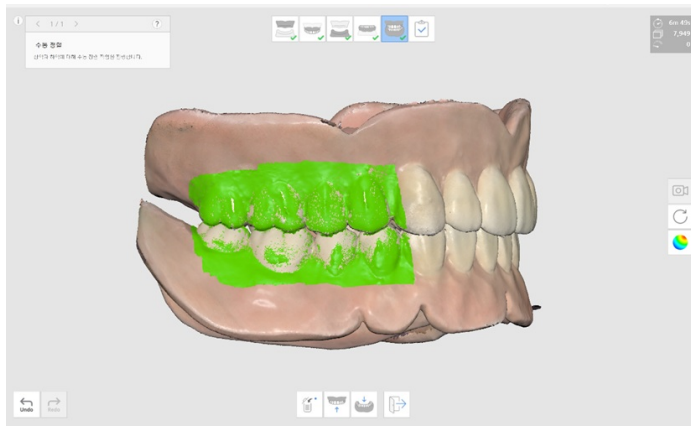


Copie de complet résine


Le flux de travail suivant du duplicata de prothèse apparaît comme Prothèse maxillaire > Prothèse mandibulaire > Occlusion.




1. Numérisez la prothèse maxillaire.

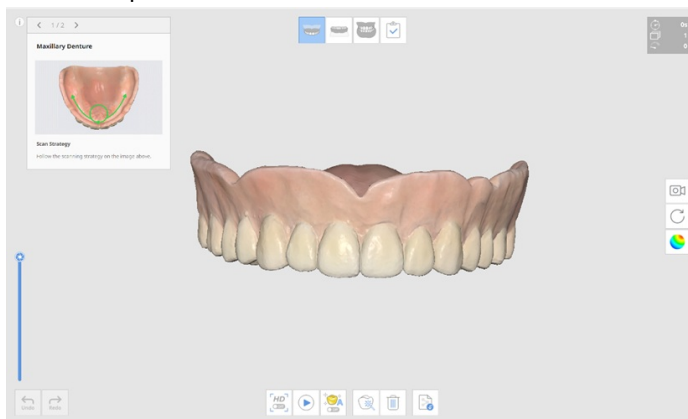

2. Numérisez la prothèse mandibulaire.

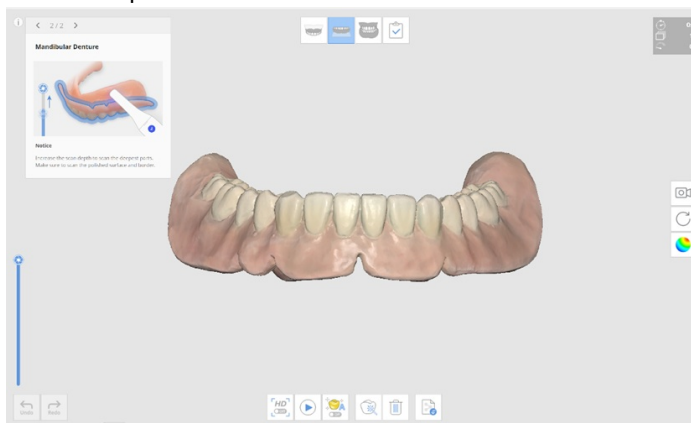


3. Numérisez les données de la prothèse dans l'ordre suivant : surface d'adaptation > bord > surface polie et dents artificielles
4. Numérisez l'occlusion de la prothèse à l'étape Numérisation de l'occlusion. Les données peuvent être utilisées dans la CAD.

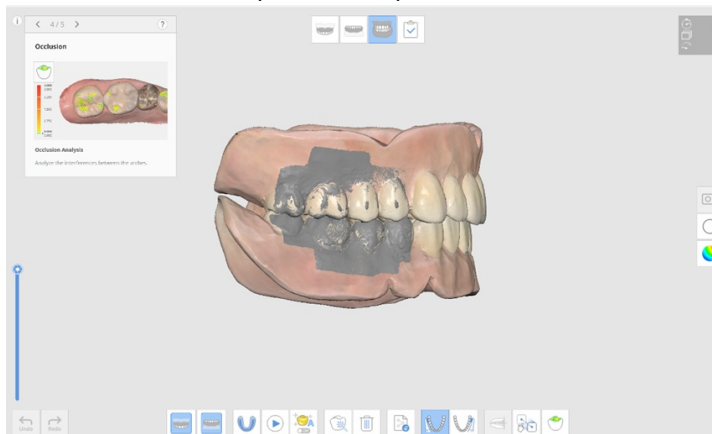


Complet résine sur implant

Le flux de travail suivant de Complet résine sur implant apparaît comme Maxillaire édenté > Prothèse maxillaire > Mandibule édentée > Scanbody > Prothèse mandibulaire > Occlusion.




1. Acquérir les données pour les étapes de numérisation de l'édentement.
2. Numérisez le scanbody à l'étape correspondante du scan scanbody.

Utilisez l'outil "Correspondance scanbody IA" pour obtenir des données de numérisation précises à partir de la bibliothèque prédéfinie.

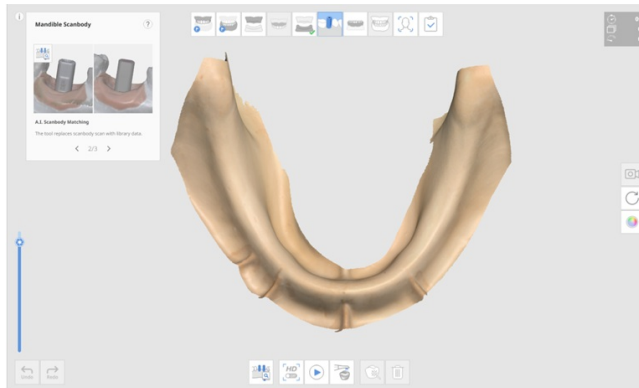

3. Sélectionnez le numéro de la dent et trouvez les données du scanbody correspondantes dans la bibliothèque, puis cliquez sur "Confirmer."

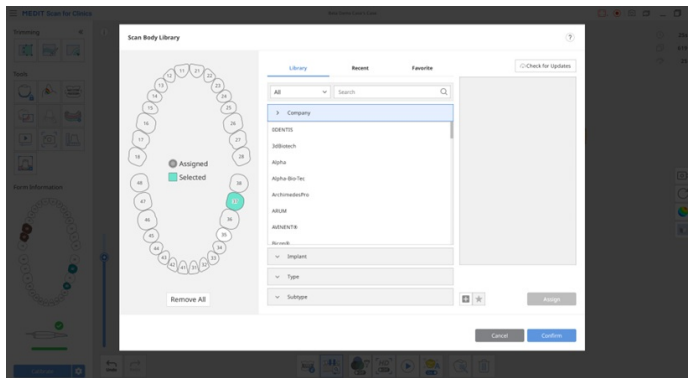

4. Numérisez l'occlusion de la prothèse à l'étape Numérisation de l'occlusion. Les données peuvent être utilisées dans la CAD.

Scan pré-op


Vous pouvez utiliser les données dentaires préopératoires des étapes Pré-op comme données de référence pour créer des prothèses ultérieurement.

Une fois que vous avez acquis ou importé des données au stade Pré-op pour le maxillaire ou Pré-op pour la mandibule, les données sont automatiquement reproduites au stade Maxillaire ou Mandibule lorsque vous passez à l'étape suivante.


Vous pouvez utiliser les données préopératoires reproduites pour acquérir les données préparées ou supprimer et numériser à nouveau les données préparées.

Comment utiliser le Scan pré-op


1. Numérisez la mandibule (ou le maxillaire) avant la préparation des dents à l'étape de numérisation Pré-op pour la mandibule (ou Pré-op pour le maxillaire).

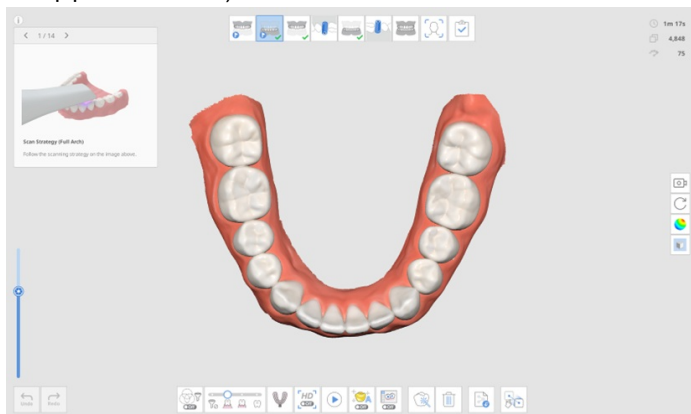


2. Passez à l'étape de numérisation de la Mandibule (ou du Maxillaire). Les données acquises lors de la phase Pré-op pour la mandibule (ou Pré-op pour le maxillaire) seront ensuite reproduites dans cette étape.

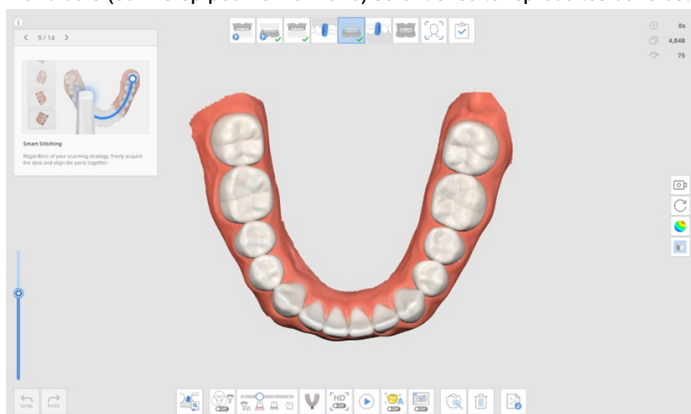

3. Numérisez la mandibule après la préparation des dents. Commencez la numérisation à partir de la zone sans dents préparées et continuez à numériser les dents préparées pour remplacer les données existantes.

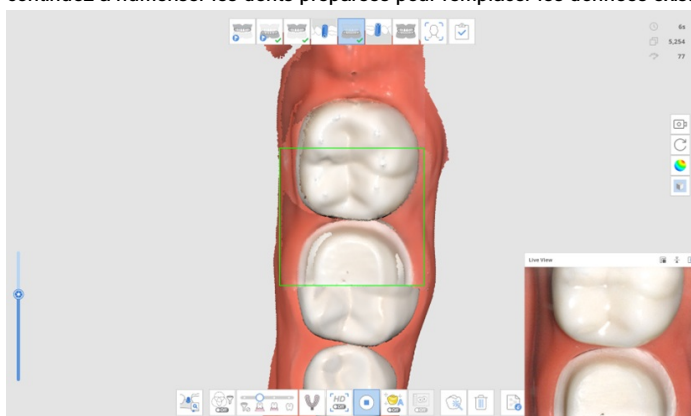


4. L'image ci-dessous montre la numérisation terminée.

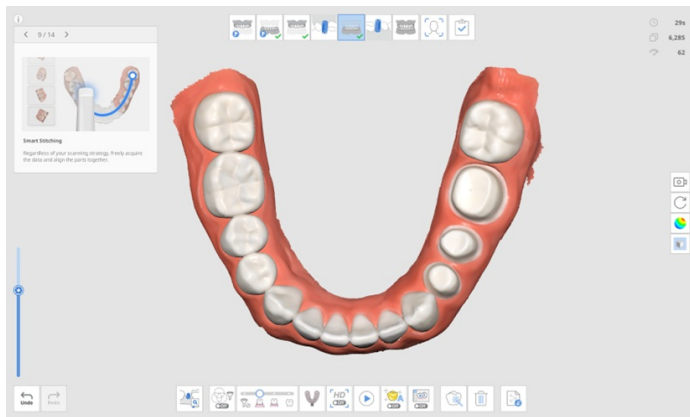


Comment utiliser le Scan pré-op avec les Outils de découpage


1. Numérisez la mandibule (ou le maxillaire) avant la préparation des dents à l'étape de numérisation Pré-op pour la mandibule (ou Pré-op pour le maxillaire).

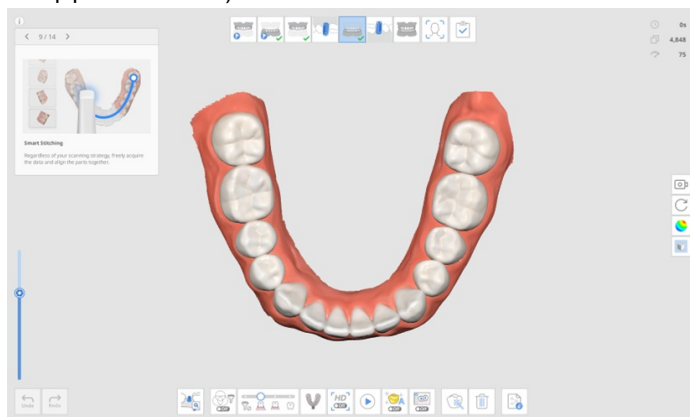


2. Passez à l'étape de numérisation de la Mandibule (ou du Maxillaire). Ensuite, les données acquises au stade Pré-op pour la mandibule (ou Pré-op pour le maxillaire) seront reproduites.

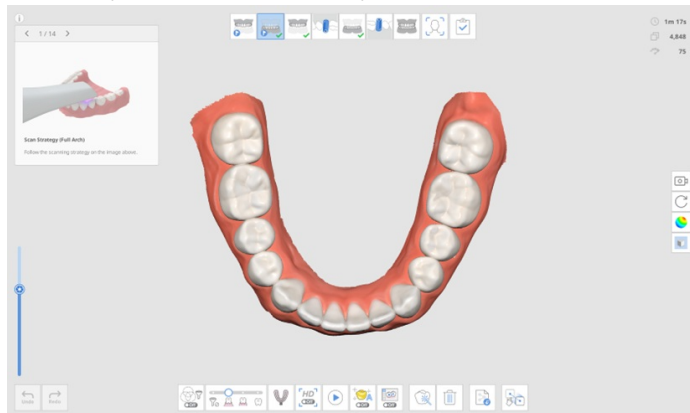


3. Utilisez des outils de découpage pour supprimer les données à l'endroit où se trouvent les dents préparées.

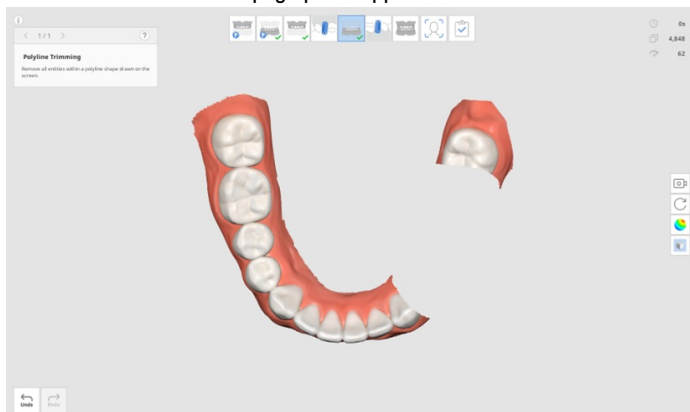


4. Lorsque vous essayez de quitter Outils de découpage, il vous sera demandé de verrouiller les données. Cliquez sur "Oui" pour verrouiller les données existantes afin de les protéger lors des numérisations supplémentaires.

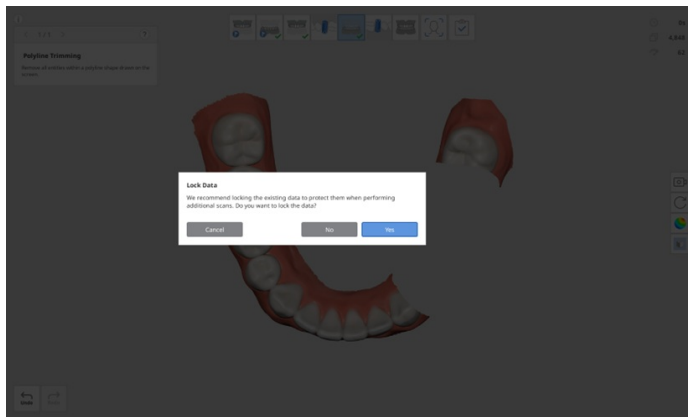


5. Les données verrouillées sont présentées dans une couleur différente, ce qui permet d'éviter toute modification indésirable.

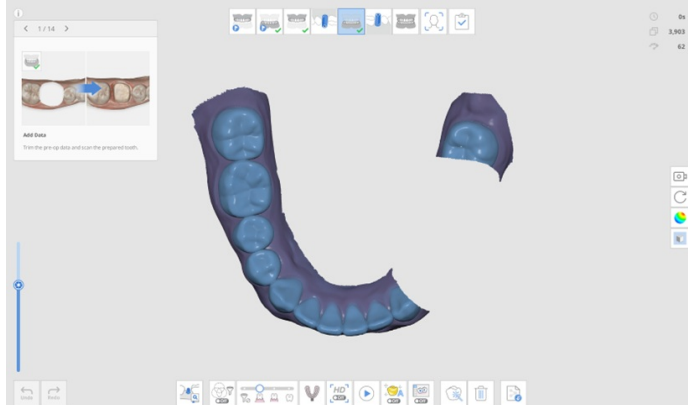

6. Acquérez des données de numérisation supplémentaires dans la zone des dents préparées.

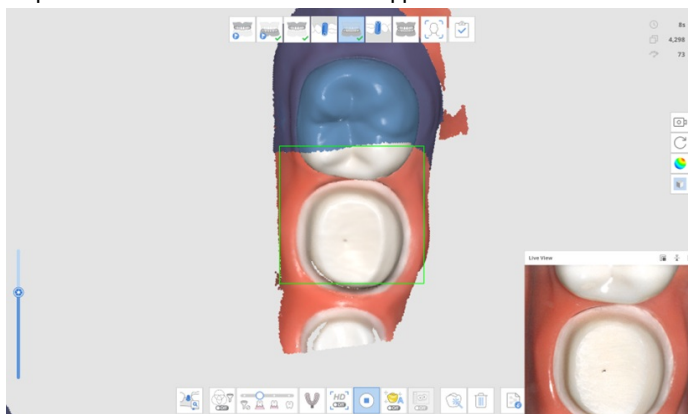


7. L'image ci-dessous montre la numérisation terminée.

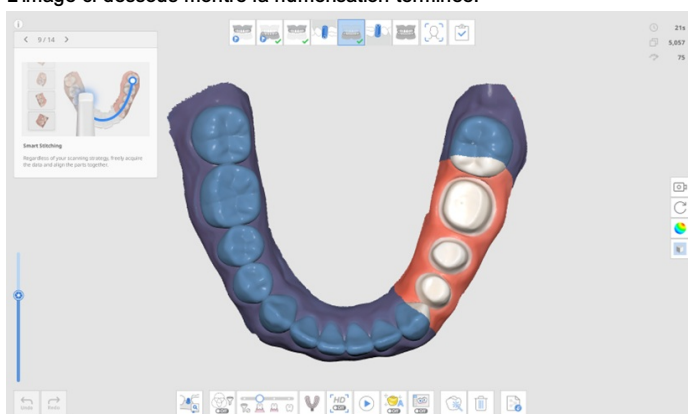


Comment supprimer un Scan pré-op reproduit et scanner de nouvelles données

1. Numérisez la mandibule (ou le maxillaire) avant la préparation des dents à l'étape de numérisation Pré-op pour la mandibule (ou Pré-op pour le maxillaire).

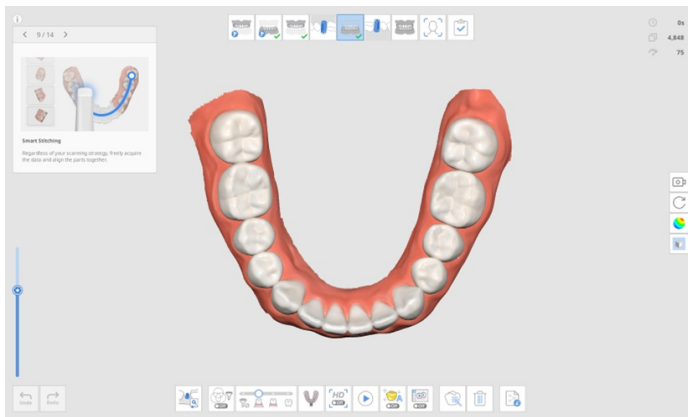


2. Passez à l'étape de numérisation de la Mandibule (ou du Maxillaire). Ensuite, les données acquises au stade Pré-op pour la mandibule (ou Pré-op pour le maxillaire) seront reproduites.

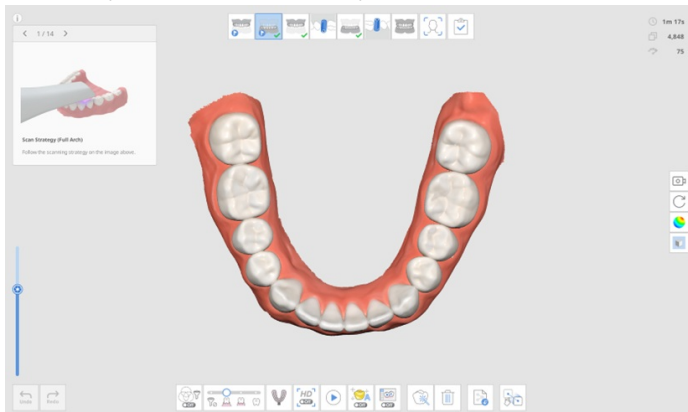


3. Cliquez sur l'icône "Supprimer" en bas.




4. Cliquez sur le bouton "Supprimer et scanner de nouvelles données".

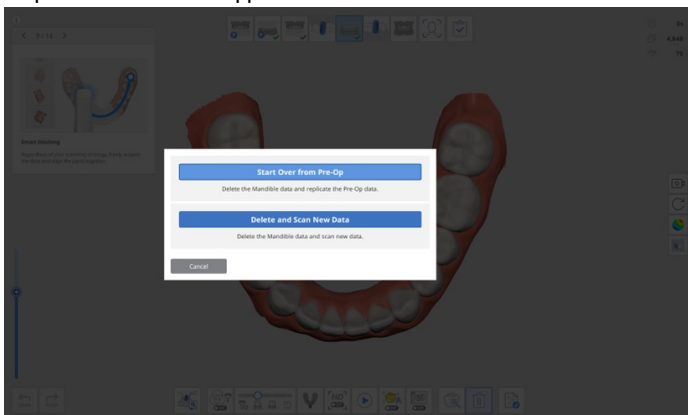


5. Les données seront supprimées comme suit.

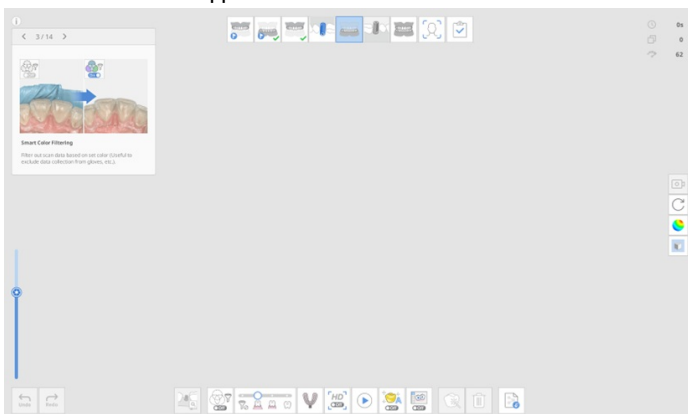

6. Vous pouvez maintenant numériser les données des dents préparées.

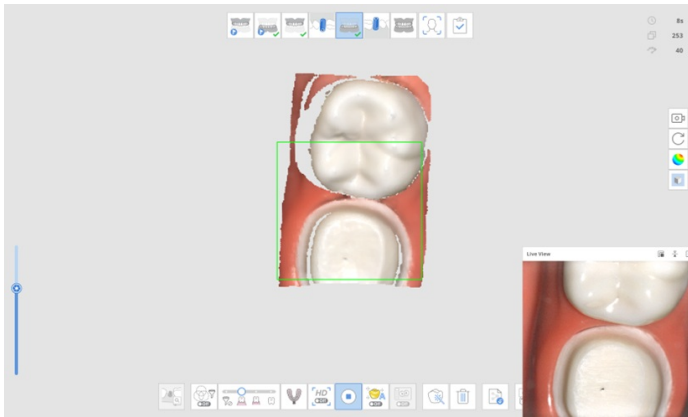


7. L'image ci-dessous montre la numérisation terminée.

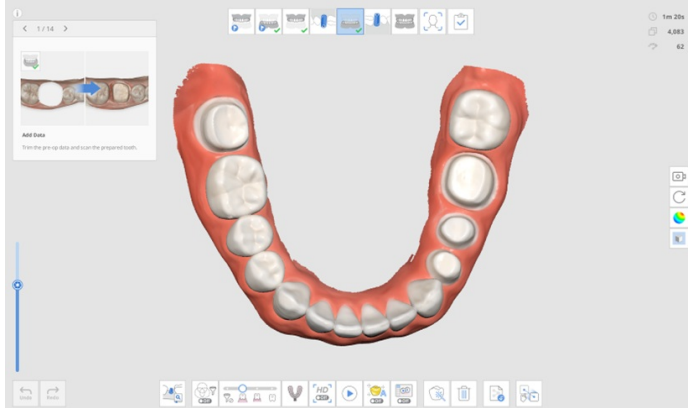


8. Cliquez sur l'icône "Alignement manuel" en bas pour aligner manuellement les données Pré-op pour la mandibule (ou Pré-op pour le maxillaire) sur les données de la Mandibule (ou du Maxillaire).



9. Les données pré-op et préparées sont affichées dans la zone d'affichage des données.

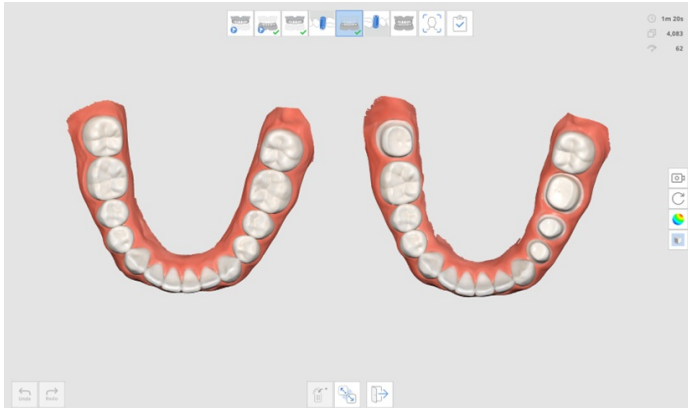

10. Placez jusqu'à trois points pour aligner les données.

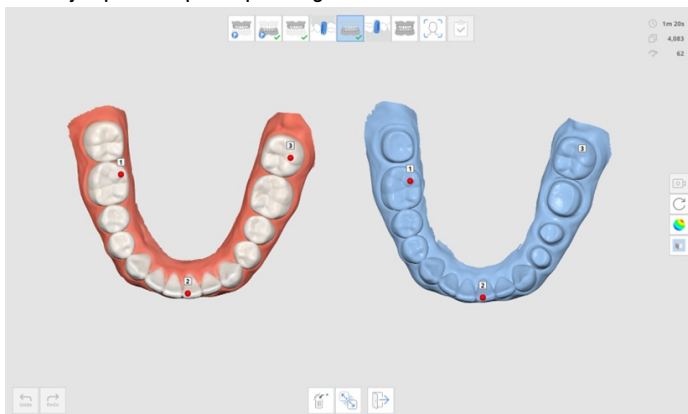

11. L'image ci-dessous montre la numérisation terminée.




Scan d'empreinte

Le Scan d'empreinte permet une numérisation fluide combinant la numérisation intra-orale et le scan d'empreinte.

Vous pouvez facilement fusionner les données intra-orales et les données d'empreinte avec une numérisation intégrée.

Comment acquérir un Scan d'empreinte

1. Scannez les données de numérisation intra-orale à l'étape Maxillaire ou Mandibule.

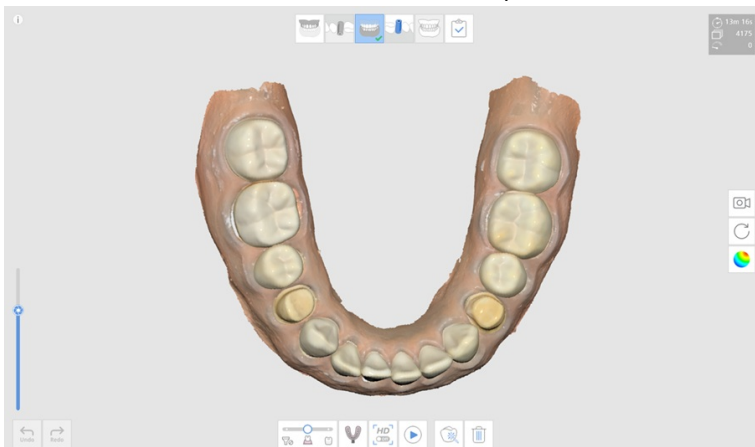

2. Cliquez sur l'icône "Scan d'empreinte" en bas.




3. Marquez la zone où vous souhaitez remplacer les données intra-orales par des données d'impression. Cette fonction est utile pour limiter la zone à remplacer.
Si l'utilisateur saute le processus de marquage, l'ensemble des données sera remplacé par les données d'empreinte.



4. Scannez le modèle d'empreinte pour la zone marquée. Les données d'empreinte seront automatiquement alignées sur les données intra-orales.




5. Lorsque la fonction "Scan d'empreinte" est activée, utilisez les outils de découpage pour afficher uniquement les données d'empreintes.

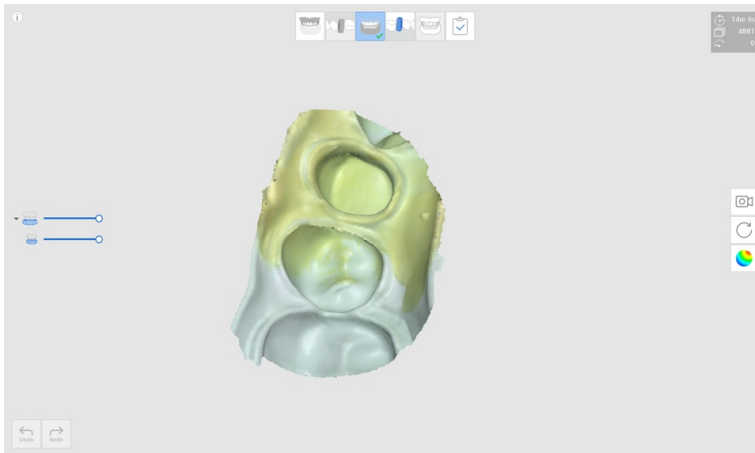

6. Supprimez les zones inutiles dans les données d'empreinte.




7. Le résultat apparaîtra comme indiqué ci-dessous.

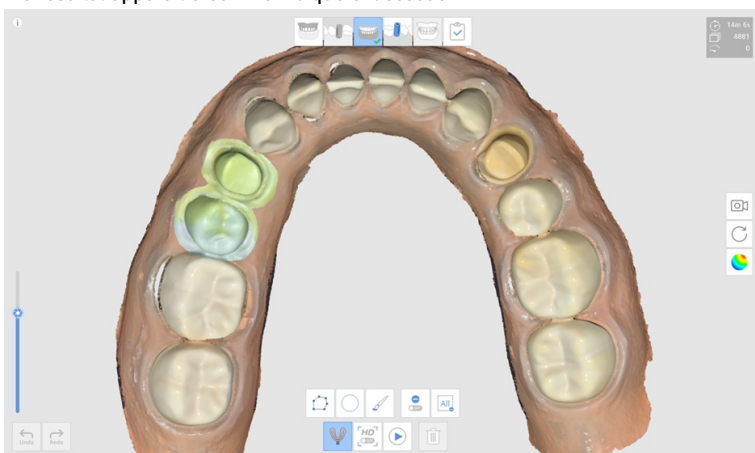

Comment utiliser le Scan d'empreinte pour les marges


1. Scannez les données de numérisation intra-orale à l'étape Maxillaire ou Mandibule.

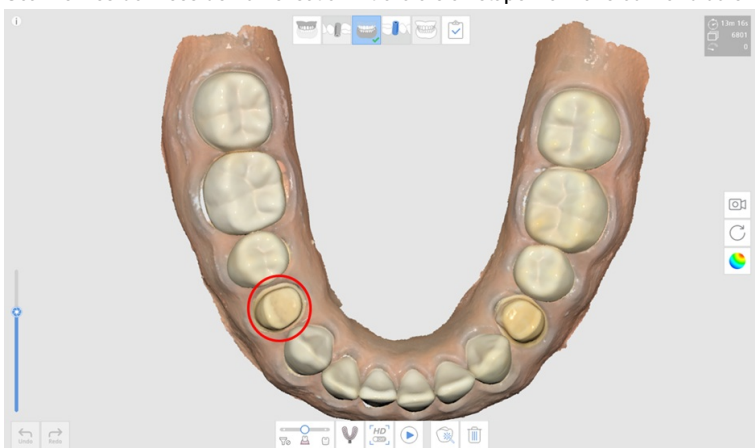

2. Cliquez sur l'icône "Scan d'empreinte" en bas.




3. Marquez la zone de marge à l'aide d'un outil de découpage.

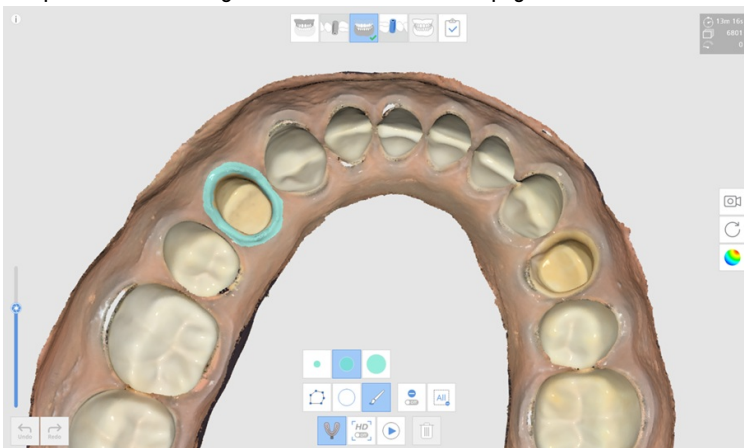

4. Numérisez l'empreinte.




5. Le résultat apparaîtra comme indiqué ci-dessous.

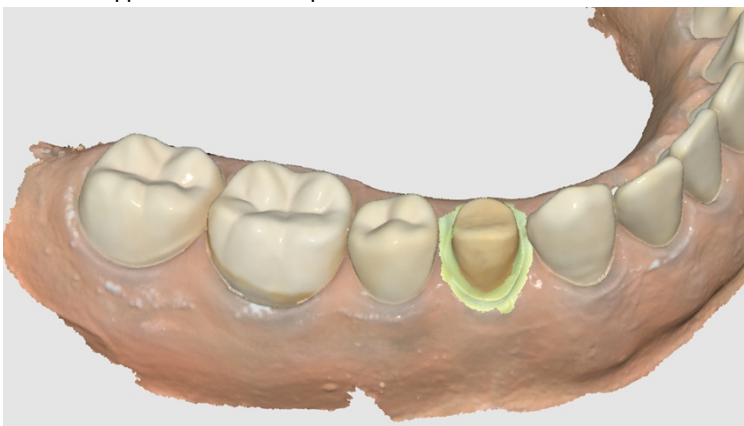


Comment utiliser le Scan d'empreinte pour les cas de Faux et moignon

Dans certains cas de Faux et moignon, il est très difficile d'obtenir les données pour la zone du tenon en raison de la profondeur de la zone et de la difficulté à la numériser. La fonction de "Scan d'empreinte" est utile dans ces cas.


1. Préparez le modèle de base et l'empreinte pour le tenon.

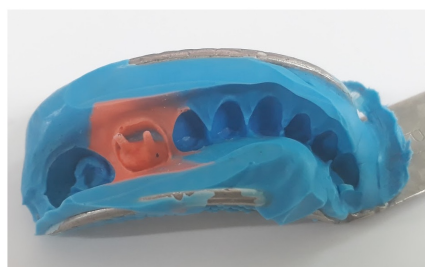


2. Numérisez le modèle de base. Vous pouvez constater que la zone du tenon est profonde et n'est pas entièrement numérisée.

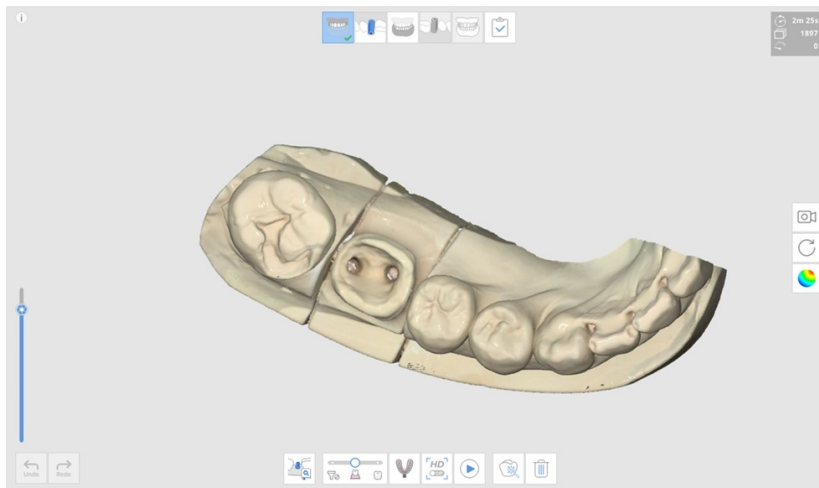

3. Cliquez sur l'icône "Scan d'empreinte" et numérisez le modèle d'empreinte.

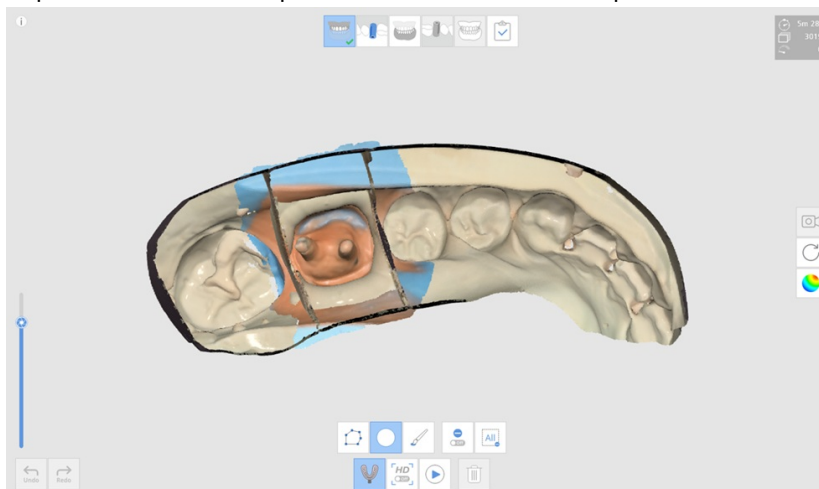

4. Le résultat apparaîtra comme indiqué ci-dessous.

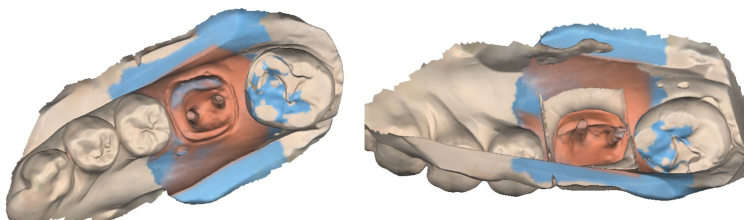


Comment utiliser le Scan d'empreinte pour le cas d'Occlusion

Vous pouvez utiliser la fonction "Scan d'empreinte" pour l'alignement de l'occlusion.

1. Préparer le modèle d'empreinte.



2. Numérisez le maxillaire et la mandibule dans les étapes Maxillaire et Mandibule.

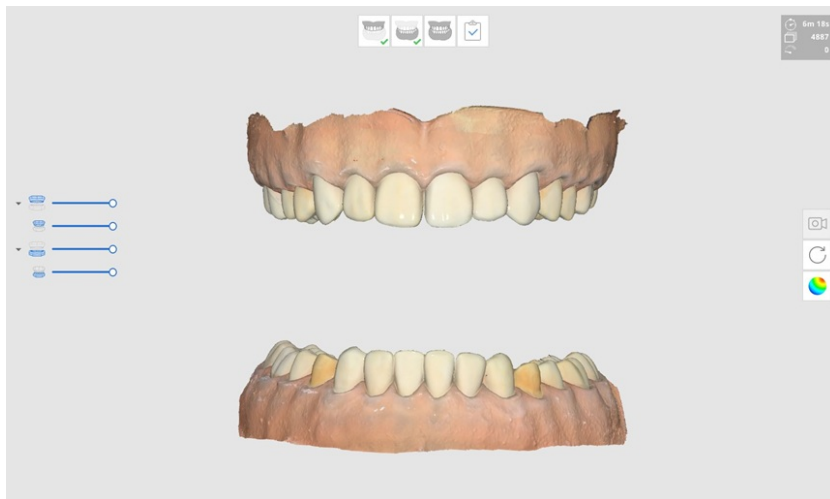

3. Cliquez sur l'icône "Scan d'empreinte" à l'étape Occlusion.



4. Obtenez les données d'occlusion à l'aide du modèle d'empreinte. Dans ce cas, l'empreinte doit être scannée sous tous les angles de 360 degrés pour chaque occlusion.



iNote

La fonction de Numérisation à haute résolution est disponible dans le Scan d'empreinte.

Lorsque les données d'empreinte sont acquises avec une haute résolution, elles s'affichent dans des couleurs différentes si le mode d'affichage du modèle est réglé sur "Texture désactivée".


Correspondance de pilier IA

iNote

[Outils et fonctions > Outils de la barre d'outils principale > Outils de fonctions > Enregistrer Piliers](#) pour savoir comment enregistrer des piliers dans la bibliothèque.

Vous pouvez enregistrer des piliers sur mesure ou des piliers prêts à l'emploi dont la longueur, l'angle, etc. ont été ajustés.

Vous pouvez utiliser la bibliothèque pour remplacer l'acquisition des données dans les zones difficiles à atteindre, telles que les zones de marge du pilier situées sous la gencive ou les zones trop proches des dents adjacentes. Vous pouvez ainsi obtenir des données de numérisation de piliers plus précises et plus faciles à obtenir.

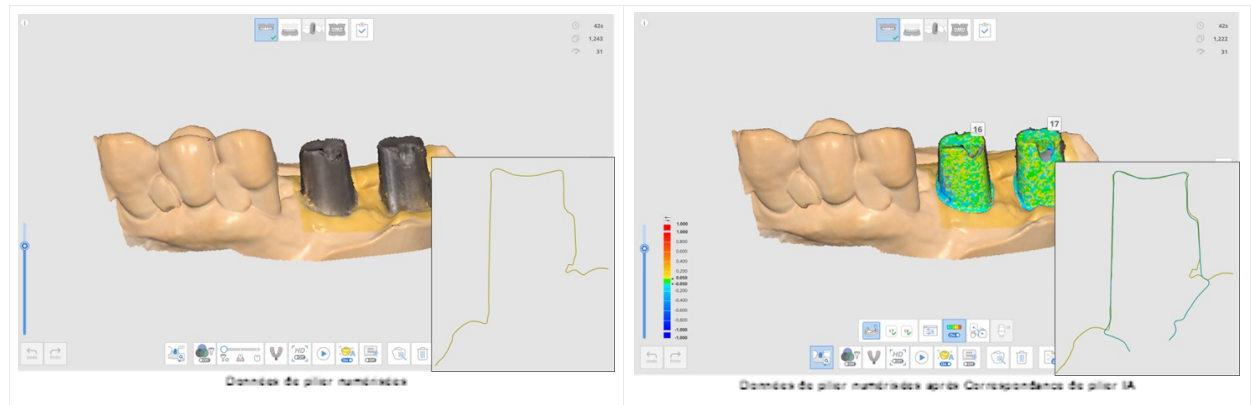

Les outils suivants sont fournis pour la fonction Correspondance de pilier IA.


	Base	Permet aux utilisateurs de sélectionner la base de la cible d'acquisition de données.
	Numéro de dent	Permet aux utilisateurs de sélectionner un numéro de dent individuel pour la cible d'acquisition de données.
	Bibliothèque de piliers	Attribue des données de bibliothèque à chaque dent et gère ces données.
	Afficher/Masquer la déviation	Affichez ou masquez l'écart entre les données alignées à l'aide d'une carte de couleurs.
	Alignement manuel	Permet aux utilisateurs d'aligner manuellement les données de la bibliothèque et les données de numérisation. Vous pouvez aligner les données avec un ou trois points d'alignement.
	Couper le pilier manuellement	Permet de couper le pilier en réglant la hauteur manuellement.

Comment utiliser la Correspondance de pilier IA

Attribution de la bibliothèque de piliers

Avant de numériser les données des piliers, vous devez attribuer la bibliothèque souhaitée à chaque numéro de dent.


- Acquérir des données à l'étape Maxillaire ou Mandibule.

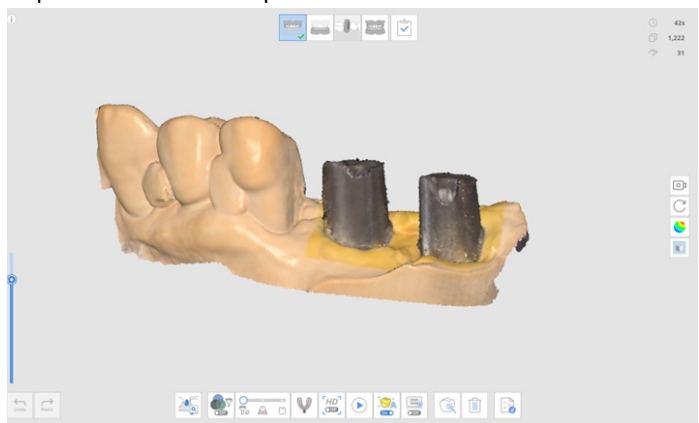


- Cliquez sur l'icône de l'outil "Correspondance de pilier IA" en bas de l'étape Maxillaire ou Mandibule.



3. Cliquez sur l'icône "Bibliothèque de piliers".

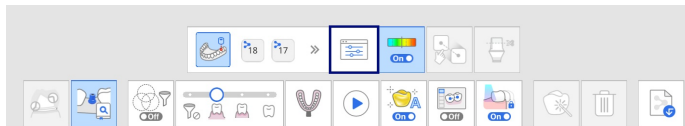


4. La boîte de dialogue suivante apparaît pour définir la bibliothèque de piliers pour chaque dent.

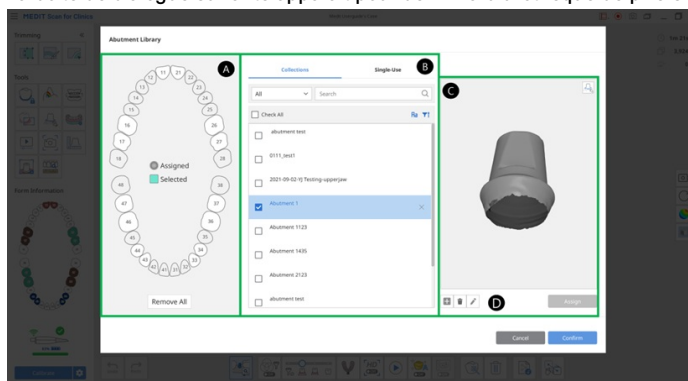

Les deux onglets suivants sont fournis dans la section B pour la sélection de la bibliothèque de piliers.

- Collections : La liste des bibliothèques de piliers enregistrées en tant que collections afin qu'elles puissent continuer à être utilisées dans d'autres cas.
- Usage unique : liste des bibliothèques de piliers enregistrées comme étant à usage unique, de sorte qu'elles ne peuvent être utilisées que dans le cas.

5. Sélectionnez une ou plusieurs dents dans la section A et sélectionnez une bibliothèque dans la section B.
- Vous pouvez ajouter une nouvelle bibliothèque en cliquant sur le bouton "+" situé sous l'image de prévisualisation. Les fichiers aux formats STL, OBJ et PLY sont pris en charge pour l'enregistrement.
 - Vous pouvez également supprimer le cas sélectionné ou modifier le nom d'un cas en cliquant sur le bouton "Supprimer" ou "Modifier" situé sous l'image.
6. Vérifiez la bibliothèque sélectionnée dans la prévisualisation 3D de la section C. Vous pouvez la faire pivoter, la déplacer, faire un zoom avant et un zoom arrière.

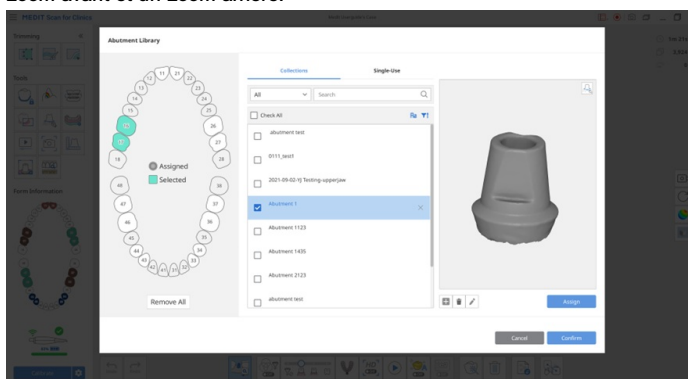

7. Vous pouvez également enregistrer le pilier avec une ligne de marge en cliquant sur l'icône Ligne de marge dans le coin supérieur droit de l'aperçu.

Veuillez consulter Outils et fonctions > Outils de la barre d'outils principale > Outils de fonction > Ligne de marge pour des informations détaillées sur comment dessiner une marge.

8. Cliquez sur "Attribuer" pour attribuer le pilier sélectionné au numéro de dent sélectionné.
9. Après avoir attribué toutes les bibliothèques requises, cliquez sur "Confirmer".

Alignement automatique

Une fois que vous avez attribué une bibliothèque à un numéro de dent, la Correspondance de pilier IA alignera automatiquement la bibliothèque sur les données de scan pendant la numérisation.


iNote

Au lieu de répéter plusieurs fois le processus de sélection des dents dans le programme et de numérisation de la bouche du patient avec le scanner, vous pouvez sélectionner la base et numériser l'ensemble des données en une seule fois.



Dans ce cas, vous devrez aligner manuellement la bibliothèque, dent par dent, une fois la numérisation terminée.



1. Activez l'outil "Correspondance de pilier IA".
2. Sélectionnez un numéro de dent et obtenez des données de numérisation.

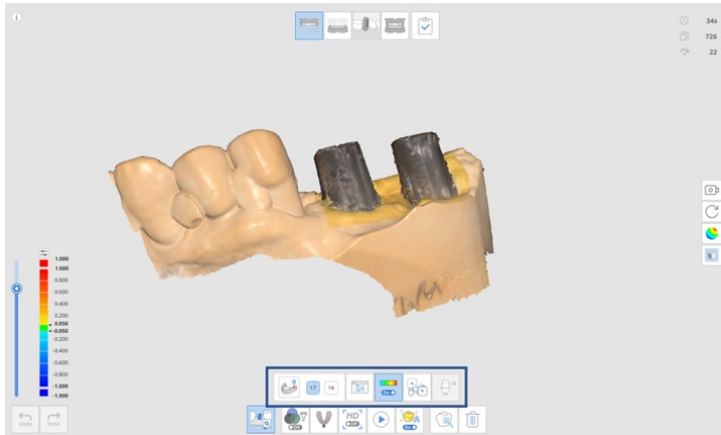

3. La bibliothèque que vous avez attribuée au numéro de dent s'aligne automatiquement sur les données de numérisation.

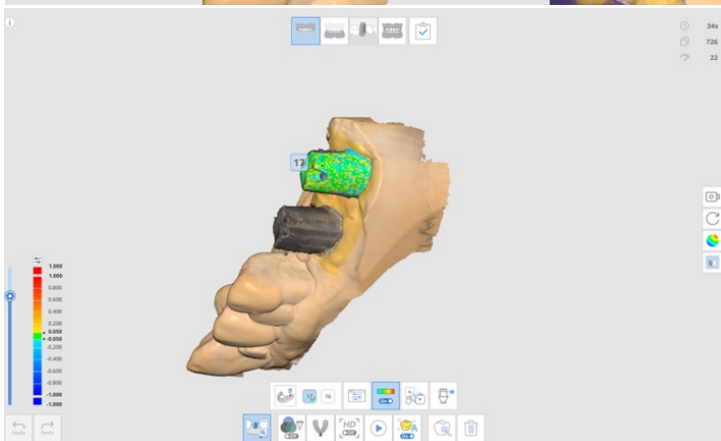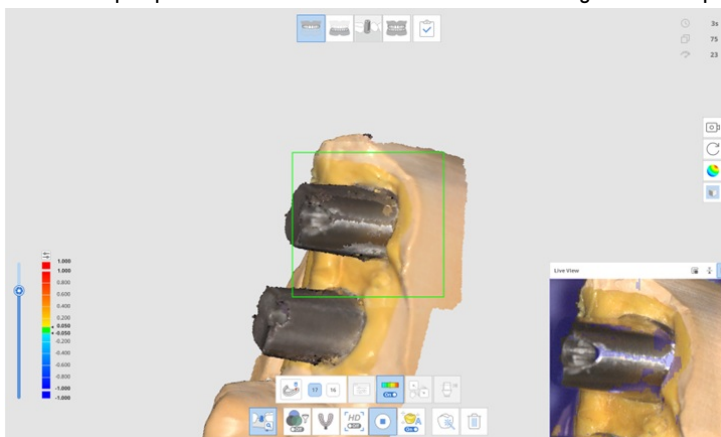


Alignement manuel

Vous pouvez aligner manuellement les bibliothèques de piliers si nécessaire.


1. Après avoir attribué la bibliothèque dans la boîte de dialogue Bibliothèque de piliers, les bibliothèques attribuées s'afficheront à l'écran.
2. Cliquez sur l'icône "Alignement manuel".



3. Cliquez sur jusqu'à trois points correspondants pour aligner les données de la bibliothèque sur les données de numérisation.

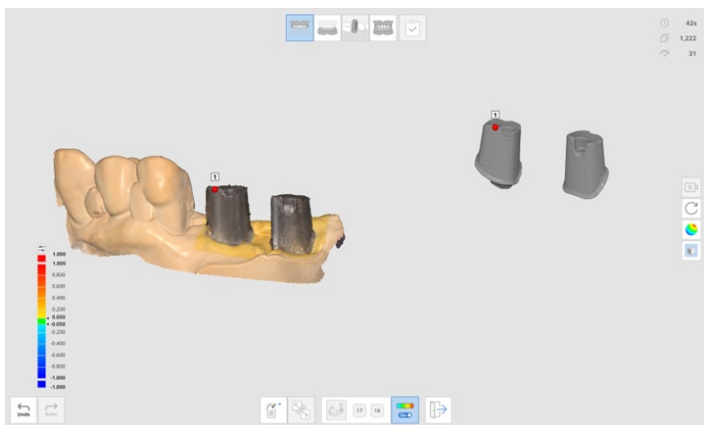

4. Les données de la bibliothèque sont alignées sur les données de numérisation. Vous pouvez vérifier les données de numérisation et la déviation de la bibliothèque grâce à la carte des couleurs.

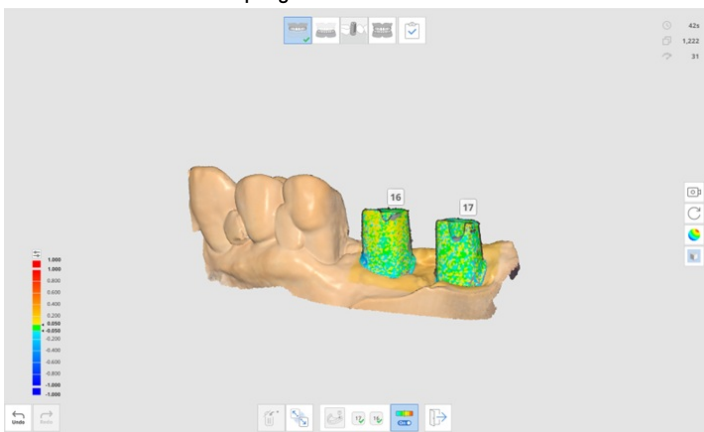

Couper le pilier manuellement

Vous pouvez facilement ajuster la hauteur du pilier standard enregistré au pilier en bouche. Une fois que la ligne de marge est tracée sur le pilier standard, vous pouvez vous passer de tracer la ligne de marge au laboratoire ou à la clinique dentaire.


1. Cliquez sur l'icône "Couper pilier" pour ajuster la hauteur du pilier.




2. Les données du pilier avant l'ajustement de la hauteur sont affichées en transparence.
3. Vous pouvez ajuster la hauteur du pilier en créant un nouveau plan de coupe. Cliquez sur un point et faites-le glisser vers un autre point, ou cliquez sur deux points.



4. Revenez à l'étape Maxillaire en désélectionnant l'icône "Correspondance de pilier IA".
5. Vérifier que le pilier coupé est correctement aligné.

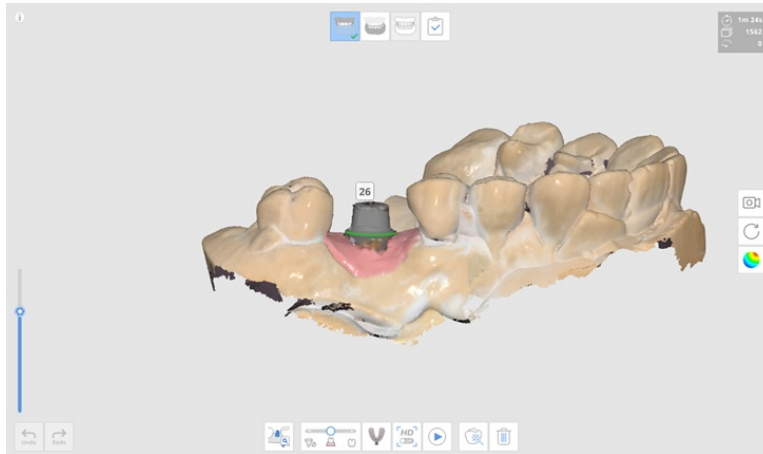


6. Cliquez sur "Terminer" pour vérifier si les données de numérisation et de bibliothèque sont correctement combinées.

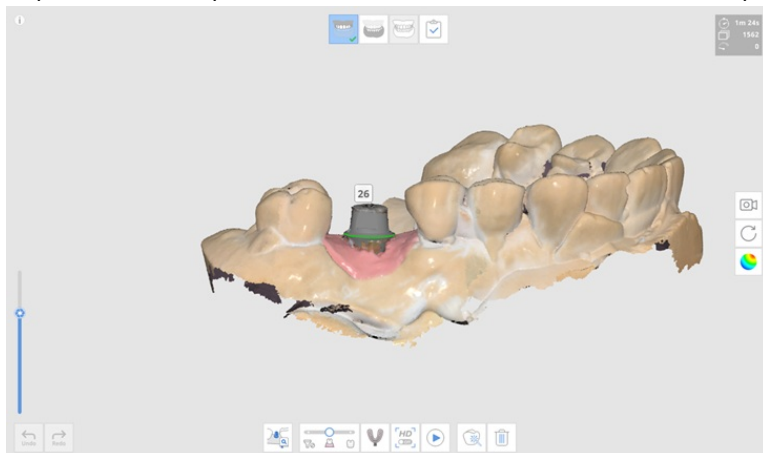

Correspondance scanbody IA

La fonction Correspondance scanbody IA est utile pour scanner des zones difficiles d'accès, telles qu'une zone d'implant étroite ou des matériaux métalliques de scanbody.

En numérisant le scanbody fixé à l'implant, vous pouvez remplacer les données du scanbody par les données de la bibliothèque afin de reproduire avec précision la position et l'angle de l'implant.

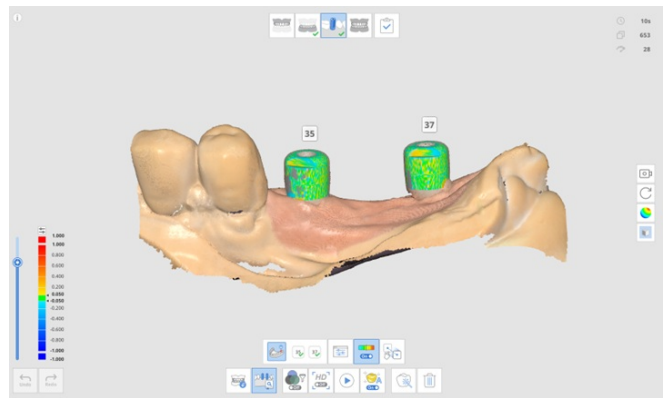

Les outils suivants sont fournis pour la fonction Correspondance scanbody IA.


	Base	Permet aux utilisateurs de sélectionner la base de la cible d'acquisition de données.
	Numéro de dent	Permet aux utilisateurs de sélectionner un numéro de dent individuel pour la cible d'acquisition de données.
	Bibliothèque Scanbody	Attribue des données de bibliothèque à chaque dent et gère ces données.
	Afficher/Masquer la déviation	Affichez ou masquez l'écart entre les données alignées à l'aide d'une carte de couleurs.
	Alignement manuel	Permet aux utilisateurs d'aligner manuellement les données de la bibliothèque et les données de numérisation. Vous pouvez aligner les données avec un à trois points d'alignement.

Comment utiliser la Correspondance scanbody IA


Attribuer la Bibliothèque Scanbody

Avant d'acquérir les données du scanbody, vous devez attribuer la bibliothèque souhaitée à chaque numéro de dent.

- 1. Acquérez les données à l'étape Maxillaire ou Mandibule avant de fixer le scanbody.

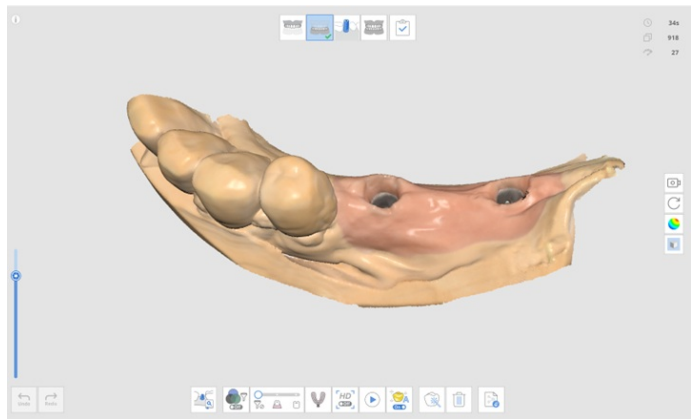


- 2. Passez à l'étape Scanbody et obtenez des données de numérisation après avoir fixé le scanbody.
- 3. Cliquez sur l'icône de l'outil "Correspondance scanbody IA" en bas.

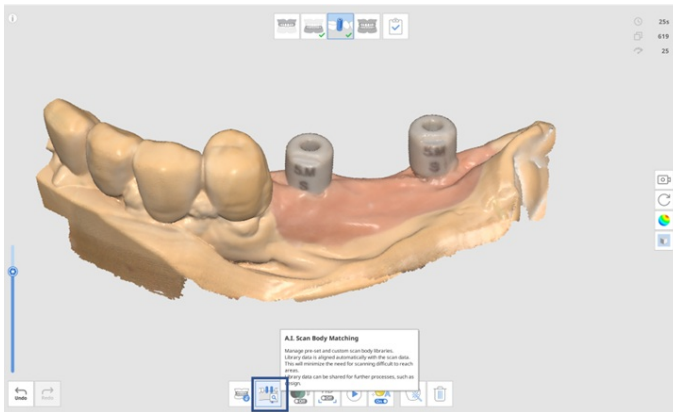

4. Cliquez sur l'icône "Bibliothèque Scanbody".



5. La boîte de dialogue suivante apparaît pour définir la bibliothèque scanbody pour chaque dent.

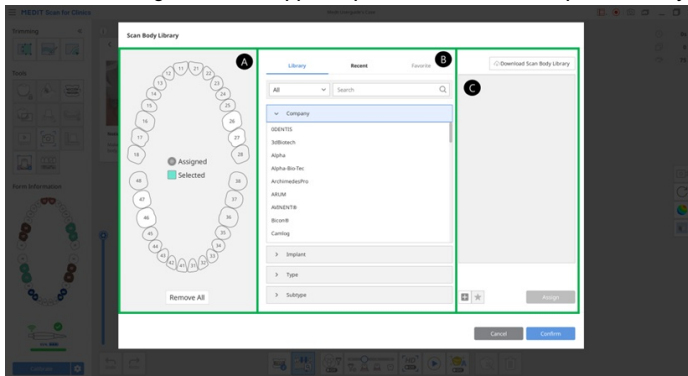


Les trois onglets suivants sont fournis dans la section B pour la sélection de la bibliothèque Scanbody.

- **Bibliothèque** : Toutes les bibliothèques Scanbody enregistrées sont répertoriées par Entreprise, Implant, Type et Sous-type. Vous pouvez rechercher des bibliothèques Scanbody en saisissant leur nom.
- **Récemment** : Les bibliothèques Scanbody utilisées le plus récemment sont répertoriées avec la date de la dernière utilisation.
- **Favoris** : Les bibliothèques Scanbody étoilées sont répertoriées. Vous pouvez ajouter une bibliothèque Scanbody à l'onglet Favoris pour y accéder facilement en cliquant sur l'icône "Ajouter aux favoris" située sous l'image de prévisualisation.

6. Sélectionnez une ou plusieurs dents dans la section A et sélectionnez une bibliothèque dans la section B pour l'attribuer.

Vous pouvez ajouter une nouvelle bibliothèque en cliquant sur le bouton "+" situé sous l'image de prévisualisation. Les fichiers aux formats STL, OBJ et PLY sont pris en charge pour l'enregistrement.

7. Vérifiez la bibliothèque sélectionnée dans l'aperçu 3D. Vous pouvez pivoter, déplacer, faire des zooms avant et des zooms arrière.

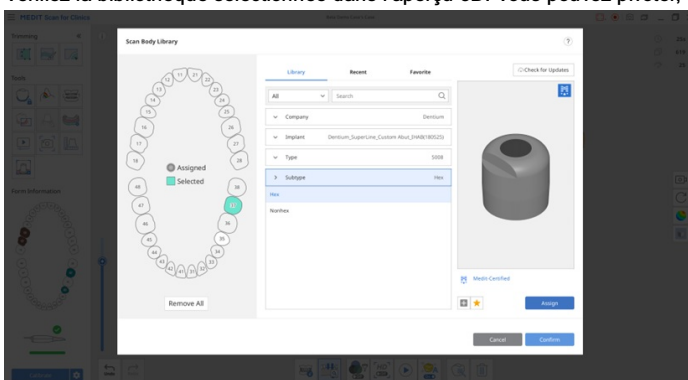

Certifié par Medit

Les bibliothèques scanbody portant le logo Medit dans le coin supérieur droit appliquent un algorithme optimisé pour l'alignement des bibliothèques scanbody afin de minimiser l'impact des erreurs de numérisation dues au traitement et au matériau du fabricant scanbody.

8. Cliquez sur "Attribuer" pour affecter le scanbody sélectionné au numéro de dent.

9. Après avoir attribué toutes les bibliothèques requises, cliquez sur "Confirmer".

Alignement automatique

Une fois que vous avez attribué une bibliothèque à un numéro de dent, la Correspondance scanbody IA alignera automatiquement la bibliothèque sur les données de scan pendant la numérisation.


iNote

Au lieu de répéter plusieurs fois le processus de sélection des dents dans le programme et de numérisation de la bouche du patient avec le scanner, vous pouvez sélectionner la base et numériser l'ensemble des données en une seule fois.


Dans ce cas, vous devrez aligner manuellement la bibliothèque, dent par dent, une fois la numérisation terminée.



1. Sélectionnez l'outil "Correspondance scanbody IA".
2. Sélectionnez un numéro de dent et obtenez des données de numérisation.

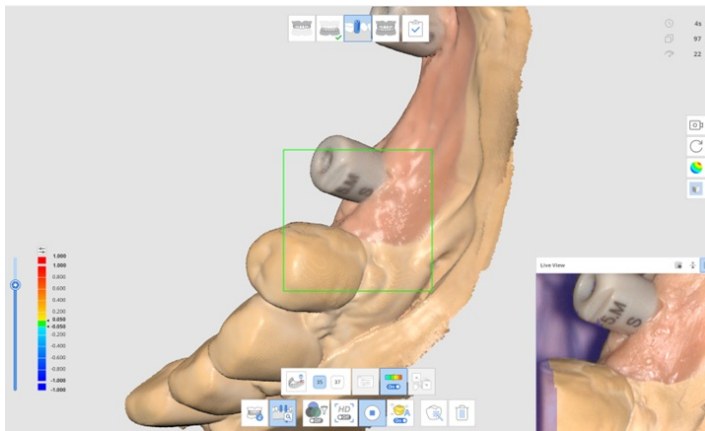

3. La bibliothèque que vous avez attribuée au numéro de dent s'aligne automatiquement sur les données de numérisation.

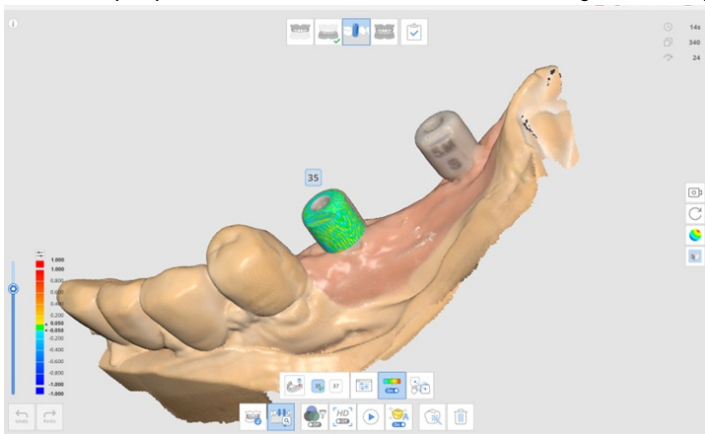


Alignement manuel

Ceci permet aux utilisateurs d'aligner les Bibliothèques Scanbody sur les données numérisées existantes pour les numéros de dents ou les données de numérisation de base. Indépendamment des données acquises, les bibliothèques peuvent être librement alignées si elles sont affichées à l'écran.


1. Après avoir attribué la bibliothèque dans la boîte de dialogue Bibliothèque Scanbody, les bibliothèques attribuées s'afficheront à l'écran.
2. Cliquez sur l'icône "Alignement manuel".



3. Cliquez sur jusqu'à trois points correspondants pour aligner les données de la bibliothèque sur les données de numérisation.

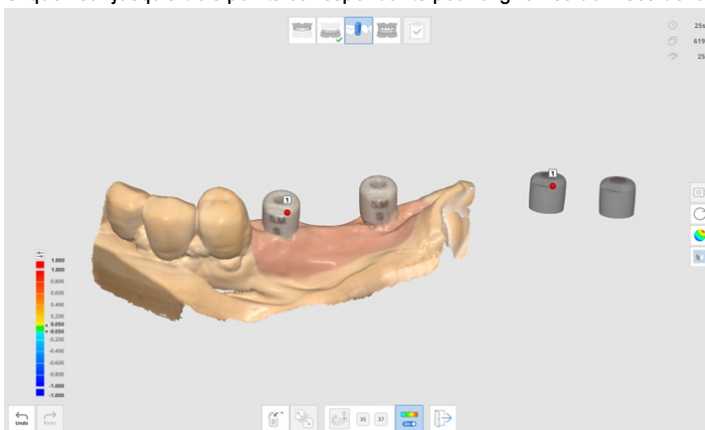



4. Les données de la bibliothèque sont alignées sur les données de numérisation. Vous pouvez vérifier les données de numérisation et la déviation de la bibliothèque grâce à la carte des couleurs.

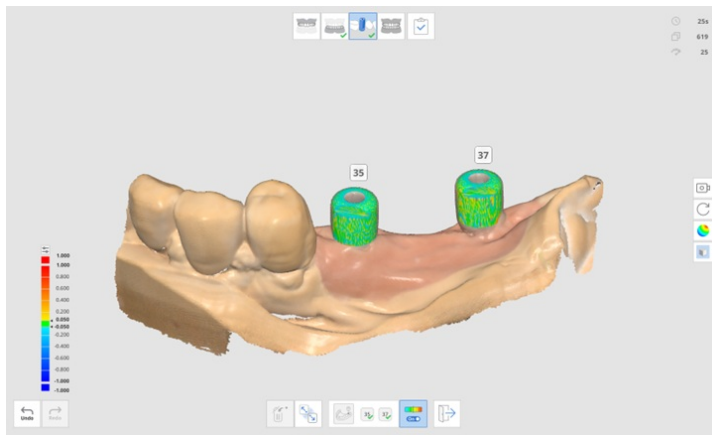

En fonction de votre choix de base et de numéro de dent, les options activées à l'étape 3 ci-dessus varieront comme suit :


- **Acquérir et aligner uniquement les données de numérisation de la base**


Les icônes de la base et du numéro de dent sont toutes désactivées. Vous pouvez aligner toutes les bibliothèques affichées à l'écran.

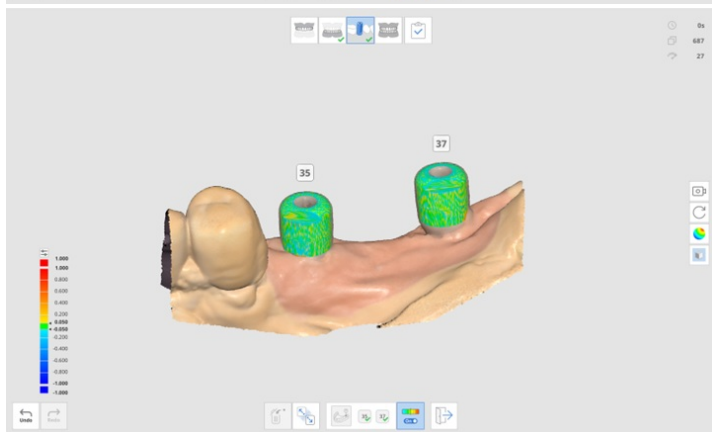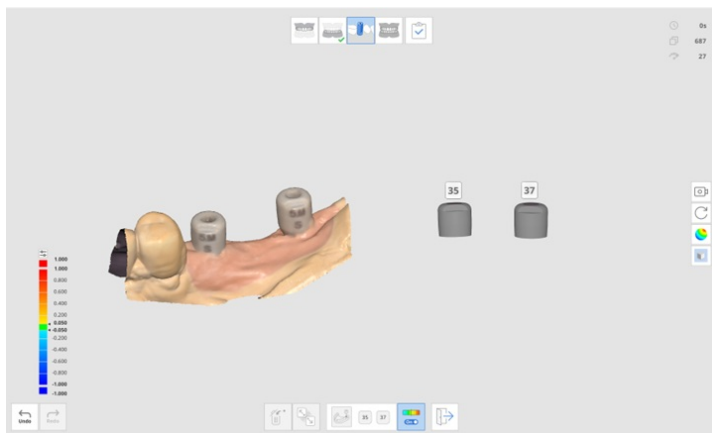

- **Acquérir et aligner uniquement les données de numérisation des numéros de dents**



L'icône de la base est désactivée et les icônes des numéros de dents sont activées.

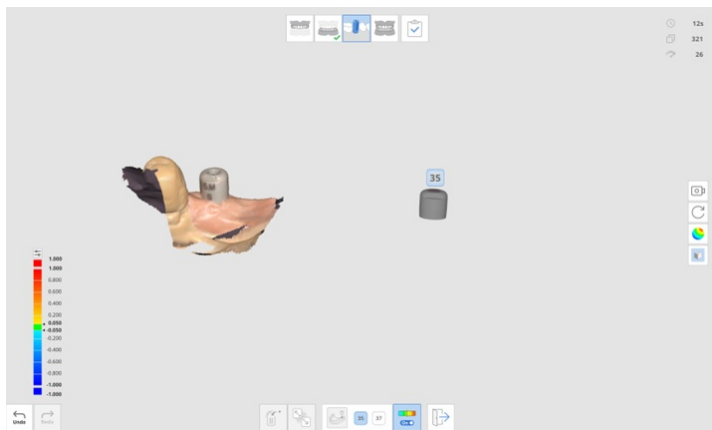

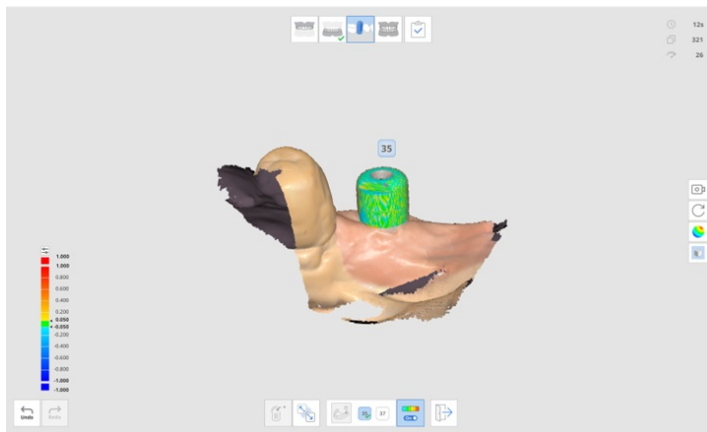


- **Acquérir et aligner les données de numérisation de la base et les données du numéro de dent**

Les icônes de la base et du numéro de dent sont toutes activées. Vous pouvez aligner toutes les bibliothèques sur les données de numérisation.

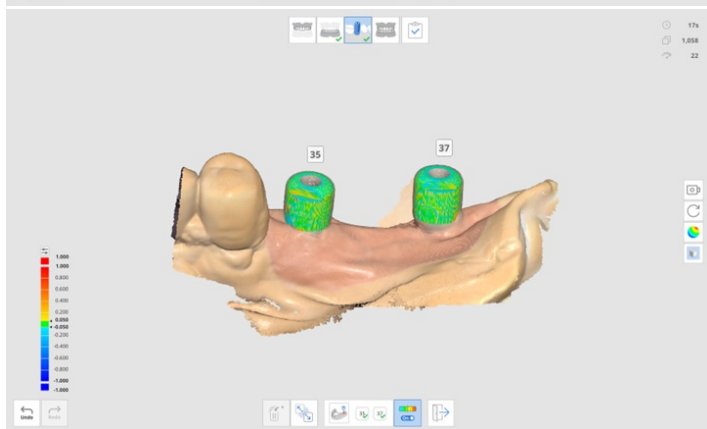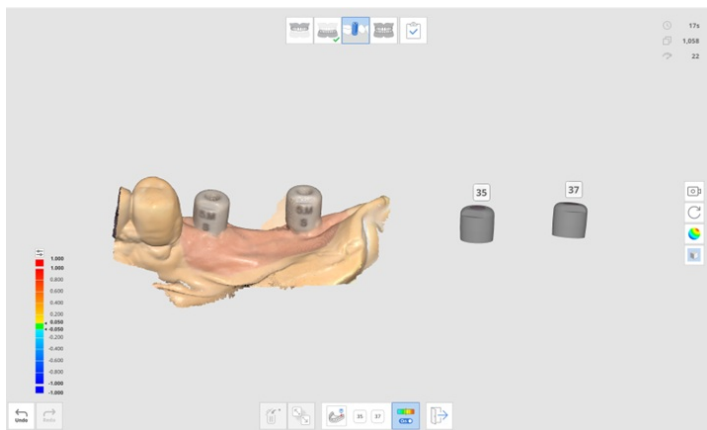

Vous pouvez également sélectionner la base ou les numéros de dents et les aligner si nécessaire.



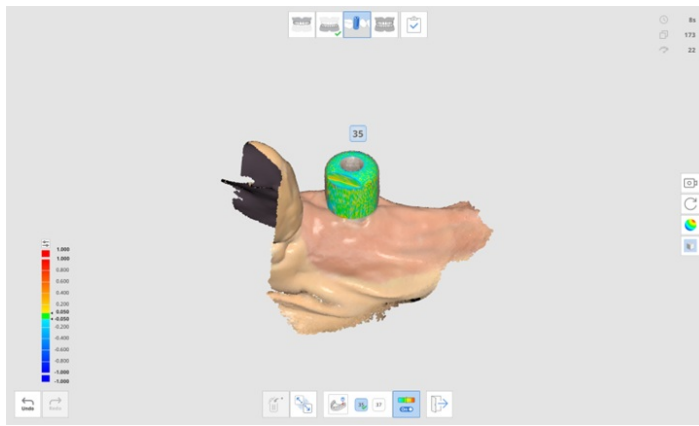

Révision de la préparation

L'icône de Révision de la préparation se trouve en bas de l'étape Maxillaire et Mandibule, et l'icône est activée lorsqu'un nombre suffisant d'images numérisées a été acquis dans chaque étape.

Les outils suivants sont disponibles pour la fonction Révision de la préparation.


	Paramètres de Révision de la préparation	Définir les options pour la révision de la préparation. Cela permet aux utilisateurs de saisir leurs propres valeurs pour les critères afin de déterminer si la réduction dentaire est insuffisante.
	Chemin d'insertion	Calcule le chemin d'insertion pour la zone sélectionnée dans les données préparées.
	Direction automatique	Calcule et affiche automatiquement le chemin d'insertion dans la direction où la zone de contre-dépouille est minimisée.
	Direction manuelle	Permet de calculer et d'afficher le chemin d'insertion dans la direction du point de vue de l'utilisateur.
	Profondeur de la réduction de la dent	Indique la quantité de réduction de la dent par rapport aux données préopératoires. * Les données préopératoires doivent exister et être alignées sur les données préparées pour utiliser cet outil.
	Distance à l'antagoniste	Indique la distance entre la dent préparée et son antagoniste en fonction des données d'alignement occlusal. * Les données d'antagoniste et d'occlusion doivent exister et les données d'occlusion doivent être alignées pour utiliser cet outil.
	Distance à l'adjacente	Affiche la distance entre la dent préparée et son antagoniste. * Cet outil n'est disponible qu'avec des données préparées.

Comment utiliser Révision de la préparation

Paramètres de Révision de la préparation

Avant de procéder à la Révision de la préparation, vous pouvez définir les options et les critères de la fonction dans les Paramètres de Révision de la préparation.

La boîte de dialogue des paramètres permet aux utilisateurs de saisir des valeurs minimales pour la distance par rapport à l'antagoniste, la distance par rapport à l'adjacente et la profondeur de réduction de la dent afin de les aider à établir des critères de préparation de la dent pour le traitement et la fabrication de la prothèse.

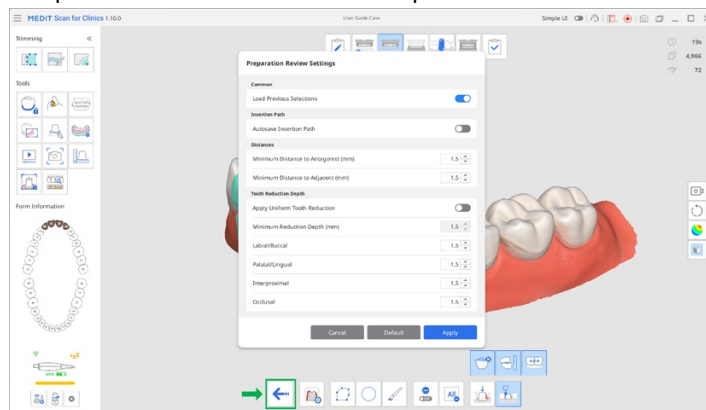


Si l'option Charger les sélections précédentes est activée, elle mémorise les sélections de zones et d'outils pour la fonction de Révision de la préparation lorsque l'on quitte l'étape.


Elle charge également les sélections précédentes lorsque vous entrez à nouveau dans la fonction après une préparation dentaire supplémentaire pour examiner la même zone.

Utilisation des outils de Révision de la préparation


1. Obtenez les données de numérisation à l'étape Maxillaire ou Mandibule et cliquez sur l'icône de l'outil Révision de la préparation.

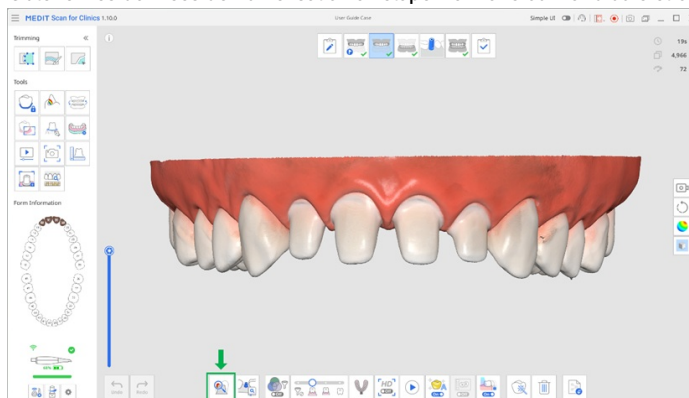


2. Sélectionnez une zone sur les données de dents préparées à l'aide des outils de sélection de zone.

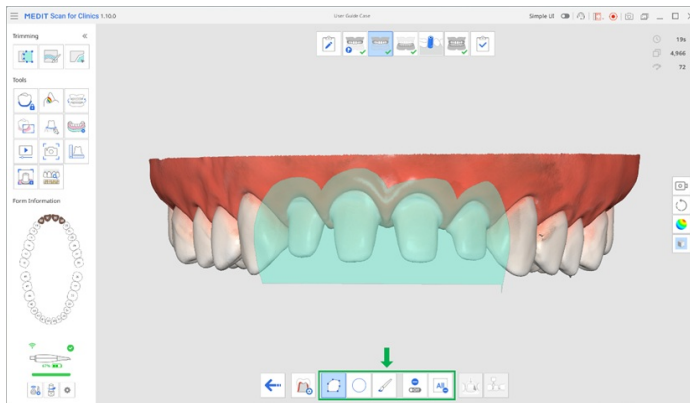


3. Si vous cliquez sur l'icône Chemin d'insertion, un chemin d'insertion est automatiquement créé dans une direction où les zones de contre-dépouille sont minimisées.

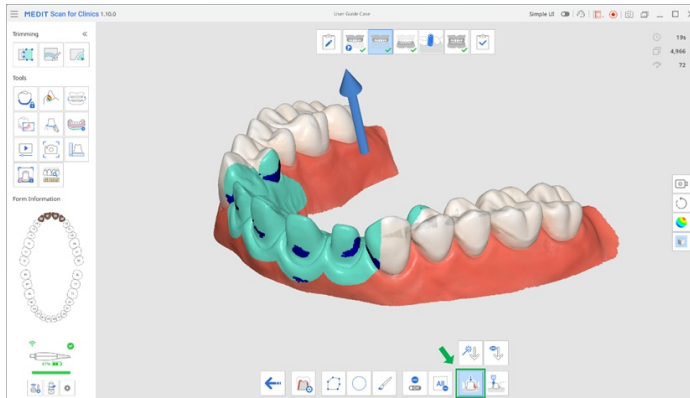

4. Vous pouvez modifier la direction d'insertion en cliquant sur la flèche et en la faisant glisser ou en utilisant l'outil Direction manuelle.
 5. Cliquez sur l'icône Distances et sélectionnez l'un des outils suivants.
- Profondeur de la réduction de la dent
 - Distance à l'antagoniste
 - Distance à l'adjacente
6. Les zones où la réduction dentaire est insuffisante dans les données de numérisation sont indiquées en rouge.

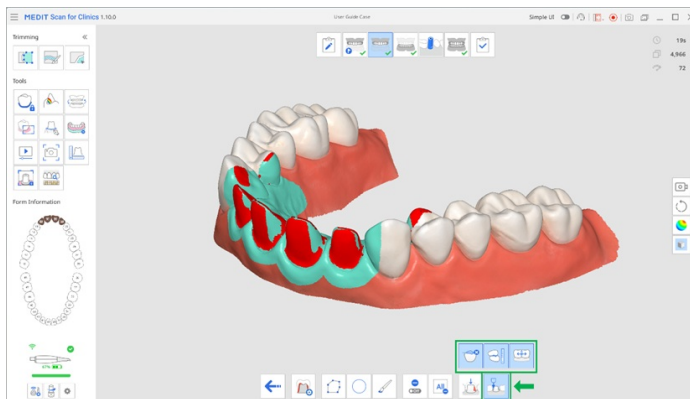

7. En passant la souris sur la zone rouge, une image de l'élément insuffisant et de sa valeur s'affiche.

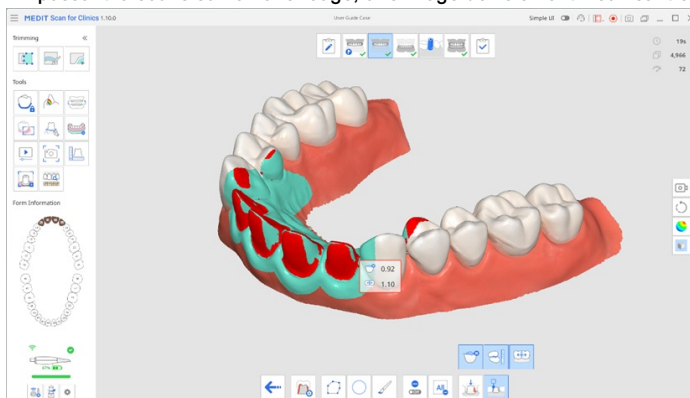

8. Grâce aux valeurs affichées, l'utilisateur peut prévoir si une préparation supplémentaire de la dent est nécessaire et quelle quantité doit être éliminée.
 9. Après avoir effectué une préparation dentaire supplémentaire, vous pouvez découper la zone et acquérir des données de numérisation supplémentaires. Vous pouvez ensuite refaire la Révision de la préparation pour une confirmation finale.

